

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN FLOWMETRE VE OKSİJEN TERAPİ BAŞLIĞI ALIM İŞİ


01.12.2017

SAYIN .....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Dt. Mustafa Alper ÜNAL  
Yönetici V.

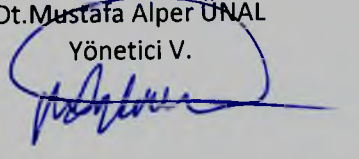

**TEKLİF MEKTUBU**

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	FLOWMETRE	25	ADET		
2	OKSİJEN TERAPİ BAŞLIĞI	10	ADET		
	TOPLAM				

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **05.12.2017 SALI GÜNÜ SAAT 11:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 8 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİ

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ  
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184  
FAX: 0472 616 1168  
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

**FLOWMETRE ve OKSİJEN TERAPİ BAŞLIĞI FLOWMETRE SU KABI VE KAPAĞI  
TEKLİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Flowmetrenin skalası 0-15 lpm aralığında 1 lpm artışlı olmalıdır.
2. Flowmetrenin skala tüpü ve koruma camı kırılmaz polikarbon malzemedden imal edilmiş olmalıdır.
3. Flowmetrenin gövdesi pirinç malzemedden imal edilmiş ve krom kaplı olmalıdır.
4. Flowmetre hassas akış ayar düğmesine sahip olmalıdır.
5. Üzerine DIN standartlarına uyumlu direk bağlantılı abone fişi monteli olmalıdır.
6. Nemlendirme şişesi kırılmaz polikarbon malzemedden imal edilmiş olmalıdır.
7. Nemlendirme şişesi otoklavda steril edilebilir olmalıdır.
8. Nemlendirme şişesi 150 ml kapasiteli olmalıdır.
9. Nemlendirme şişesi plastik kapaklı olmalı ve kapak üzerinde bağlantı somunu, hortum bağlantısı ve hava dağıtıcı bulunmalıdır.
10. Flowmetre ve Nemlendirme şişesi fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.
11. Üretici firmanın TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
12. Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığında onaylı Satış Sonrası Hizmete Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
13. Üretici firma ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
14. Üretici firma ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
15. Fiyat verecek firmaların fiyat verdikleri ürünün ölçüsü max boyu 28,5cm olmalı bu ölçüden uzun ürünler panonun içine sığmayacağından dikkate alınması önemle rica olunur
16. Çalıştırılıp montajı firmaya aittir. Numunesiz fiyatlar dikkate alınmayacaktır.

Mahmut DEMİR  
MCA