

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 639
Konu : Malzeme Alımı Hk.

08/12/2017

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 4 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 11/12/2017 tarih ve saat 10:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Op.Dr. Aykut BAŞER
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	YAPIŞKANLI HEDEF TAHTASI	ADET	1		
2	PERGUE TAHTASI	ADET	1		
3	BECERİ KÜPÜ	ADET	1		
4	HALKALI KULE	ADET	1		
TOPLAM					


**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.


11-) Yapışkanlı Hedef Tahtası

- Cırt cırtlı bantlar sayesinde toplar hedefe kolayca yapışmalıdır.
- Hedef tahtası, arkasında bulunan parçası sayesinde kolayca asılabilir olmalıdır.
- Ek olarak 10 adet ayrı top verilmelidir.

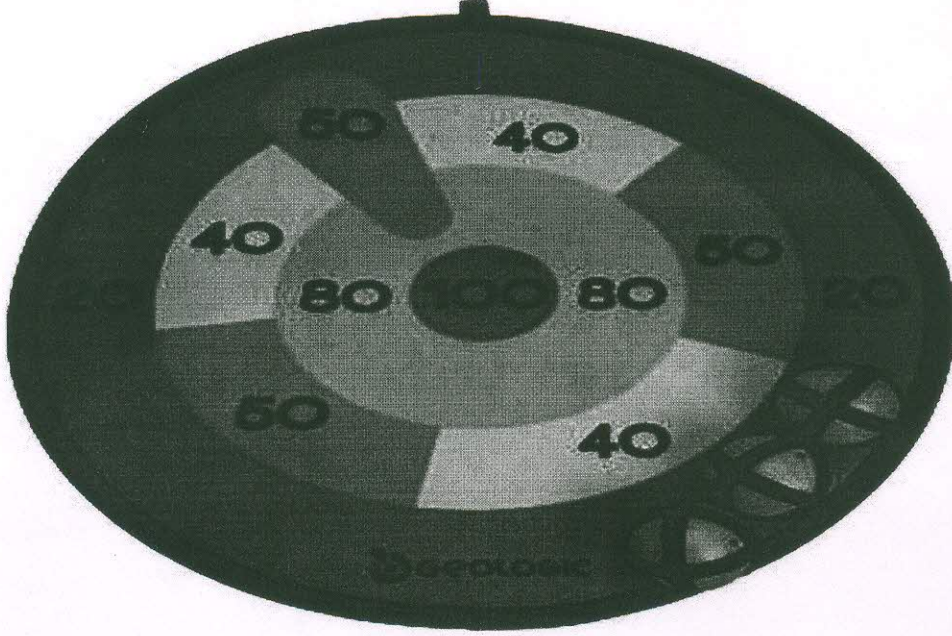

12-) Pergue Tahtası

- Ölçüler 26x39x1,8 cm olmalıdır.
- Fizik tedavi ve rehabilitasyon için uygun olmalıdır.

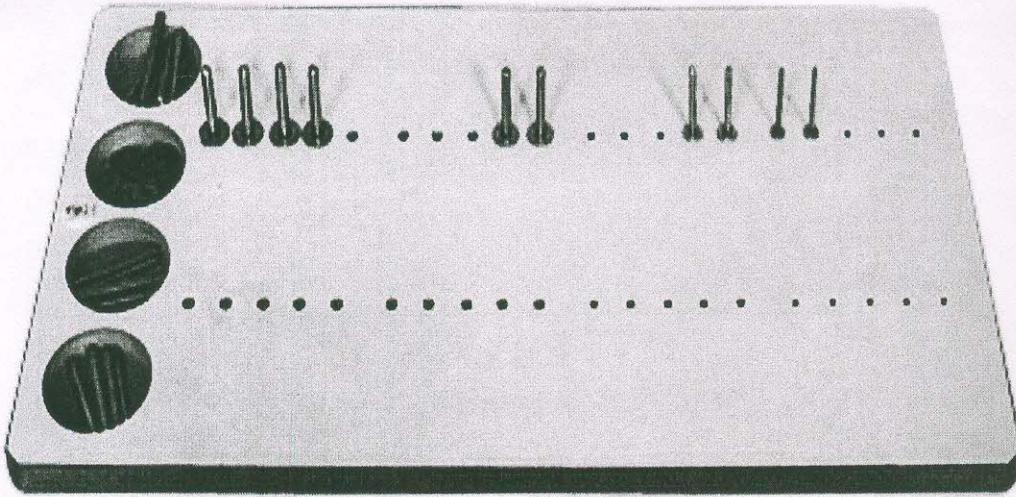


Uzm. Dr. Deniz ÇİÇEK
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Dip. Teş. No: 1197/96
Ağrı Devlet Hastanesi

T.C. AĞRI DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Deniz KARABIÇAK
Dip. Teş. No: 1224/16
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Uzm. Dr. Deniz KARABIÇAK
Dip. Teş. No: 1144/16
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon


13-) Beceri Küpü

- Ürün kaliteli kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
- Ürünün her tarafında farklı beceriler geliştirmeye yönelik uygulamalar olmalıdır.
- Düğme ilikleme, fermuar açıp-kapama, bağcık bağlama, cırt cırt açma kapama, kemer açma kapama gibi uygulamalar yapılabilir.
- Ürünün her bölmesi farklı renklerde olmalıdır.
- Kaliteli ve uzun süre kullanıma uygun olmalıdır.

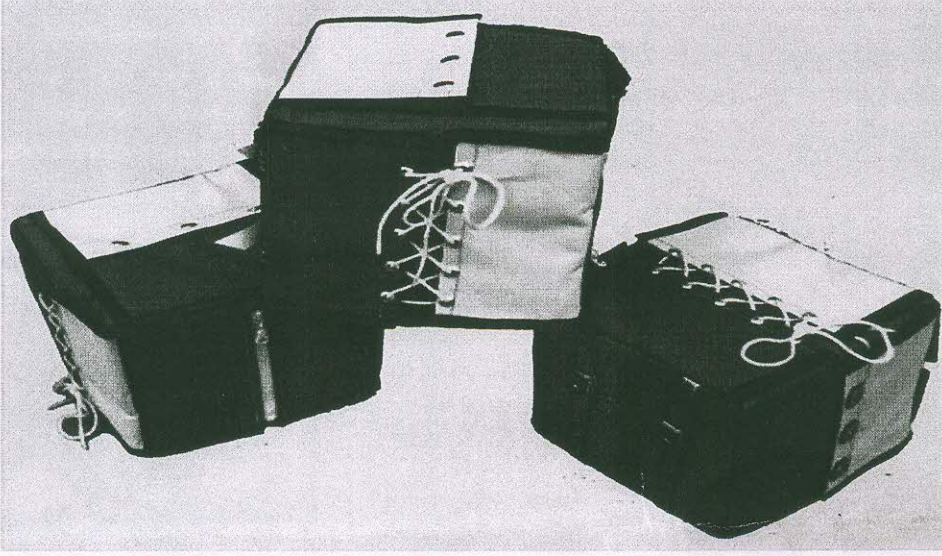

14-) Halkalı Kule

- Malzeme 3 kademeli olmalıdır.
- Ahşap malzeme olmalıdır.

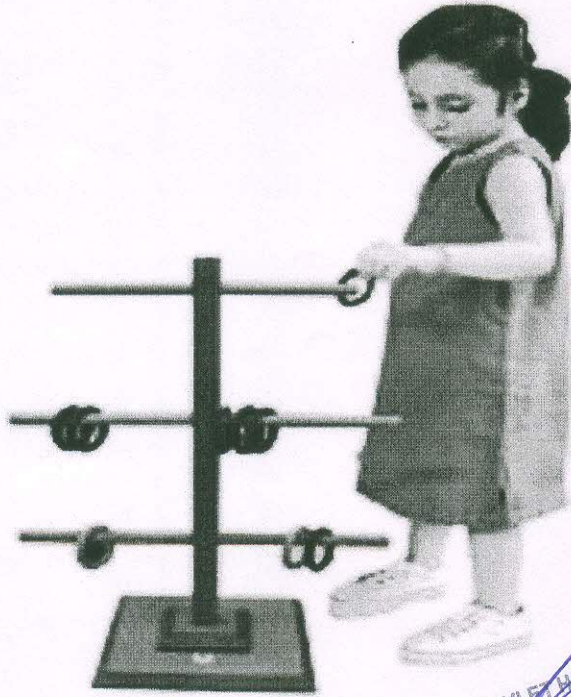

Uzm. Dr. Nadi OLCU
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Dip. Tes. No: 119796
Ağrı Devlet Hastanesi

T.C. AĞRI DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. N. KARABIÇAK
Dip. Tes. No: 122416
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Ağrı Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. N. KARABIÇAK
Dip. Tes. No: 111408
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon