



DOÇ. DR YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ

İDARI MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Hastanemiz doğumhane biriminde cerrahi alet sıkıntısı yaşanmaktadır.Eksik ve kullanıma uygun olmayan cerrahi aletlerin değişmesi eksiklerin tamamlanması gerekmektedir.Birimimizde eksik olan 30 adet over pensi,10 adet Ip-göbek kordonu makası,10 adet epizyotomi makası,10 adet porteque, 20 adet göbek klembi,10 adet tennekulum,3 adet novak küret,3adet Winter(kaşık) küret,3 adet histerometri,2 adet metal spekulum ortaboy,2 adet metal spekulum büyük boy,1 adet kürek seti(0-10mm e kadar),1 adet buji seti, 4 adet alis pensi,2 adet punch biyopsi aleti, 2 adet ekartör seti eksiği mevcuttur.Cerrahi aletlerin teknik şartnamesi ekte mevcuttur.Eksiklerimizin giderilmesini talep ediyoruz.

Gereğini arz ederim.

EKİ:CERRAHİ ALET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

05.10.2017

DOĞUMHANE SORUMLU EBE

EZGİ KAYA


CERRAHİ ALET ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Cerrahi aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüssüz olmalıdır.
3. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Cerrahi aletlerin fonksiyonları gereği bulunması gerekenlerin dışında keskin kenar bulunmamalıdır.
5. Cerrahi aletlerin bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direncine ve kuvvet azaldığında bacakların ilk pozisyonu dönmeyen "elastiki yapıya" sahip olmalıdır.
6. Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.
7. Kilit mekanizmasında bacakları yumuşak kilitlenip kolay ayrılan aletler olmalıdır.
8. Eklemsizlerde, bükülme direnci yüksek gövde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapi olan aletler olmalıdır.
9. Cerrahi makaslar tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının uç kısımları bir noktada birleşmelidir.
10. Cerrahi makasların ve penslerin mafsallarında boşluk bulunmamalı, yalpalama ve laçkalaşma olmamalıdır.
11. Cerrahi makasların mafsalları yumuşak hareket etmeli ve ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalıdır.
12. Epizyotomi makaslarının kesici kısmının ucunda künt çıkıştı olmamalıdır.
13. Portequeler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında ağızları birbirine aralsız oturmalıdır.
14. Cerrahi aletler kororzon testi açısından kaynatma ve 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
15. Teklif edilen ürünleri ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığından onaylanmış barkod numaralarının birim fiyatı teklif cetvelinde ve teknik şartnameye uygunluk belgesinde belirtilmesi zorunludur.
16. İmalatçı veya mümessil ve/veya ithalatçı firmaların, teklif edilen aletlerin sağlık Bakanlığı ulusal bilgi bankasında sağlık bakanlığından onaylıdır kaydının bulunması zorunludur. İstekli firma yetkili satıcı veya bayii ise İmalatçı veya mümessil ve/veya ithalatçı firma tarafından sağlık bakanlığı ulusal bilgi bankasına yetkili bayilik kaydının yapılmış olması zorunludur.
17. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları teknik şartnameye uygunluk belgesini teklif mektubu ekinde vereceklerdir. Bu belgede teknik şartnamenin her bir maddesine verilen cevap, ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katolog numarası, isteklinin teklif marka ürünün adedi, barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.
18. Cerrahi aletler fabrikasyon, işçilik ve malzeme hatalarına karşı en az 2 yıl garanti olmalıdır.
19. İhale dökümanı beyanında verilen cerrahi aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafi gösteren katolog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli teklif edeceği cerrahi aletler şartnamede belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya denge benzeri diğer marka aletleri de teklif edebilir. Teklif edilen aletlerin ölçülerini istenilenden $\pm 1\text{cm}$ uzunlukta olabilecektir. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören uç ve ağız kısmı ile işlevsel özelliklerinde istenilenin aynı olmak zorundadır.

20. Cerrahi aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeligin uluslararası DIN58298/2005 normlarında belirtilen HRC Rockwell standartlarına göre sertlik derecesi, üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke noterlik ve Apostil tasdiklerini taşıyan beyanı ile belgelenecaktır. İsteklilerin bu beyanları uluslararası normlarla karşılaşılacak uygunluluğu tespit edilen beyanlara ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
21. 10 yıl süreli ücreti karşılığı hizmet garantisi de verilecektir.
22. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içinde bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletlerin 45 (kırkbeş) gün içerisinde yenileri ile değiştirileceğine dair taahhütname vereceklerdir.

Op.Dr.Murat S. E.S.
142657

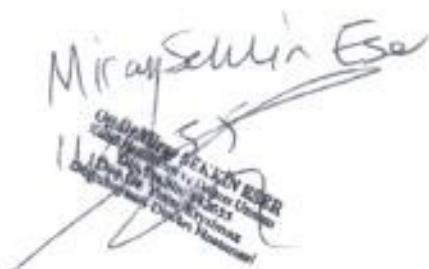
TC 53. Sağlık Bakanlığı
Doktorat İmza İzin Kartı
OP-DK-142657

İmza: 
Dr. Murat S. E.S.
T.C. 53. Sağlık Bakanlığı
Doktorat İmza İzin Kartı
OP-DK-142657

KADIN DOĞUM SEZERYAN SETİ

CERRAHİ ALET	UZUNLUK(CM)	KOD	ADET
BİSTÜRİ NO:4	13,5	B 040.00	5
DİŞLİ PENSET	13	D 360.02	5
DISSİZ PENSET	13	D 240.01	5
KABA KLEMP(PEAN)	16	431.00	10
METZEN BAUM	18	C 756.01	7
PORTEGÜ	16,5	F 345.00	5
PORTEGÜ	18	F 346.00	5
MESANE EKARTÖRÜ	21,5	K 707.00	5
ROUX EKARTÖR		K 325.01	5
OVER KLEMP	18	E 082.00	15
IP MAKASI	14,5	C 723.036	5
KOCHER	20	G 448.02	10
MOSQUITO	12,5	G 215.00	15
ÇAMAŞIR KLEMP	10,5	E 431.01	10

NOT: BAHADIR CERRAHİ ALET KATOLOĞU REFERANS ALINARAK KODLAR GIRİLMİŞTİR.

Miray Selvin Esen

 İLMIYET VE TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI
 İLMIYET VE TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI
 İLMIYET VE TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI
 İLMIYET VE TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI
 İLMIYET VE TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI

TC SİYAH İŞ MAKİNA
 İLMIYET VE TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI
 İLMIYET VE TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI
 İLMIYET VE TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI
 İLMIYET VE TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI