

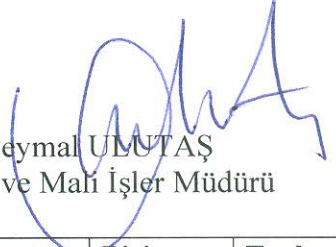
T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 226
Konu : Malzeme Alımı Hk.

06/04/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 09/04/2018 tarih ve saat 14:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal UMUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	HAVALI YATAK	ADET	4		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

HAVALI YATAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Düşük riskteki basınç ülseri tedavisi için uygun olmalıdır.
2. Yatak, hastanın vücut ağırlığına göre ayarlanabilir basınç özelliğini içermelidir
3. Kancaları sayesinde yatağa monte kolaylığı sağlamalıdır.
4. Yatak en az 130 adet baloncuktan oluşmalıdır.
5. Hava çıkışı >4,5litre/dk. olmalıdır
6. Basınç aralığı 40mmHg - 130 mmHg arasında olmalıdır.
7. Devir süresi 12 dk'yı aşmamalıdır.
8. İA sigortaya sahip olmalıdır
9. Materyal: PVC (EN-71, düşük toksik) olmalıdır.
10. Güç tüketim i 7 W olmalıdır
11. Ebatlar: 280 cm (U) x 90 cm (G) x 6,5 cm (Y) olmalıdır
12. Dahili tamir kiti bulunmalıdır.

Uz. Dr. Münevver EROĞLU
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Dip. Tes. No: 121072
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastanesi

T.C. AĞRI DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Deniz KADABIÇAK
Dip. Tes. No: 122416
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon