

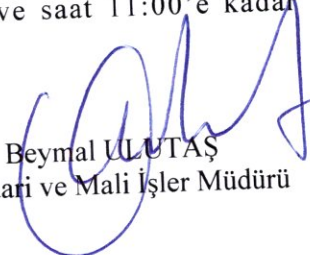
T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

18/10/2018

Sayı : 57212153/510
Konu : Malzeme Alımı

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/10/2018 tarih ve saat 11:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	OKSİJEN FLOWMTRESİ	ADET	100		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

OKSİJEN FLOWMWTRESİ (Debimetre+Nemlendirme Şişesi)TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Skala 0-15 lpm aralığında 1 lpm atışlı olacaktır.
- 2.Skala Tüpü ve Koruma camı kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 3.Gövde Pirinç malzemeden mamül krom kaplı olmalıdır.
- 4.Firma ismi ve gaz ismi yazılmış olmalıdır.
- 5.Nemlendirme şişesi kırılmaz polikarbon malzemeden üretilmiş olacaktır.
- 6.Nemlendirme şişesi otoklavda en az 120 derecede steril edilebilir olmalıdır.
- 7.Üzerine BS 5682:1992 standardına uyumlu direk bağlantılı abone fişi monteli olmalıdır.
Ürün CE Belgeli olmalı ve belge kapsamında yazılmalıdır.
- 8.İmalatçı ve yapımçı firmalar ISO 9001:2008 kalite belgeli olmalıdır.
- 9.İmalatçı ve yapımçı firmalar TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.

Firat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu

