



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet 22 D

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KEMİK KESİCİ LATERAL CİHAZI ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **15/03/2019** tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KEMİK KESİCİ LATERAL CİHAZI	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.

Uzm Dr Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com


E.771

18.02.2019


T.C. DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ'NE

Hastanemizde yapılan septorinoplasti ameliyatlarında kullanılmak üzere aşağıda teknik şartnamesi verilen bir adet kemik kesici lateral cihazı gerekmektedir. Temin edilmesini arz ederiz.

Op.Dr. Erdi Özdemir



Op.Dr. Mücahit Murat Kıcalı

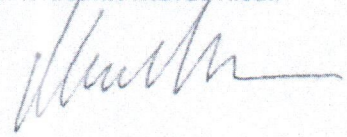

KEMİK KESİCİ LATERAL CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Cihaz , kemik hasatı, sinüs cerrahi, osteoplasti, osteotomi, uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
- 2- Cihaz 24.29.5 KHZ frekansında çalışmalıdır.
- 3- Cihazın su akış oranı 10-85 mL/dk aralığında olmalıdır.
- 4- Cihazda 3 farklı mod seçeneği olmalıdır.
- 5- Cihaz güç-frekans, soğutma, otomatik temizleme (auto cleaning) gibi verileri de içermelidir. Tüm bu özelliklere ait dokunmatik tuşlar kontrol paneli üzerinde olup istenilen ayar bu tuşlardan kolaylıkla yapılabilir.
- 6- Cihazın kullanımı kolay ve tüm fonksiyonları gösteren geniş, LED'li ekranı olmalıdır. Ultrasonik çalışma göstergesi, program numarası, titreşim seviyesi, sıvı akış seviyesi, titreşim modu, hafıza durumu ve mod seçme ekranda görülebilmelidir.
- 7- Mevcut programlar kolayca değiştirilebilmelidir.
- 8- Cihazın mevcut çalışma hızı ve titreşim seviyesi ekranda görülmelidir.
- 9- Cihaz, yumuşak dokuya geldiği zaman kesmemelidir.
- 10- Cihaz, mobil RF parazitlerinden etkilenebilen elektromanyetik alanlarda kullanılacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 11- Başlık kablosu en az 2 mt. uzunluğunda olup, cihaza iterek mandallı sistem ile kolayca takılıp sökülebilmelidir. Başlık ve kablosu 135 dereceye kadar otoklavlanabilmelidir.
- 12- Başlık kablosunun içinden su akışı geçmelidir. Dışarıdan görünmemelidir.
- 13- Başlık kullanım esnasında dahi sıvı miktarı ayarlanabilme işlemi yapılabilir.
- 14- Cihaz ile birlikte verilen başlığın arka kapağını ampul değiştirmek için gerektiğinde gövdeden kolayca ayrılabilir.
- 15- Sistem ayaktan kumanda edilebilmelidir.
- 16- Cihaz taşınabilir olmalıdır.
- 17- Cihaz su pompası ile birlikte kontrol ünitesi, 2 m kablolu otoklavlanabilir ışıklı başlık, otoklavlanabilir kablo, ayak pedali, sterilizasyon kaseti,4 adet uç, uç standı, 1 adet serum veya şişe askısı, uç anahtarı,1 adet yedek VA ampul, verilmelidir.1 sağ 1 sol lateral 1 medial ve 1 dorsum için uç olmalıdır.
- 18- Cihaz 330*254*167 mm ölçülerinde ve 3.8 kg ağırlığında olmalıdır.
- 19- Cihaz ithal malı olup; ISO 9001 Kalite Güvence Sistemine ve CE Belgesine sahip olmalıdır.
- 20- Cihazın UBB kaydı olmalıdır.