



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Başhekimliği



SAYI :
KONU : Mal Alımı Hk.



Teklif Davet

Mad.1 Sağlık Tesisimizde Kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan Dolap alımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup, Söz konusu hizmet için KDV Hariç birim ve toplam fiyatını 22.03.2019 tarih ve saat 10:00 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faks / satinalmaeleskirtdh@gmail.com mal adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu; Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İş Müdürü

Sıra No	Malzeme Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	GÜVENLİK DOLABI MDF LAM (80X40X40)	1	ADET		
2	ÇALIŞAN DİLEK VE ŞİKAYET KUTUSU MDF LAM (30X25X20)	1	ADET		
3	İLAÇ DOLABI MDF LAM (120X110X30)	3	ADET		
4	SOYUNMA KABİNI MDF LAM (200X70X130)	1	ADET		
5	EMANET DOLABI MDF LAM (40X40X20)	1	ADET		
KDV HARIC TOPLAM TUTAR					

NOT: Teknik Şartname 4 sayfadır

Firma/ Kurum
Kase / İmza

- M.2 İdarenize doğrudan temin usulü ile 22.03.2019 tarih ve saat 10:00 da Dolap alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş,okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir.Doğrudan temin usulü ile yapacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususları içeren teklifinizin kabulünü arz ederiz.
- M.3 Eksik doldurulan üzerinde kazıntı ,silinti veya düzeltme yapılan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- M.4 Teklifler en geç 22.03.2019. GÜNÜ SAAT 10.00 kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir..
- M.5 Teklif Fiyatına işin sigortası,nakliyesi ve diğer tüm giderleri dahil edilecektir.
- M.6 Teklifler (Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç veilecektir.
- M.7 Tekliflerinde tarih, imza ve kaşesi eksik görülen isteklinin teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- M.8 Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin asıllarında İdaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- M.9 Teklifleri ile birlikte numune istenilmesi halinde numunesi olmayanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- M.10 .Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Oluz) gün olacaktır.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ



1 ADET MDF LAM 80 X 40 X 40 GÜVENLİK EMANET DOLABI

1 ADET MDF LAM 30 X 25 X 20 ÇALIŞAN DİLEK VE ŞİKAYET KUTUSU

3 ADET MDF LAM 120 X 110 X 30 İLAÇ DOLABI

1 ADET MDF LAM 200 X 70 X 130 SOYUNMA KABİNİ

1 ADET MDF LAM 40 X 40 X 20 EMANET DOLABI

Erdoğan GÜNEŞ
Teknisyen

Eleşkirt İleç Devlet Hastanesi
Erkan KATIRAMAN
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu

Emre Firtne Çelik
Jiriz

Ceylan ÖSUCUÇHAN


Nazife Erdoğan
Mj

Binnur SAYLAN
RAYAN



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

HASTA BAZLI İLAÇ DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

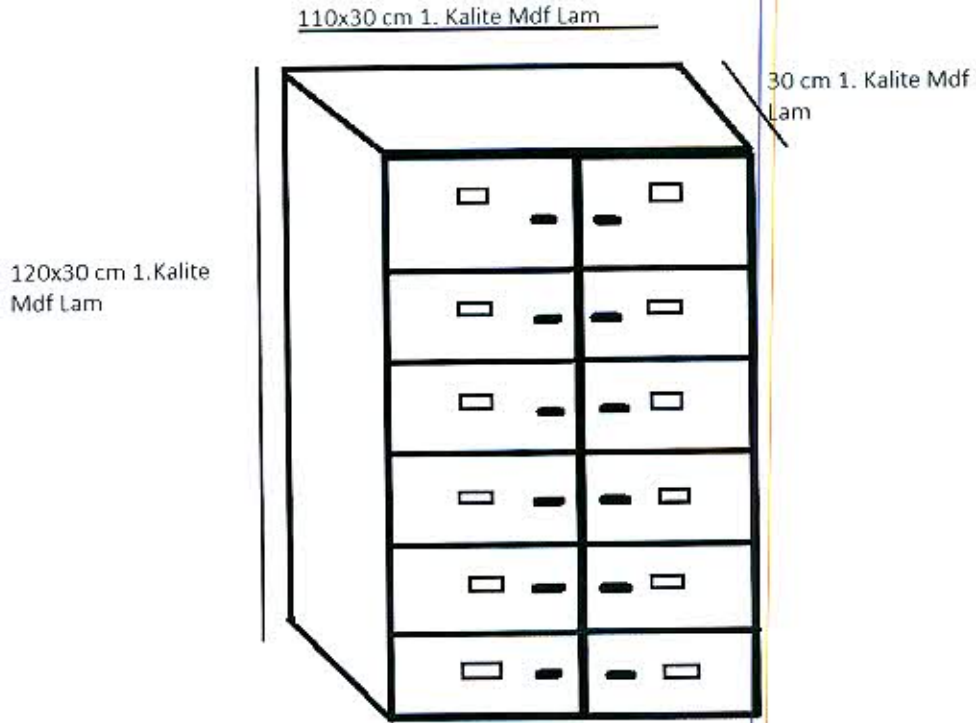

1-3 Adet 120x110x30 ebatlarında

2-1. Kalite Mdf Lam malzemesinden imal edilmelidir.

3-1 Dolapta 12 bölme ve her bölmenin kilidi açma kolu ve isimlik olması

4-Beyaz renk olması

5-İmal tarihinden itibaren imal edilen malzemenin bütün parçalarının 2 yıl garanti kapsamında olması

6-Montaj işleminin üreten firmaya ait olması

7-Kabul komisyonu üretilen malzemeyi gördükten sonra onay verilecek montaj işlemi komisyon olmaksızın yapılmayacak.


Pcari İnat Gelik
Teknisyen
Muhbir

GÜNEŞ
Teknisyon



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

GÜVENLİK EMANET ve ÇALIŞAN DİLEK ve ŞİKAYET KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

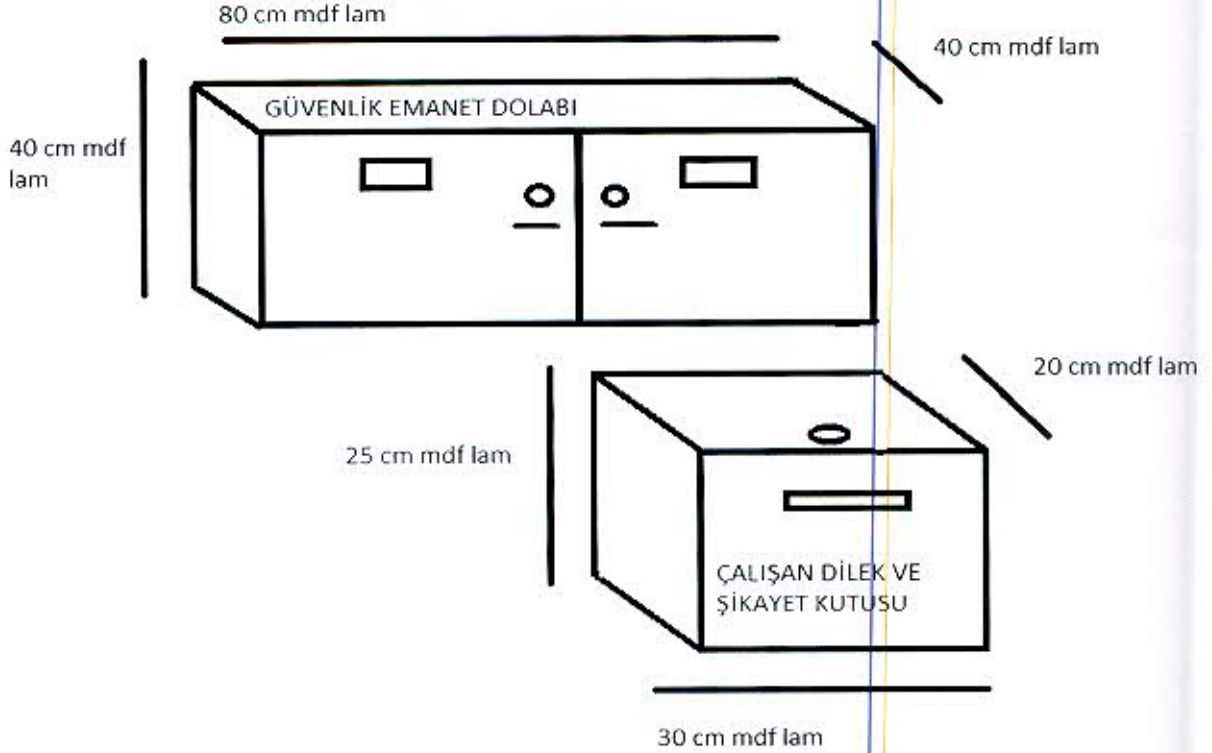

1-1 Adet 80x40x40 ebatlarında iki bölmeli 1 adet 30x25x20 ebatlarında tek bölmeli toplamda 2 adet yapılacaktır.

2-1. Kalite Mdf Lam malzemesinden imal edilmelidir.

3-1 Adet güvenlik emanet dolabı 2 bölmeli her bölmenin kilidi açma kolu olacaktır.

4-1 Adet çalışan dilek ve şikayet kutusu üstten açmalı kilitli ve a5 kağıt abatinin sığabileceği kadar bir boşluk yapılmalı. (Beyaz renkten imal edilecek)

5-İmal tarihinden itibaren imal edilen malzemenin bütün parçalarının 2 yıl garanti kapsamında olması

6-Montaj işleminin üreten firmaya ait olması

7-Kabul komisyonu üretilen malzemeyi gördükten sonra onay verilecek montaj işlemi komisyon olmaksızın yapılmayacak.

8-Örnek resimler şartnameye eklenmiştir.


Peari Pırat Çelik
Teknisyen
İmza

Erdoğan GÜNEŞ
Teknisyen



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

RÖNTGEN ÇEKİM ODASI HASTA SOYUNMA KABİNİ KAPISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

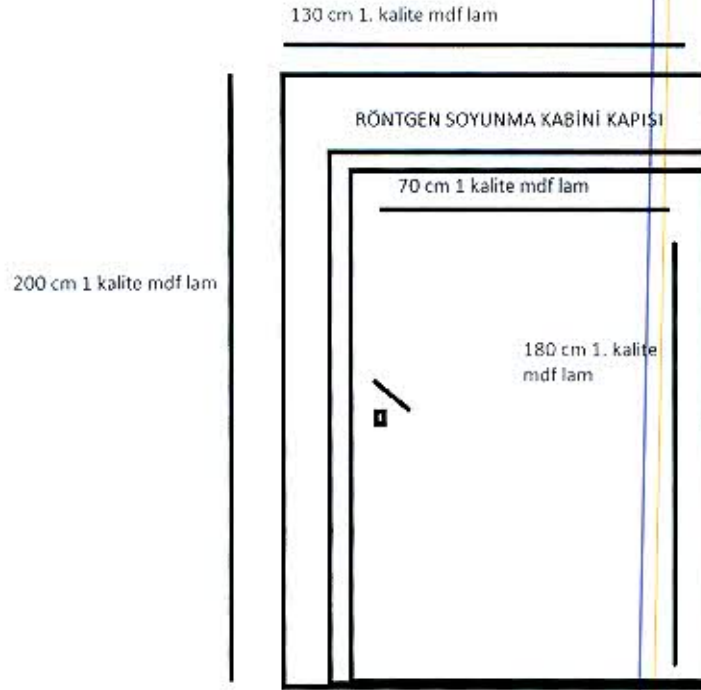

- 1-1 Adet 200x130x180x70 ebatlarında
- 2-1. Kalite Mdf Lam malzemesinden imal edilmelidir.
- 3-Kapıda çift taraflı açma kolu ve kilit bulunması gerekmektedir.
- 4-Beyaz renk olması
- 5-İmal tarihinden itibaren imal edilen malzemenin bütün parçalarının 2 yıl garanti kapsamında olması
- 6-Montaj işleminin üreten firmaya ait olması
- 7-Kabul komisyonu üretilen malzemeyi gördükten sonra onay verilecek montaj işlemi komisyon olmaksızın yapılmayacak.

Fecri Fırat Çelik
Teknisyen
Sarımsak

Erdogan GÜNEŞ
Teknisyen