



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 779
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 458

22.05.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.05.2019 saat: 16:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	LAM KAPAMA FİLMİ		50	Adet		
2	KSİLEN		100	Litre		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden

.../.../2019


Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

ALIM KISMİ TEKLİFLERE KAPALIDIR.

KSİLEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Açık formülü $C_6H_4(CH_3)_2$ molekül ağırlığı 106,17 olmalıdır.
2. Minimum % 99'luk ve yoğunluğu 0,86 g/ml (20 C'de) olmalıdır.
3. En fazla 5 (Beş)Lt.'lik şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.
4. Malzemenin bileşimindeki xylene izomeri oranı % 98,5-99,5 arasında olmalıdır.
5. İçerdiği su oranı % 0,01-0,02 arasında olmalıdır.
6. İçerdiği Ethylebenzene oranı maksimum % 4-5 olmalıdır.
7. Bileşimindeki Toluene oranı max. % 0,1 olmalıdır.
8. Kükürt oranı max. % 0,003 olmalıdır.
9. Üretici tarafından verilen sertifikası teslim edilmelidir.
10. Tekliflerde üretici, marka, kod ve ürün adı yanında belirttiğimiz özellikler yazılmalıdır. Yazılmayan teklifler değerlendirilmeyecektir. Farklı özelliklerde ürün veya alternatif ürün teklif edilmemelidir. Ürüne ait katalog veya broşür teklif öncesi laboratuvarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası en iyi birinci ve ikinci fiyatı teklif eden firmalar numunelerini laboratuvarımıza etiketleyerek teslim etmelidir.
11. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve verimlilik testi laboratuvarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. Numunelerin değerlendirmesi 1 hafta içerisinde yapılacaktır.
12. Onaylanan numunesinden ürün teslim etmeyen firma hakkında yasal işlem yapılacaktır
13. Bütün kimyasal maddeler için ürün güvenlik formu verilmesi zorunludur.

Uzm. Dr. Erdem AYIK
Patoloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 158178
Ağrı Devlet Hastanesi

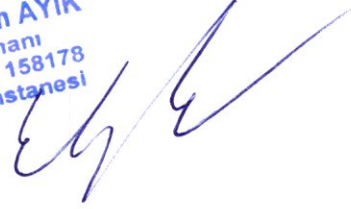

LAM KAPAMA FİLMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Her bir film rulosu ile 50 mm'lik en az 1400 adet lam kapatılabilmelidir.
2. Film selüloz triasetat, akrilik asit ester, metakrilik asit ester ve max 0.2 mg/cm² toluen içerikli malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Filmin kalınlığı mikroskopta fokus problemlerini önlemek amacıyla 115um ila 118um arasında olmalıdır.
4. Yapıştırıcı madde kullanımına gerek kalmaksızın sadece ksilen ile lamın üzerine kapatılabilmelidir.
5. Film ruloları 10 C ila 30 C arasında muhafaza edilebilmelidir.
6. Her film rulosu ambalajında barkod, katalog ve lot numarası, üretici firma, son kullanma tarihi, kullanım ve saklama koşulları vb. gibi bilgiler yer almalıdır.
7. Film en fazla 3 dakika içerisinde dokuya zarar vermeden çıkarılabilir özellikte olmalıdır. Film çıkarma prosedürü teklif veren firma tarafından yazılı olarak ihale dosyasında verilecektir. Bu prosedür laboratuvarında test edilecek ve uygunluğu kontrol edilecektir.
8. Film ile kapatılan lamlarda arşivleme sonrası açılma meydana gelmemelidir. Bu özellik en az 10 sene teklif edilen marka film ile kapama yapan yurtiçi ya da yurtdışı bir hastane tarafından yapılan arşiv çalışması ile teyit edilmelidir. Yapılan bu çalışmanın noter onaylı örneği ihale dosyasında bulunmalıdır.
9. Lam kapama filminin miadı en az 18 (onsekiz) ay olmalıdır.
10. 10. Film rulosu açıldıktan sonra oda sıcaklığında bekletmeye gerek kalmaksızın hemen kapama cihazına yerleştirilerek kullanılabilir özellikte olmalıdır.
11. Laboratuvarımızda kullanılan Kapama Cihazında kullanıma uygun olmalıdır. Cihazda takılma problemleri yaşanmamalıdır.
12. Cihazda filmlerden kaynaklı teknik bir sorun yaşanması durumunda her türlü yedek parça vb. masraflar ücretsiz olarak karşılanacaktır. Firmanın cihazda oluşacak arızalara müdahale edebilmesi için TSE den alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.
13. Ambalaj içerisinde filmlerin sıcaklıktan etkilenip etkilenmediğini gösteren termal kontrol kartları bulunmalıdır.
14. Ürüne ait UBB kaydı bulunmalı ve teklifte barkod numarası belirtilmelidir.
15. Filmlerle beraber laboratuvarımızda kullanılan cihaza uygunluğu üretici firma tarafından onaylı ve noter tasdikli onay belgesi ihale dosyasında bulunan Film Kesme Bıçağı verilmelidir. Her 10 adet film için 1 adet film kesme bıçağı bedelsiz olarak verilecektir.

Uzm. Dr. Erdem AYIK
Patoloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 198178
Ağrı Devlet Hastanesi

16. Teklif veren firma distribütör ise Türkiye Tek Yetkili Temsilcilik Belgesi, distribütör firmanın bayisi ise distribütöre ait Tek Yetkili Temsilcilik Belgesinin yanı sıra UBB bayi belgesi ihale dosyasında bulunmalıdır.

Uzm. Dr. Erdem AYIK
Patoloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 158178
Ağrı Devlet Hastanesi

