



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM FOLEY SONDA ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 26/07/2019 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-izmalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	FOLEY SONDA 3 YOLLU 20 NUMARA	ADET	50		
2	FOLEY SONDA 3 YOLLU 22 NUMARA	ADET	50		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-izmalıdır.

Uzm Dr Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta: serra.kirac@saglik.gov.tr İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 27db18a5-ecf4-4552-b1ff-60726552ab91 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

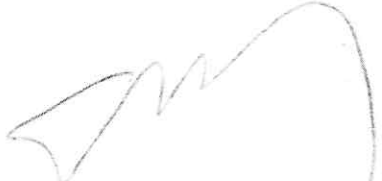
Bilgi için: Serra KIRAC

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

FOLEY SONDA ÜÇ YOLLU

1. Ürün slikolatex malzemedan imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürün 3 yollu olmalıdır. Vücuda zararlı olmamalıdır.
3. Atravmatik, silindirik uçlu, 2 adet drenaj deliği bulunmalıdır.
4. Balon şişirme kapasitesi en az 30 cc ye dayanıklı olmalıdır.
5. Ürünün valf mekanizması olmalıdır.
6. Ürün uzunluğu en az 40 cm. olmalı.
7. Hem sondanın hem paketin üzerinde ürünün üretildiği madde ve markası yazılı olmalıdır. İmalat ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazmalı.
8. Miyadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
9. Her bir kateter steril paketler halinde olmalıdır. Paket üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi yazılmalıdır.
10. Firma kliniklerin istediği size kateteri vermek zorundadır.


Dr. Dr. N. Eker
160883
Gözetim Ünitesi