



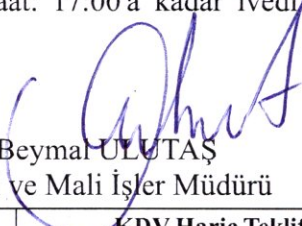
T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 405
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1342

20.11.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.11.2019 saat: 17:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	DİAGNOSTİK ANJİYOĞRAFİK KATETER 5F	FEMORAL DİAGNOSTİK KATETER	30	Adet		
2	DİAGNOSTİK ANJİYOĞRAFİK KATETER 6F	FEMORAL DİAGNOSTİK KATETER	70	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden

.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Alım Kısmi Tekliflere Kaplıdır.

FEMORAL DIAGNOSTİK KATETER (5F- 6 F) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Kateterlerin ucu soft tip ve atravmatik radyoopak yapıda olmalıdır.
2. Kateterler Full-wall teknolojiye sahip çelik tel örgü ile desteklenmiş olmalı, bu özelliği sayesinde yüksek dayanıklılık ve yüksek kink rezistansına sahip olmalıdır.
3. Kateterler 1200 psi basınca dayanıklı olmalıdır. İtilebilirliği ve döndürülebilirliği (torque özelliği) yüksek olmalıdır.
4. Kateterlerin materyeli Nylon-based polimer olmalıdır.
5. Kateterler ucundan hub bölümüne kadar Inslide polimer ile kaplanmış olmalı, bu kaplama sayesinde üstün kayganlık ve iletilebilirlik sağlamalıdır.
6. Kateterler geniş iç lümenle yüksek akış hızı sağlayabilmelidir.
7. Kateterlerin iç çapları 5F için en az 0.047'', 6F için en az 0.056'' olmalıdır.
8. Kateterlerin dış çapları 5f için 0.066'', 6F için 0.079'' olmalıdır.
9. Kateterlerin uzunlukları 100 cm olmalıdır. Bazı size'larda 110cm ve 125cm uzunluk alternatifleri bulunmalıdır.
10. Her türlü koroner arter ve aort yapısına uygun olarak kullanılacak curve seçenekleri bulunmalıdır. Kateterler Judkins left, Judkins right, Amplatz right, Amplatz left, Multipurpose, Pigtail ve Specialty (Noto-LCB-RCB-IMA) curve yapılarına sahip olmalıdır.
11. Kateter ucu radyopasitesi yüksek ve iyi görüntü vermelidir.
12. 1:1 Torque özelliği olmalıdır.
13. Kateterin proksimal ucunda benzersiz ergonomik kanatlı hub dizaynı olmalı, hub üzerinde renkli kodlama tekniği bulunmalıdır.
14. 0,038" Guidewire ile çalışacak iç lümen çapına sahip olmalıdır.
15. FDA veya CE belgesi olmalıdır.

Ağrı Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Ozkan KAYHAN
Dipl. Tes. No : 166277
Kardiyoloji Uzmanı