



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **MAICO MARKA ABR CİHAZININ KALİBRASYONU VE TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **19.01.2021 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.**

e-imzalıdır  
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KALİBRASYON ,BAKIM VE ONARIM HİZMET BEDELİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.

Uzm Dr Demet ÖKKE

Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47  
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

## TEKNİK ŞARTNAME

- 1.MAICO Marka CE-CHIRP Model Seri no:MA9020391 ABR Cihazının Ölçüm abartı kablosunun yıpranmasından kaynaklı değişimi yapılacaktır.
2. Cihaza entegre edilen yeni parçalardan kaynaklı uyum problemi ya da oluşacak teknik arızadan kaynaklı bir durum söz konusu olduğunda yüklenici firma ücretsiz olarak arızayı giderecektir.
- 3.Değişimi yapılan parçalar cihaza tam uyumlu olmalıdır.
- 4.Cihaz firmaya teslim edildiği tarihten itibaren 5(beş) iş günü içinde kalibrasyon ve bakım onarımı tamamlanıp hastanemize Biyomedikal Depo birimine teslim edilecektir.
- 5.Cihazın kargo ödemeleri yüklenici firmaya aittir.
- 6.Değişimi yapılan parçalar hastanemiz Biyomedikal depo birimine teslim edilecektir.
- 7.Değişimi yapılacak ara kablo görselleri teknik şartnamemiz ekinde sunulmuştur.
8. MAICO Marka CE-CHIRP Model Seri no:MA9020391 ABR Cihazının kalibrasyonunun yapılması gerekmektedir.
- 9.Test ölçüm aparatında bulunan sünger kısmının değişimi gerekmektedir.

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi  
Yunus Emre ÖZEN  
ODYO METRİST


T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi  
ÇAY BEYTER  
ODYO METRİST

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ  
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ  
Erdal ÇEVENÇİ  
Biyomedikal Sorumlusu


Görüşde bir kabloların komple Düzümlü



Kablo

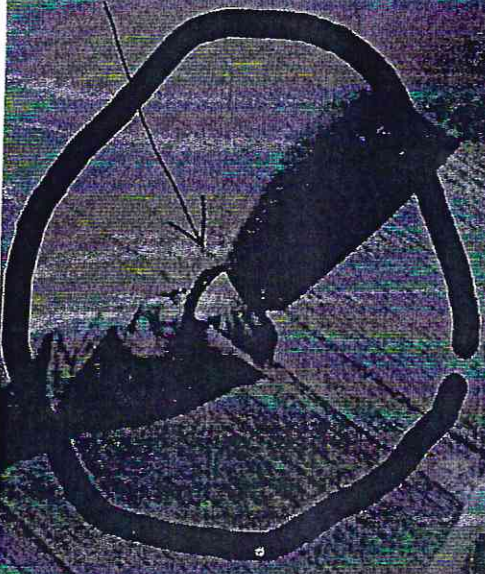

Garseld ki Sagar Kismat Digi...!

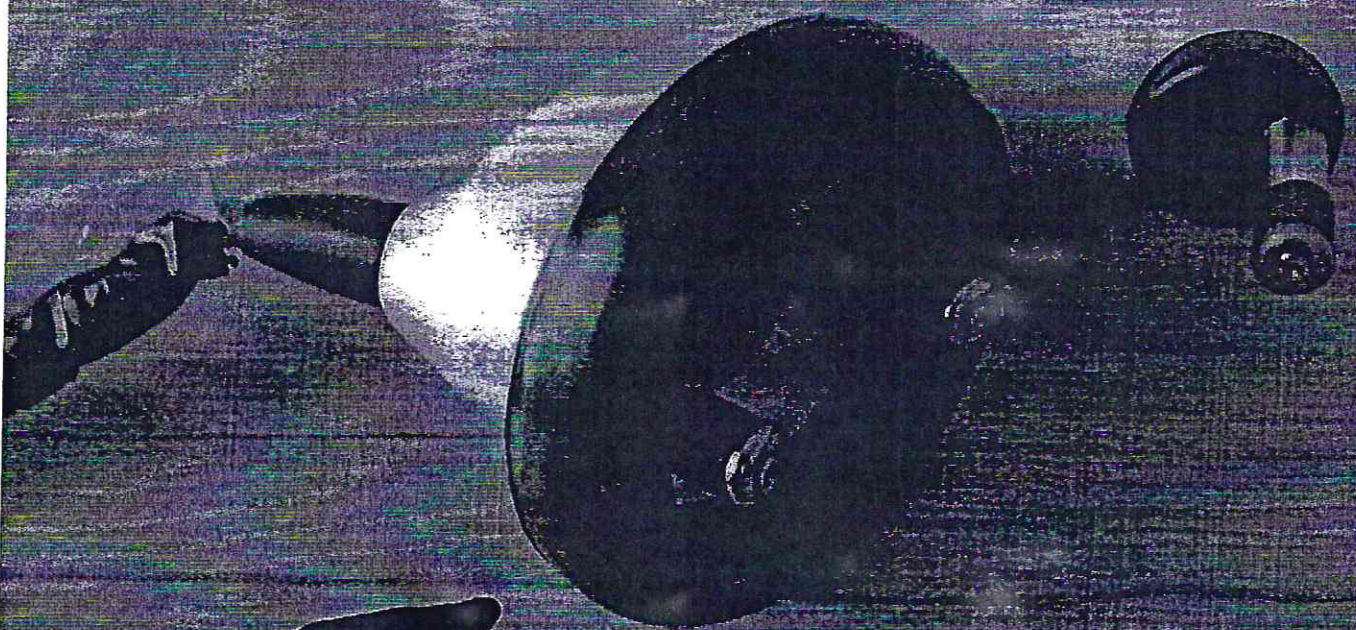

SAGAR

