



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 8 üzerinden 01.04.2024 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yakup AKKOYUN  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	FRİDGE-TAG2 HAFIZALI BUZDOLABI TERMOMETRESİ	1	Adet		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> <u>eleskirtdhsatinalma@gmail.com</u>				Teklif Eden ...../...../2024 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi


- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.


## FRIDGE-TAG TEKNİK ŞARTNAMESİ

(Fridge-tag® 2 internal sensor)

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- Ölçüler : 128 x 75 x 16 mm
- Ekran ölçüleri: 95 x 27 mm
- Ağırlık: 96 Gr
- Kayıt yapabilme : Ekrandan son 30 gün / Bilgisayara atarak son 60 gün kayıt görebilme
- Çalışma Aralığı : - 10 + 55°C
- Ölçüm Hassasiyeti : +/- %0.5°C
- Ekran: LCD
- Kayıt hafızası : Var
- Çalışma sıcaklığı : -30°C - +55°C
- Saklama sıcaklığı : -30° +60°C

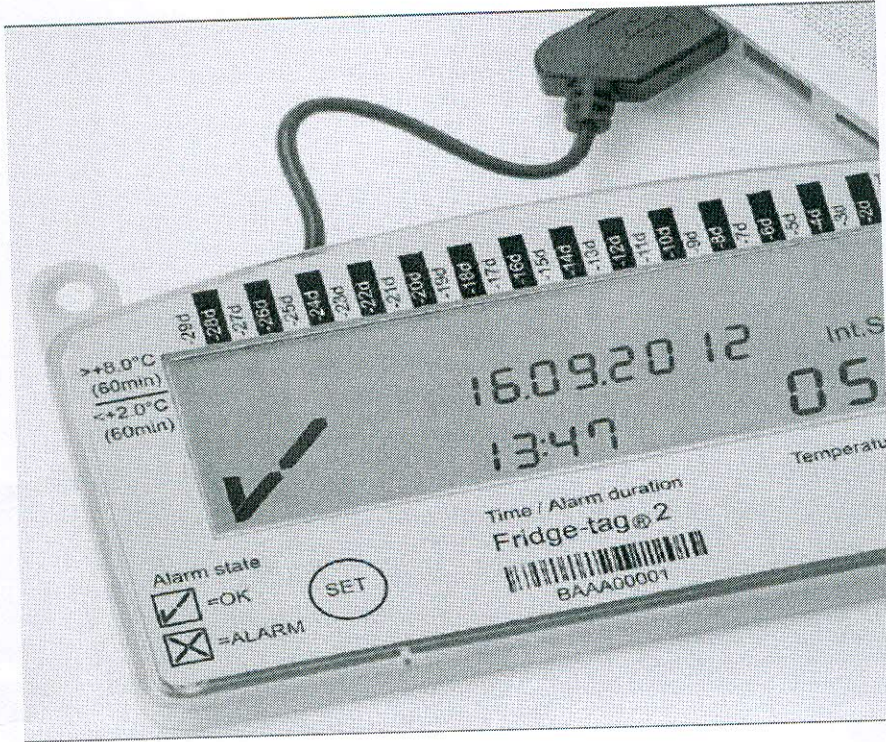

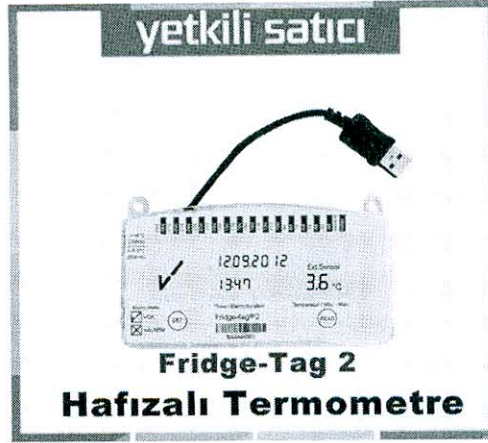

5.114,09 TL

5.114,09 TL den başlayan taksitlerle!

Kategori	: Multi Use Temperature Data Loggers , Aşı Takip Sistemi - Vaccine Temperature Data Logger
BarKod Kodu	: 8680395501218
Marka	: FRIDGE TAG
Stok Kodu	: TK2810
Fiyat	: 133,00 USD + KDV

1

SEPETERE EKLE

HİMEN AL

Kargo Bedava

Stoktan Teslim

[Favorilerime Ekle](#)
[Tavsiye Et](#)
[Yorum Yaz](#)
[Fiyat Alarmı](#)

Karşılaştır

[Ürün Bilgisi](#)
[Yorumlar](#)
[Önerileriniz](#)

## Hafızalı Buzdolabı Termometresi Fridge Tag -2 TEKNİK ŞARTNAME

1. Fridge Tag - 2, Soğuk Zincir'in ( +2°C ile +8°C arası) uzun süreli olarak kolay takip edilmesi amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
2. -10°C ile +45°C arasında rahatlıkla çalışabilir ve aynı sıcaklık aralığındaki değerleri ölçebilmelidir.
3. FRIDGE TAG-2 gün içerisinde gördüğü en yüksek ve en düşük sıcaklık ayarlarını hafızasında tutacak özellikte olmalıdır.
4. FRIDGE TAG, monitörü üzerinde saati ve anlık ısı ölçümünü gösterebilmelidir.
5. Fridge Tag-2 cihazı sıcaklık ölçümlerini geriye dönük 60 gün süre ile kayıt etme özelliklerine sahip olmalıdır, TAMKAN
6. Fridge Tag-2 monitörü üzerinde son 30 gün içerisinde soğuk zincirin kırılıp kırılmadığı, soğuk zincir kırılırsa 8 dereceden yukarıda veya 2 dereceden aşağıda olduğu takip edilebilmelidir.
7. Fridge Tag ve ölçüm güvenliği için cihaz içi açılmaz olmalı piline kullanıcı müdahale edilememelidir.
8. FRIDGE TAG-2 soğuk zincirin dışında 60 dakikadan uzun süre kaldığı takdirde ekranda 'ALARM' uyarısının, sürekli soğuk zincir ısı aralığında kaldığı takdirde ise, 'OK' uyarısının belirlenmesi özelliğine sahip olmalıdır.
9. Fridge Tag-2 sıcaklık ölçme hassasiyeti  $\pm 0,5$  ° C olmalıdır.
10. Cihazın ısı ölçümü yaptığı zaman aralıklarını gösterirken yanılma payı  $\pm 1$  dakikadan uzun olmamalıdır.
11. Cihaz, istenildiğinde bir USB bağlantısı aracılığı ile bilgisayara bağlanarak son 60 günlük sıcaklık değerleri PDF formatında rapor olarak verilebilmelidir.

## Fridge tag 2

YENİ FRIDGE TAG-2'nin Bazı Özellikleri :

Hafızalı buzdolabı derecesi(terмометresi) Fridge tag 2

- Ana kablosu ile bilgisayara veri akışı sağlayarak 60 günlük geçmiş kayıtları raporlaması
- Hafızasında 20 günlük kayıt tutabilmesi
- Dünya Sağlık Örgütü Onaylı
- Ekranında tarih ve saat özelliğinin olması
- Yeni arayüzü ve kullanım kolaylığı
- 24-36 ay çalışma ömrü

**Dünya Sağlık Örgütü Onaylı bir termometredir.**

- Ekranından 30 gün geriye doğru kayıtları görebilirsiniz
- Fridge Tag 2'yi USB girişinden bilgisayara bağladığınızda ise herhangi bir programa gerek kalmadan PDF formatında 60 gün geriye doğru kayıtları rapor alabilirsiniz.
- Ekran üzerinde görebileceğiniz tarih ve saat özelliği vardır.
- Kayıtları i endiniz herhangi bir yere not olarak değil de PDF formatında düzenli bir şekilde alacağınız için yapılabilecek hataların önüne geçebileceksiniz.
- Cihazın bulunduğu ortamın sıcaklık değeri +2°C ile +8°C arasında olması gerekmektedir.
- Fridge Tag son 30 gün içerisinde soğuk zincire yani +2°C' nin altında veya +8°C' nin üzerinde 60 dakika kalırsa Alarm uyarısı verir. Bu değerlerin dışına hiç çıkmamış ise; ekran OK (sorun yok) olacaktır.
- Cihaz gün içerisinde gördüğü en yüksek ve en düşük sıcaklık ayarlarını hafızasında tutar. (Max Min özelliği)
- Güvenlik nedeniyle cihazın içi hiçbir şekilde açılmaz, içindeki veriler değiştirilemez.
- Pili süresi yaklaşık 24 aydır. Pili değiştirmeden dolayı süre sonunda yeni bir cihaz almanız gerekmektedir.

Fridge tag 2 Türkiye genel hastane, eczane ve AŞM satışları ve satış sonrası destek hizmetleri, "Berklin Tıbbi ve Endüstri Materyalleri San. Tic. LTD. Şti firması olarak tarafımızdan yapılmaktadır.

Firmamız ürünleri yetkili bayilerden temin etmektedir.

## Fridge Tag 2 Hafızalı Buzdolabı Termometresi



Ekran üzerinde görebileceğiniz tarih ve saat özelliği vardır.

Ekranından 30 gün geriye doğru kayıtları görebilirsiniz.



Cihazın bulunduğu ortamın sıcaklık değeri +2°C ile +8°C arasında olması gerekmektedir.

Cihaz son 30 gün içerisinde soğuk zincire yani +2°C' nin altında veya +8°C' nin üzerinde 60 dakika kalırsa Alarm uyarısı verir. Bu değerlerin dışına hiç çıkmamış ise; ekran OK (sorun yok) olacaktır.

Cihaz gün içerisinde gördüğü en yüksek ve en düşük sıcaklık ayarlarını hafızasında tutar. (Max Min özelliği)

Fridge Tag 2'yi USB girişinden bilgisayara bağladığınızda ise herhangi bir programa gerek kalmadan PDF formatında 60 gün geriye doğru kayıtları rapor alabilirsiniz.

Kayıtları kendiniz herhangi bir yere not olarak değil de PDF formatında düzenli bir şekilde alacağınız için yapılabilecek hataların önüne geçebileceksiniz.

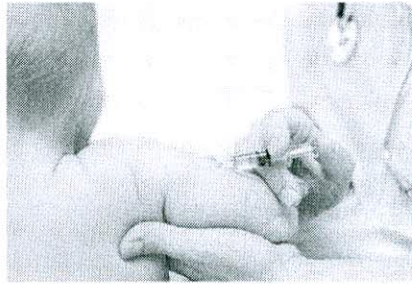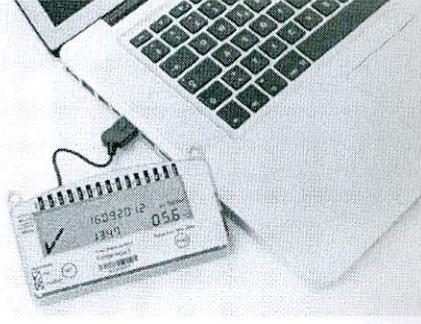

Fridge Tag 2 Dünya Sağlık Örgütü onaylı bir cihazdır. Aşılarda olması gerekenin dışında ısılarla maruz kaldıysa cihaz bunu kaydeder ve geleceğimiz olan çocuklarımıza faydasız aşı yapılmasının önüne geçmeye olanak sağlar.

Güvenlik nedeniyle cihazın içi hiçbir şekilde açılmaz, içindeki veriler değiştirilemez.

Pil süresi yaklaşık 24 aydır. Pili değiştirmeden dolayı süre sonunda yeni bir cihaz almanız gerekmektedir.

**& berlinger**  
feel safe

BENZER ÜRÜNLER