



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ AMELİYATHANE BİRİMİ İÇİN 2 KALEM CERRAHİ ALET ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.05.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar** 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	PRATT REKTAL SPEKULUM 80X25 MM 20.5 CM	ADET	1		
2	MATHIEU REKTAL SPEKULUM 90X15 MM 19.5 CM	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 10) Alımımız kısmi teklife açıktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 248c379da9cb4a6d-b9cb-fbc909b56abc Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>
Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Satın Alma Birimi

Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

i: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Dursun DİNLER

Veri Hazırlama ve Kontrol İŞlt.

Telefon No: (0 472) 312 60 47



CERRAHİ ALETLERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ


01. Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. İmalat veya tıbbi nedenler ile paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin teklif cetvelinde belirtilmesi zorunludur
02. Cerrahi Aletlerin üzerinde üreticinin fabrikanın adı, aletin katalog numarası, imal edildiği ülke ve paslanmaz çelikten olanlar üzerinde de " stainless steel " ibaresi silinmeyecek şekilde yazılı olacaktır. Bu özellikler ihaleye verilecek numuneler üzerinde de aranacak uygun olmayan numunelere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
03. Cerrahi Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olacaktır.
04. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli teklif edeceği Cerrahi Aletler şartnamede belirtilen aynı evsafta ve aynı fonksiyonları görecektir.
05. İstekli firmalar teklif ettiği cerrahi aletlerin marka ve katalog numaralarını ve evsaflarını belirteceklerdir. Teklif edilen cerrahi aletlerin şartnameye uyumluluğu aynı zamanda ihaleye verilecek üreticinin orjinal katalog ve broşürlerindeki bilgiler ile de teyid edilecektir.
06. İstekliler ihtiyaç listesinde belirtilen bir veya birden fazla sete teklif verebilirler. Ancak set bütünlüğünün korunması için teklif edilecek setin tamamına teklif verilmesi zorunludur. İstekli firmalar ürünlerine ait katalog numaralarını birim fiyat teklif cetveline ve şartnameye uygunluk belgesine yazmak zorundadırlar. Teklif veren firmanın kendi markasına ait katalog numaralarını bir veya birden fazla kalemde yazmaması yada özel üretim, eşdeğeri, benzeri gibi ibarelerle belirtmesi durumunda firmanın o sete ait teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
07. İthalat ve Tıbbi Cihazlar 93/42/ECC ve Dış Ticarete Standartizasyon yönetmelikleri gereği TSE'den ithalatı için uygunluk alınması zorunluluğu halinde, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden ithal edilecek ürünlerde istekli veya yüklenici bununla ilgili TSE Uygunluk Belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini sözleşme muhtevası malların idareye teslimi anında idareye vermekle yükümlü olacaktır.
08. Liste içeriğinde set veya setlerin tamamı veya bir kısmı için sterilizasyon kutusu istenmesi halinde, sterilizasyon kutusu ve uygun tel sepeti veya silikon çimi ile birlikte verilecektir. Firmalar verecekleri sterilizasyon kutularının ve tel sepetinin veya teflon çimlerin ebatlarını ve katalog numaralarını birim fiyat teklif cetvelinde ve teknik şartnameye verecekleri cevapta belirteceklerdir. Alet kutuları aşağıdaki evsafta olacaktır;
- a) Alet kutularının, kapak contası yüksek ısıya dayanıklı silikondan, kapak ve aletlerin konulacağı alt kısım alüminyum alaşımlı metalden üretilmiş olmalıdır.
- b) Kutu kapağında bakterilerin girmesini önleyici disposable olmayan uzun ömürlü filtre sistemi olmalıdır.
09. İhale dokümanı beyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli teklif edeceği Cerrahi Aletler şartnamede belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecektir. İstekli teklif dengi benzeri diğer marka aletleri de teklif edebilir. Aletlerin ana işlevini gören uç ve ağız kısmı, Tungsten Carbide veya benzeri metal yapısı açısından aynı olacaktır.

İstekli Firmaların
Teklif Cetvelini
06.09.2023
Saat: 14:00
Kadıköy
Kadıköy
Kadıköy
Kadıköy


Doc. Dr. YASAR ERGİLMAZ
DOĞU AYAZLI DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Gürkan İKİMAY
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 14113

Op. Dr. Salih ERGİLMAZ
Op. Dr. YASAR ERGİLMAZ
Doğruyazlı Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 158375
Uroloji Uzmanı

1	KR158.20	PRATT REKTAL SPEKULUM 80X25MM 20,5CM	1
2	KR162.19	MATHIEU REKTAL SPEKULUM 90X15MM 19,5CM	1

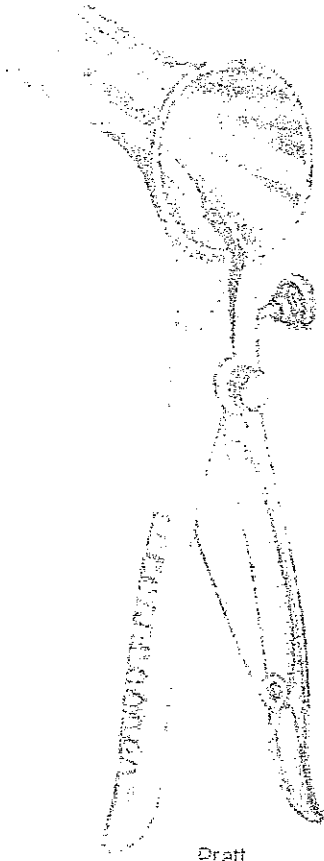

Pratt
KR158.20
80x25 mm
20.5 cm/8"



Mathieu
KR162.19
90x15 mm
19.5 cm/7¾"

Dr. Dr. Mustafa Kemal
Yıldırım
Dip. No: 146331

Doç. Dr. YAŞAR ERDOĞAN
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Gürkan İDİN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. No: 146331

Op. Dr. Saliha BÜSLÜKARA
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Dip. No: 146331
Üroloji Uzmanı