

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Patnos İlçe Sağlık Müdürlüğü

BARKOD CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek ürünün termal transfer ribonlu yazdırma / direkt Termal ribonsuz yazdırma özelliğine sahip olmalıdır.
2. Teklif edilecek ürünün çözünürlüğü en az 203 dpi olmalıdır.
3. Teklif edilecek ürün en az 8 MB SDRAM, 8 MB Flash hafızaya sahip olmalıdır.
4. Teklif edilecek ürünün baskı hızı en az 102 mm/s olmalıdır.
5. Baskı uzunluğu en az 990 mm kadar baskı yapabilmelidir.
6. 300 Adet Barkod Yazıcıda Bağlantı arabirimi en az 1 adet USB port olmalıdır.
7. Teklif edilecek ürün Türkçe fontların kullanımını desteklemelidir.
8. Teklif edilecek ürünün ağırlığı en fazla 2.8 kg. olup en fazla yükseklik 185 mm, en fazla genişlik 230 mm, en fazla derinlik 300 mm olmalıdır.
9. Teklif edilecek ürün 1D; Codebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved2-Of05, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 Databar (RSS-14), UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, barkod sembollerini basabilmelidir.
10. Teklif edilecek ürün 2D; Aztec, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, Micro PDF, PDF 417, QR Code barkod sembollerini basabilmelidir.
11. Teklif edilecek ürünün Windows USB Driver ve Barkod Tasarımı ve Basımı için ücretsiz bir yazılımı olmalıdır.
12. Teklif edilecek ürüne ait orjinal harici güç adaptörü (Türkiye’de kullanım amaçlı), bir adet ribon kılavuzu ve bir adet USB bağlantı kablosu beraberinde verilmelidir.
13. Teklif edilecek ürünün akıllı etiket sensörü olmalıdır, etiket boyunu ve tipini otomatik tanımalıdır.
14. Teklif edilecek ürünün garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.

Deniz Tuzen ERHAN

Mehmet DCLAT

Dr. Özkan KAÇAR
Patnos İlçe Sağlık Müdürü

15/02/2022

AĞRI DOĞUBAYAZIT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

**İÇİN ALINMASI PLANLANAN METAL DOSYA DOLABI 'NA AİT
TEKNİKŞARTNAME**

METAL KAPAKLI KİLİTLENEBİLİR DOSYA DOLABI

- 1) Yükseklik Aralığı (mm):1800-1999
- 2) Kapak Sayısı:2
- 3) Genişlik (mm):920Derinlik (mm):400Yükseklik (mm):1950
- 4) Üst Tabla Yüzey Kaplama Malzemesi:YOK
- 5) Kilit:VAR / EVET

DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI
Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğü
Dt. Turan SAYDAM
Dip.No:020653-Tesc.No:35130
İlçe Sağlık Müdürü

Cevat ASLAN
VİTRİ
C. Aslan

Tbb.Jeh. Barışıl 2022/4
A

08/03/2022

TAŞLIÇAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
İÇİN ALINMASI PLANLANAN METAL DOSYA DOLABINA AİT TEKNİK
ŞARTNAME

METAL KAPAKLI KİLİTLENEBİLİR DOSYA DOLABI

- 1) Yükseklik Aralığı (mm):1800-1999
- 2) Kapak Sayısı:2
- 3) Genişlik (mm):920Derinlik (mm):400Yükseklik (mm):1950
- 4) Üst Tabla Yüzey Kaplama Malzemesi:YOK
- 5) Kilit:VAR / EVET

BAŞKAN

Dr Abdullah Karateke
Taşlıcaç TSM Başkanı

ÜYE

Cansu Karateke

ÜYE

Hatice Kübra Oğuz
Hemşire

08/03/2022

AĞRI HAMUR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
İÇİN ALINMASI PLANLANAN METAL DOSYA DOLABI 'NA AİT TEKNİK
ŞARTNAME

METAL KAPAKLI KİLİTLENEBİLİR DOSYA DOLABI

- 1) Yükseklik Aralığı (mm):1800-1999
- 2) Kapak Sayısı:2
- 3) Genişlik (mm):920 Derinlik (mm):400 Yükseklik (mm):1950
- 4) Üst Tabla Yüzey Kaplama Malzemesi:YOK
- 5) Kilit:VAR / EVET

Dr Zeynep Nisa Polat



Ebe Serden GÖREN



Ebe Meryem Soray LEVENT



Ebe Ayşenur YARALI




T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Patnos İlçe Sağlık Müdürlüğü

METAL DOSYA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yükseklik Aralığı (mm):1800-1999
2. Kapak Sayısı:2
3. Genişlik (mm): 920 Derinlik(mm):400 Yükseklik(mm): 1950
4. Üst Tabla Yüzey Kaplama Malzemesi:Yok
5. Kilit:Var


Deniz Taylan ERHAN



Mehmet POLAT


Dr. Özkan KACAR
Patnos İlçe Sağlık Müdürü

LCD DUVAR ASKI APARATI

Min. TV Boyutu	15 İnce
VESA Ölçüleri	7.5x7.5 cm 10x10 cm
Çoklu Ekran Taşıma	Yok
Menşei	Türkiye
Maks. Taşıma Kapasitesi	22 kg
Kutu	Var, Açılmamış
Durum	Sıfır
Garanti Süresi	18 - 24 Ay
Garanti	Var, Başlamamış
Hareket Kabiliyeti	Sabit
Maks. TV Boyutu	26 İnce
Ürün Tipi	Duvar
TV Tipi	LCD, LED, OLED, QLED

Misafir Günes


M. Fahri Özcan Enyin Pazili
 Tuz!

KOMPRESÖR 2200 WATT

Teknik Özellikler

Güç	160 PSI / 10,3 Bar
Volt	0,46lt/dk. / 35 PSI
Hz	150 PSI / 10,3 Bar

Micahit Güneş
[Signature]

M. Şahin Özcan
[Signature]

Engin Korkmaz
[Signature]

DVD-RW TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Okuma Hızı
 - DVD+R : 16X
 - DVD-R : 16X
 - DVD+RW : 13X
 - DVD-RW : 8X
 - DVD-ROM : 16X
 - DVD+R(DL) : 12X
 - DVD+R(SL, M-DISC) : 12X
 - DVD-R(DL) : 12X
 - DVD-ROM(DL) : 12X
 - DVD-RAM : 5X
 - CD-R : 48X
 - CD-RW : 40X
 - CD-ROM : 48X
 - DVD Video Playback : 6X
 - VCD Playback : 24X
 - Audio CD Playback : 10X
- Yazma Hızı
 - DVD+R : 24X
 - DVD-R : 24X
 - DVD+RW : 8X
 - DVD-RW : 6X
 - DVD+R(DL) : 8X
 - DVD-R (DL) : 8X
 - DVD+R(SL, M-DISC) : 4X
 - DVD-RAM : 5X
 - CD-R : 48X
 - CD-RW : 24X
- Yazma Türleri
 - DVD+R & DVD+R (DL) : Sıralı Yazma
 - DVD-R & DVD-R(DL) : DAO/Artımsal Kayıt
 - DVD+RW : Rastgele Yazma
 - DVD-RW : DAO/Artımsal Yazma
 - CD-R/RW : DAO/TAO/SAO/Paket Yazma

Mücahit Güneş


M. Emin Özcan


Engin Perde


- **Eriřim Süresi**

DVD : 145 ms

CD : 125 ms

- **Arabirim**

SATA

- **İS Desteęi**

Windows® 10

Windows® 8

Windows® 7

Windows® Vista

Windows® XP

- **Sistem Gereksinimleri**

CPU: Intel Pentium® 300 MHz veya daha üstü

RAM: 128 MB veya daha fazlası gereklidir

HDD: 10GB veya daha üstü

- **Yazılım**

Cyberlink Power2Go 8

Cyberlink PowerBackup

E-Green

- **Disk apları**

12cm/8cm

- **Disk Biimleri**

Audio CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-Text, CD-ROM/XA, Multi-session CD, CD-R, CD-RW, DVD±R(SL/DL), DVD±RW, DVD-ROM(SL/DL), DVD-RAM, DVD Video

- **Montaj Őekli**

Dikey ve Yatay (+12° ~ -12°)

- **Boyutlar**

146 x 170 x 41 ~ mm (WxDxH)

- **Aęırlık**

650 Gr

- **Gü**

DC+5V ±5%,DC+12V ±10 %

- **Sıcaklık**

alıřırken : 5 C den 45 C ye kadar

Depolama : -20 C den 60 C ye kadar

- **Nem**

alıřırken : 20 % ~ 80 % (Yoęuřmasız)

Depolama : 15 % ~ 90 % (Yoęuřmasız)

Mücahit Güngör
[Signature]

M. Selim Özcan
[Signature]

Engin Ferit
[Signature]

DDR4 8GB 2600MHZ RAM

Teknik Özellikler

Ürün modeli: DDR4 U1

Ürün boyutu: 133,35 X 31,25 X 1,4 mm

Arayüz: DDR4

Kapasite: 8 GB

Bant genişliği: 2666 MHz

Toplu iğne: 288Pin

Çalışma Voltajı: 1.2V

CAS Gecikmesi: CL19

Garanti Süresi: Ömür boyu garanti

DDR4 Bellek U1

Masaüstünüz İçin Hız Artışı

Seçilmiş Yüksek Kaliteli IC Yongaları

Tak ve Çalıştır, Kullanımı Kolay

DDR4 Bellek ile Daha Yüksek Performans

Yüksek Uyumluluk

Mücahit Gönez


M. Sahn Özen


Enjin Perde


DDR3 8GB RAM 1600 MHZ

Teknik Özellikler

ModelValueRAM

Form FaktörüDIMM

Kullanım TipiPC

Bellek TürüDDR3

Bellek Hızı1600 MHz

Kapasite8 GB

Kit TipiTek Modül (1x8 GB)

CAS Gecikme DeğeriCL11

Pin240-pin


Voltaj1.5V


SoğutucuYok

RGBYok

Çalışma Sıcaklığı0°C ~ 85°C

Depolama Sıcaklığı-55°C ~ 100°C

Mücahit Güneş


M. Şahin Özdeş


Enayim Pazar


YÖNETİLEBİLİR 24 POR SWITCH

G/Ç Portları ve Slotlar4 SFP+ 1/10GbE port, 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 Class 4 PoE port (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ya da full; 1000BASE-T: full

İşlemci ve BellekARM Cortex-A9 @ 800 MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash; paket arabelleği: 1.5 MB

Desteklenen StandartlarIEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T / IEEE 802.3z 1000BASE-X / IEEE 802.2af PoE 1 (yalnızca PoE modeller) / IEEE 802.3at PoE 1 (yalnızca PoE modeller) / IEEE 802.3x Flow control / IEEE 802.1Q VLANS / IEEE 802.1p Priority / IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) / IEEE 802.1X Port Access Authentication / IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet / IEEE 802.1D: Spanning Tree Protocol / IEEE 802.1W: Rapid Spanning Tree Protocol / IEEE 802.1S: Multiple Spanning Tree Protocol / IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol / Denial of service protection / CPU DoS Protection

Boyutlar44.25 x 26.47 x 4.39 cm (1U yükseklik)

Ağırlık3.50 Kg

Performans Özellikleri

100 Mb Gecikme / Paket Boyutu < 4.7 uSec / 64B

1000 Mb Gecikme / Paket Boyutu < 2.4 uSec / 64B

10000 Mb Gecikme / Paket Boyutu < 1.3 uSec / 64B

Çıkış (Mpps) / Paket Boyutu95.23 Mpps / 64B

Anahtarlama Kapasitesi128 Gbps

Yönlendirme Tablosu Boyutu32 statik giriş

MAC Adres Tablosu Boyutu16.000 giriş

Güvenilirlik MTBF (yıl)76

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı32°F to 104°F (0°C to 40°C)

Çalışma Nemi15% to 95% @ 104°F (40°C)

Depolama Sıcaklığı-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)

Depolama Nemi15% to 95% @ 140°F (60°C)

Rakım10.000 fte (3 km) kadar

AkustikBasınç: 46.1 dBA Güç: 60.5 dB

Güç Özellikleri

Frekans50/60 Hz

AC Voltajı100 - 127/200 - 240 VAC

Akım2.6 / 1.3 A

Maksimum Güç234,0 W

Boşta Güç19,3 W

PoE Gücü195 W Class 4 PoE

Güç KaynağıDahili güç kaynağı

Diğer Özellikler

GüvenlikUL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/ CSA-C22.2 No. 60950-1; EN

60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 2368-1:2014

EmisyonVCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR

47 Part 15, Class A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A

Cihaz YönetimiAruba Instant On Portal; Web tarayıcı; SNMP Yöneticisi


Mücahit Güngör

M. Şahin Özcan

Engin Perçin



Korumalar
Genel CISPR 24 / CISPR 35
ENEN 55024:2010 / EN 55035:2017
ESD IEC 61000-4-2
Radiated IEC 61000-4-3
EFT/Burst IEC 61000-4-4
Surge IEC 61000-4-5
Dalgalanma IEC 61000-4-6
Güç Frekansı Manyetik Alanı IEC 61000-4-8
Gerilim Düşüşleri ve Kesintiler IEC 61000-4-11
Harmonik EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2
Titreşim EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3

M. İsmail Güneş


M. Şahin Özcan


Engin Peruh


SSD DİSK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bellek Kapasitesi: 240 GB


Disk Boyutu: 2.5 inç

Max Okuma Hızı / MB/s: 545 MB/s

Max Yazma Hızı / MB/s: 465 MB/s

Garanti Süresi: 24 Ay Garanti


Misrahit Güngör



M. Şahin Özcan


Engin Peşke


LCD DUVAR ASKI APARATI

Min. TV Boyutu	15 Inç
VESA Ölçüleri	7.5x7.5 cm 10x10 cm
Çoklu Ekran Taşıma	Yok
Menşei	Türkiye
Maks. Taşıma Kapasitesi	22 kg
Kutu	Var, Açılmamış
Durum	Sıfır
Garanti Süresi	18 - 24 Ay
Garanti	Var, Başlamamış
Hareket Kabiliyeti	Sabit
Maks. TV Boyutu	26 Inç
Ürün Tipi	Duvar
TV Tipi	LCD, LED, OLED, QLED

Mücahit Güneş


M. Selim Özcan


Enaym Perik


KOMPRESÖR 2200 WATT

Teknik Özellikler

Güç	160 PSI / 10,3 Bar
Volt	0,46lt/dk. / 35 PSI
Hz	150 PSI / 10,3 Bar

Mücahid Gövez



M. Şahin Özcan



Ençm Park



T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

TEKNİKŞARTNAME

- 1- CAT6 BAKIR KABLO 0,5 MM OLACAK
- 2- BAKIR OLACAK

RJ İNTERNET UC TEKNİKŞARTNAME

- 1-RJ 45 OLACAK
- 2-CAT 6 KABLOYA UYUMLU OLACAK

CCTV KABLO TEKNİKŞARTNAME

- 1-2+1 OLACAK
- 2-GÜVENLİK KAMERALARA UYUMLU OLACAK


Micahit Gövez



M. Şahin Öza


Engin Bilir


DVD-RW TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Okuma Hızı
 - DVD+R : 16X
 - DVD-R : 16X
 - DVD+RW : 13X
 - DVD-RW : 8X
 - DVD-ROM : 16X
 - DVD+R(DL) : 12X
 - DVD+R(SL, M-DISC) : 12X
 - DVD-R(DL) : 12X
 - DVD-ROM(DL) : 12X
 - DVD-RAM : 5X
 - CD-R : 48X
 - CD-RW : 40X
 - CD-ROM : 48X
 - DVD Video Playback : 6X
 - VCD Playback : 24X
 - Audio CD Playback : 10X
- Yazma Hızı
 - DVD+R : 24X
 - DVD-R : 24X
 - DVD+RW : 8X
 - DVD-RW : 6X
 - DVD+R(DL) : 8X
 - DVD-R (DL) : 8X
 - DVD+R(SL, M-DISC) : 4X
 - DVD-RAM : 5X
 - CD-R : 48X
 - CD-RW : 24X
- Yazma Türleri
 - DVD+R & DVD+R (DL) : Sıralı Yazma
 - DVD-R & DVD-R(DL) : DAO/Artımsal Kayıt
 - DVD+RW : Rastgele Yazma
 - DVD-RW : DAO/Artımsal Yazma
 - CD-R/RW : DAO/TAO/SAO/Paket Yazma

Micahit Gires


M. Erol Özcan


Engin Paçıl


EKRAN KARTI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GPU Motor Özellikleri:	GPU	NVIDIA Geforce GT730
	GPU KODU	GF108-300/400-A1
	Akış İşlemcileri	96SP
	Motor Saati	700MHz
Bellek Özellikleri:	Video belleği	4 GB DDR3
	Bellek Veriyolu	128-Bit
	Hafıza saati	1333MHz
Teknoloji Desteği:	PCI Ekspres	2
	DirectX Desteği	DirectX 11.2
	OpenGL	4.3
	Ekran Çıkışları	1 x HDMI 1 x DVI 24+5 PİN x VGA
	HDCP Desteği	Evet
	Maksimum Dijital Çözünürlük	2048 x 1536 D-sub Çözünürlük 3840 x 2160 Dijital Çözünürlük
	Güç Kaynağını Önerin	300W
	Güç tüketimi	49W
	Güç girişi	Hiçbiri
	Maksimum sıcaklık	98C
	İşletim Sistemini Destekleyin	10/8/7 kazan
	Aksesuarlar	1 x Sürücü CDsi 1 x Kullanım Kılavuzu

Miçerhit Güner


M. Cahin Özcan


Ergül Özkök


- **Eriřim Süresi**

DVD : 145 ms

CD : 125 ms

- **Arabirim**

SATA

- **İS Desteęi**

Windows® 10

Windows® 8

Windows® 7

Windows® Vista

Windows® XP

- **Sistem Gereksinimleri**

CPU: Intel Pentium® 300 MHz veya daha üstü

RAM: 128 MB veya daha fazlası gereklidir

HDD: 10GB veya daha üstü

- **Yazılım**

Cyberlink Power2Go 8

Cyberlink PowerBackup

E-Green

- **Disk Çapları**

12cm/8cm

- **Disk Biçimleri**

Audio CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-Text, CD-ROM/XA, Multi-session CD, CD-R, CD-RW, DVD±R(SL/DL), DVD±RW, DVD-ROM(SL/DL), DVD-RAM, DVD Video

- **Montaj Şekli**

Dikey ve Yatay (+12° ~ -12°)

- **Boyutlar**

146 x 170 x 41 ~ mm (WxDxH)

- **Ağırlık**

650 Gr

- **Güç**

DC+5V ±5%,DC+12V ±10 %

- **Sıcaklık**

Çalışırken : 5 C den 45 C ye kadar

Depolama : -20 C den 60 C ye kadar

- **Nem**

Çalışırken : 20 % ~ 80 % (Yoęuşmasız)

Depolama : 15 % ~ 90 % (Yoęuşmasız)

Mücahit Gürsoy


M. Şahin Özcan


Engin Poylu


ETHERNET PORTLU LASER YAZICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ayrıntılı teknik özellikler

Yazıcı Motoru

Baskı hızı

Tek taraflı: Dakikada 28 sayfaya kadar (A4)
Çift taraflı: 17,8 ipmye kadar (A4)

Baskı yöntemi

Siyah beyaz lazer baskı

Baskı kalitesi

1200 x 1200 dpiye kadar

Baskı Çözünürlüğü

600 x 600 dpiye kadar

Isınma Süresi

Yaklaşık 15 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)

İlk Sayfa Çıkış Süresi

Yaklaşık 5,2 saniye

Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 250 - 2500 sayfa

Aylık çalışma hacmi

Maks. Ayda 30.000 sayfa1

Yazdırma kenar boşlukları

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm
Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)

Gelişmiş baskı özellikleri

Google Cloud Print Uyumlu
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

DOĞU YAZICI EKİPMANLARI
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambasörlük

Enayn Başlı
10/11

Mücahit Güneş
10/11

Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

Ortam kullanımı

Kağıt girişi (Standart)

250 yapraklık kaset
1 yapraklık çok amaçlı tepsi

Kağıt çıkışı

50 yaprak

Ortam türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İyi Kalite Kağıt, Etiket, Zarf

Ortam boyutları

Kaset:

A4, A5, A5 (Yatay), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, A5 (Yatay), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Zarf (COM10, Monarch, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.

Kağıt ağırlıkları

Kaset: 60 ila 163 g/m²
Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m²

Çift Taraflı Yazdırma

Otomatik (Yalnızca A4/LTR/LGL/OFFICIO/B-OFFICIO/M-OFFICIO/FLS, 60 - 105 g/m²)

Genel özellikler

Güç gereksinimleri

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

Güç Tüketimi

DOĞRUYA YAZILAN
DOĞRUYA ZİT DEĞİL
FİŞİNİZİ DOĞRUYA TAKIN
Ayarlar

Engin Parıld
Pard

Micahat Ginoz
Ginoz

Yazı tipleri

45 PCL yazı tipi

Arabirim ve bağlantı

RJ45 ETHERNET PORTU 10/100 USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX,
Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

Yazılım ve yazıcı yönetimi

Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI),
Toner Durumu Aracı

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 /
Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 /
Mac OS X sürüm 10.8.5 ve üzeri / Mac OS 10.13 ve üzeri
Linux5

DOÇDR. YASAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
FİKRİ EKİNGÖR
Araştırma Uzmanı

Erhan Barak
Erb

Mücahit Güneş
MGG

ÇOK FONKSİYONLU LASER YAZICI

GENEL

Genel tipSiyah Beyaz A4 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi
HızDakikada 35 sayfaya kadar A4 baskı
Çözünürlük300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi
Isınma süresiYaklaşık 17 sn. veya da az
İlk baskı çıkış süresiYaklaşık 6.8 sn. veya daha az
İlk kopya süresiYaklaşık 6.9 sn. veya daha az
Boyut (G x D x Y)417 x 412 x 437 mm
AğırlıkYaklaşık 19 kg
Güç tüketimiKopya/Baskı: 661 W, Hazır mod: 21 W, Uyku modu: 1 W,
Güç kaynağıAC 220 ~ 240 V, 50 Hz
Ses (ISO 7779)Ses (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296) Kopya/Baskı:
47.2 dB(A) LpA, Sessiz : 44.1 dB(A) LpA, Bekleme modu: Ölçülemeyecek kadar
düşük Uyku modu: Ölçülemeyecek kadar düşük
Güvenlik standartlarıTÜV/GS, CE - Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO
14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.
Genel hafızaStandart 512 MB, maks. 1.536 MB

KAĞIT KULLANIMI

Giriş kapasitesi100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5,
B6, Letter, Legal, Özel (70 x 148 - 216 x 356 mm); 250 sayfalık universal
kağıt kasedi 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 x 148 -
216 x 356 mm)
Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi850 sayfa
Dubleks ünitesiStandart dubleks ünitesi 60-163 g/m² A4, A5, B5, Letter,
Legal desteklemektedir
Maksimum çıktı kapasitesi150 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt sensörü ile
Doküman işlemcisi50 sayfalık, 50-160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6 Letter,
Legal, Özel (100 x 148 - 216 x 356 mm)
Genel kağıt kullanımıTüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm
kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre
şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

YAZICI

İşlemci800 MHz
Kontrol diliPRESCRIBE IIe
EmülasyonlarPCL6 (PCL 5e/PCL-XL), Postscript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print,
XPS/OpenXPS
Yazı tipleri/barkodlarPCL6/KPD L3 için 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi,
Windows Vista için 8 yazı tipi, 1 bitmap yazı tipi, 45 tip barkodlar (ör.
EAN 8, EAN 13) otomatik sağlama toplamı üretimi ile ayrıca PRESCRIBE
altında iki boyutlu barkod PDF-417 (PCL ve diğer barkodlar opsiyonel olarak
var)
Uyumlu işletim sistemleriTüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X
10.5 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri

FOTOKOPİ

Maks. orijinal ebadıA4(Platen) / Legal(DP)
Dijital özelliklerBir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si
1'de, 4'ü 1'de, kimlik kopyalama, öncelikli baskı, program, sürekli tarama,
otomatik kaset değiştirme, kopya yoğunluk kontrolü
Işıklandırma moduManuel: 9 aşamalı
Standart büyütme oranları7 Küçültme / 5 Büyütme
Zoom% 25 - 400 (%1'lik adımlarla)
Sürekli kopyalamal-999 (opsiyonel hafıza kartı ile)
Görüntü ayarlarıMetin + foto, metin, foto, harita

DOĞUŞEHİR SAĞLIK MERKEZİ
DOĞUŞEHİR HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Amel Birim

Erdoğan Birim

M. Cahit Güneş

TARAYICI

Sıkıştırma metoduMMR/JPEG

Dosya formatıTIFF, PDF, PDF/A-1, yüksek sıkıştırılmış PDF, şifreli PDF, JPEG, XPS

ÖzelliklerEntegre adres defteri, LDAP, şifreli data gönderim, boş sayfa atlama

Orijinal tipiMetin+ foto, foto, metin, ince metin/iyi satır, metin (OCR için)

Maks. tarama ebadıA4 (Platen), Legal (DP)

ÖzelliklerE-maill'e tarama (SMTP), FTP'ye tarama (FTP over SSL), SMBv3'e tarama, USB Host'a tarama, TWAIN (USB, ağ), WSD (WIA) tarama (USB, ağ)

Tarama çözünürlüğü300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (Varsayılan), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi

Tarama hızı140 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b); 23 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli)

ARABİRİMLER

Standart arabirimUSB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, opsiyonel SD/SDHC Card için slot

DOĞRU YAŞAM BİRLİKTE
DOĞRU YAŞAM BİRLİKTE
FİGÜRATİF HASTANESİ
ABDÜL KADİR
ABDÜL KADİR

Enayn Beke
Beke

Mücahit Gines
Mücahit Gines

24 INCH MONİTÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Teknik özellikler

Monitör Boyutu	23,8 inç
Parlaklık	250 nit
Kontrast Oranı	1000:1
Tepki Süresi	4ms/6ms/14ms (aşırı/varsayılan/kapalı)
Panel Tipi	Düzlem İçi Anahtarlama
Stand	Tilt
EPEAT	Altın
AB Enerji Derecelendirmesi	Yok
Enerji Yıldızı	7
Marka	ThinkVision
Entegre Hoparlör	Yok
VESA Montajı	Evet
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080
Bağlantılar	VGA, DP1.2
Ekran tipi	IPS
Parlaklık	250 cd/m2
En Boy Oranı	16:9
Stand	Tilt
Yenileme Süresi	4 ms
Ekran Aydınlatması	LED arka ışığı
Ekran Dahili Maksimum Renk	16.7 Milyon
Kontrast Oranı	1000:1
İzlenebilir Görüntü Boyutu İnç	23.8
Güç Kaynağı Türü	Dahili
Yükseklik (ABD)	15,9 inç
Genişlik (ABD)	21,8 inç
Derinlik (ABD)	8,07 içinde
Ağırlık (ABD)	7,72 libre
Boy uzunluğu	404 mm
Genişlik	554 mm
Derinlik	205 mm
Ağırlık	3.5 kg
eğim	-5 ila 22 derece
Monitör Teknolojisi	IPS

DOÇ.DR.YAKAR EKİLEKÇİ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTAHANASI
Fikret ERDOĞAN
Ambasörlüğü

Engin Borlu
Tuz

Misafir Güneş
Atilla

Yatay Görüş Açısı	178 derece
Min Çalışma Nemi	%10
Maksimum Çalışma Nemi	%80
Min Çalışma Sıcaklığı	0 C
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	40 C
EPEAT	Altın
Diğer bilgiler	Microsoft Windows 7, Windows 10
Garanti Türleri	Müşteri Teslimiyle veya Posta Yoluyla Hızlı Değişirme Hizmeti
Garanti süresi	İki yıl
Paket boyutları	399*140*617mm

Feyziye Beke
RP
Uy:

Micahit Güner
Uy:

DOĞUBAYRAK MEVLEK 47
DOĞUBAYRAK HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ardan Birimi

19 İNCH MONİTÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran Tipi: Dar Çerçevesiz Tasarım Düz Ekran
Panel Boyutu: 19,5" (16:9)
Görüş Açısı: H90/V65
Maksimum Parlaklık: 220cd/m2
Maksimum Kontrast Oranı: 500000/1(Dinamik)
Yenileme Hızı: 75Hz
Tepki Süresi: 5ms
İdeal Çözünürlük: 1600X900@75Hz
Renk Sayısı: 16.7M
Giriş: 1xVGA + 1xHDMI

---Teknik Özellikler---

Panel Boyutu: 19,5"
Panel Tipi: TN
En Boy Oranı: 16:9 Geniş Ekran
Çözünürlük: 1600X900
Panel Arka Işığı: LED
Maks. Parlaklık: 220cd/m2
Maks. Kontrast Oranı:500000/1(Dinamik)
Renk Sayısı: 16.7M
Görüş Açısı: H90/V65
Tepki Süresi: 5ms
Yenileme Hızı: 75Hz
Ekran Yüzeyi: Parlak değil
Giriş: 1xVGA + 1xHDMI
VESA: 100x100mm (4 delik)
Adaptör: GİRİŞ 90-260V~1A 50/60HZ ÇIKIŞ 12V DC===2,6A(3,3A)
Aksesuarlar: Güç kablosu, Adaptör, VGA kablosu, Kullanım Kılavuzu
Boyutlar Monitör (UxDxY): 462x200x350mm (standlı)
Boyutlar Renk Kutusu (UxGxY): 520x102x402mm
Net Ağırlık: 2.0Kg
Brüt Ağırlık: 2.8Kg

DOĞRU YAŞAM İÇİN
DOĞRU YATILMA İÇİN
Fikret ERDOĞAN
A. Akbal

Enayn Bardi
Ali

Mücahit Güneş
Ali

**TAM DONANIMLI
BİLGİSAYAR
TEKNİK
ÖZELLİKLERİ**

İşlemci	10. Nesil Intel® Core™ i9 vPro'ya kadar işlemci seçenekleri
İşletim Sistemi	Windows 10 Home 64
Bellek	8GB DDR4 (4 UDIMM)
Depolama	500gb M.2 PCIe SSD
Grafik Donanımı	AMD Radeon™ RX550X
Ölçüler	340mm x 145mm x 281mm / 13,4" x 5,7" x 11"
Ağırlık	7kg

DOÇ.DR.YASAR ERİMLİMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERİMLİMAZ
Arıbaşı Birliği

Engin Başoğlu
Amir

Micahit Göçer
Amir

Hacim 13,6L

Renk Kuzgun Siyah

Bağlanırlık

- WiFi 6 802.11 AX + Bluetooth® 5.0
- WiFi 5 802.11 AX + Bluetooth® 5.0

ThinkShield
Güvenliği

- dTPM 2.0 çipi
- BIOS Tabanlı Akıllı USB Koruması
- İsteğe bağlı: Intel vPro® platformu
- İsteğe bağlı: Kensington kilidi
- İsteğe bağlı: Asma kilit kancası
- İsteğe bağlı: Şasi E-kilidi
- İsteğe bağlı: Akıllı kablo klipsi

3 adede kadar bağımsız monitörü destekler

Klavyeden başlatma

Yönetilebilirlik

4 bağlantı noktalı LAN eklenti kartı

4 bağlantı noktalı COM eklenti kartı

Ön:

Bağlantı
Noktaları/Yuvalar

- USB-C
- 2 adet USB 3.1 Gen 2
- 2 adet USB 3.1 Gen 1
- Kombine kulaklık / mikrofon
- İsteğe bağlı: 3'ü bir arada kart okuyucu

Arka:

- 4 adet USB 3.1 Gen 1

DOÇ. DR. YASAR ERYILMAZ
DOÇ. DR. BAYAZET DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Acil Servis Birimi

Enişir Parde
Cupri

Mücahit Güneş
Altın

	<ul style="list-style-type: none"> • Ses çıkışı • HDMI • 2 adet DisplayPort • 2 adet Seri (biri isteğe bağlı) • RJ45 • İsteğe bağlı: Paralel
Genişletme Yuvaları	<ul style="list-style-type: none"> • 2 adet PCIe x 16 • PCIe x 1
M.2 Yuvaları	<ul style="list-style-type: none"> • M.2 SSD veya Intel® Optane™ • M.2 WiFi
Harici Bölme	İnce Optik Disk Sürücü
Güç Kaynağı	380W, %92
Çevre Sertifikasyonları	<ul style="list-style-type: none"> • Energy Star® 8.0 (yapılandırmaya bağlı olarak değişmektedir) • EPEAT® Silver • TCO 8.0 • RoHS • ERP LOT3 • TÜV Rheinland Düşük Gürültü

Monitör Teknik özellikler

Monitör Boyutu	23,8 inç
Parlaklık	250 nit
Kontrast Oranı	1000:1
Tepki Süresi	4ms/6ms/14ms (aşırı/varsayılan/kapalı)
Panel Tipi	Düzlem İçi Anahtarlama

DOÇ.DR.YASAR ERGİLMAZ
DOÇ.BAYAZIT NEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambul Birimi

Engin Perke

Mehmet Güneş

Stand	Tilt
EPEAT	Altın
AB Enerji Derecelendirmesi	Yok
Enerji Yıldızı	7
Marka	ThinkVision
Entegre Hoparlör	Yok
VESA Montajı	Evet
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080
Bağlantılar	VGA, DP1.2
Ekran tipi	IPS

Parlaklık	250 cd/m2
En Boy Oranı	16:9

Stand	Tilt
Yenileme Süresi	4 ms
Ekran Aydınlatması	LED arka ışığı
Ekran Dahili Maksimum Renk	16.7 Milyon
Kontrast Oranı	1000:1
İzlenebilir Görüntü Boyutu İnç	23.8
Güç Kaynağı Türü	Dahili
Yükseklik (ABD)	15,9 inç
Genişlik (ABD)	21,8 inç
Derinlik (ABD)	8,07 inç
Ağırlık (ABD)	7,72 libre
Boy uzunluğu	404 mm
Genişlik	554 mm
Derinlik	205 mm
Ağırlık	3.5 kg
eğim	-5 ila 22 derece
Monitör Teknolojisi	IPS
Yatay Görüş Açısı	178 derece
Min Çalışma Nemi	%10
Maksimum Çalışma Nemi	%80
Min Çalışma Sıcaklığı	0 C
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	40 C
EPEAT	Altın
Diğer bilgiler	Microsoft Windows 7, Windows 10
Garanti Türleri	Müşteri Teslimiyle veya Posta Yoluyla Hızlı Değişirme

DOÇ. DR. Y. SAR ERYILMAZ
DÜZCE İLİ DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birişimi

Engin Başak
R. P. 1

Micalit Güneş
A. H. 1

Garanti süresi	Hizmeti
Paket boyutları	İki yıl
	399*140*617mm

Klavye mouse Set Multimedya q klavye

MOUSE:

Algılayıcı teknolojis: Logitech Gelişmiş Optik İzleme

Çözünürlük: 1000 dpi

Pil ömrü: 18 ay*

Pil: 1-AA

Açma/Kapama düğmesi: Evet

Düğme sayısı: 3

Kaydırma Tekerleği: Evet

Eğim özelliği: Hayır

Unifying özellikli mouse: Hayır

Unifying özellikli alıcı: Hayır

Kablosuz çalışma mesafesi: 10 m maksimum**

Kablosuz sistem: Gelişmiş 2,4 GHz kablosuz bağlantı

Bağlantı Arayüzü: USB alıcı

* Pil ömrü, ofis ortamında yılda tahmini iki milyon tuş vuruşuna göre hesaplanmıştır. Farklı kullanıcılarda farklı süreler söz konusu olabilir.

** Kablosuz kapsama alanı kullanıma, ayarlara ve ortam koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Boyutlar

Klavye

Uzunluk: 447,2 mm (17,61 inç)

Genişlik: 186,7 mm (7,35 inç)

Yükseklik: 21,4 mm (0,84 inç)

Ağırlık: 603 g (1,33 libre)

Mouse

Uzunluk: 105,4 mm (4,15 inç)

Genişlik: 67,9 mm (2,67 inç)

Yükseklik: 38,4 mm (1,51 inç)

Ağırlık: 86,4 g (0,019 libre)

DOÇ.DR.YAŞAR ERGİLMEZ
DÜŞÜNCE VE DEVLET HAYATININ
Bakanları ERDOĞAN
Bakanları Birimi

Engin Paik
Paik

Mehmet Güneş
Güneş

KLAVYE:

Pil ömrü: 3 yıl*

Pil: 2-AAA

Açma/Kapama düğmesi: Evet

Medya denetimi için 12 adet geliştirilmiş F tuşu ile birlikte tam boyutlu tuş düzeni

Unifying özellikli klavye: Hayır

Unifying özellikli alıcı: Hayır

Kablosuz çalışma mesafesi: 10 m maksimum**

Kablosuz sistem: Gelişmiş 2,4 GHz kablosuz bağlantı

* Pil ömrü, ofis ortamında yılda tahmini iki milyon tuş vuruşuna göre hesaplanmıştır. Farklı kullanıcılarda farklı süreler söz konusu olabilir.

**Kablosuz kapsama alanı kullanıma, ayarlara ve ortam koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

DOÇ.DR.YASAR ERYILMAZ
DOKUZAYRINTI ÖZEL HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Yönetimi

Engin Perik
Ambar

Mehmet Emin
Ambar

ETHERNET PORTLU TERMAL BARKOD YAZICI

İşlemsel

Baskı metodu	Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma)
Baskı Çözünürlüğü	203 DPI (8 dots/mm)
Baskı hızı (Maksimum)	152 mm / saniye
Baskı uzunluğu	Max. 2540 mm
Baskı genişliği	25,4 mm ~ 108 mm
Hafıza	32 MB DRAM, 16 MB Flash ROM
İşlemci	32 bit RISC işlemci
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 2 adet LED
Haberleşme	Seri Port (RS-232C), Ethernet ve USB Cihaz ve USB Host
Etiket algılama sensörü	Yansıtımlı (Solda ve sabit)
Baskı Açısı	0, 90, 180, 270 derece
Sertifikalar	CE, FCC, cULus, CCC, BIS, BSMI, RoHS

Fiziksel

Genişlik	182,5 mm
Yükseklik	173,5 mm
Uzunluk	282 mm
Ağırlık	1,54 kg
Kasa	ABS Plastik

Elektriksel

Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç kaynağı (Çıkış)	24VDC, 2.4A

Çevresel

Çalışma ortamı sıcaklığı	4 °C ~ 38 °C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Saklama ortamı nem oranı	%0 ~ %90 (Yoğuşmasız)

Etiket

Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	20 mm ~ 110 mm
Kalınlık	0,0635 mm ~ 0,0254 mm
Kuka iç çapı	12,7 mm / 25,4 mm / 38,1 mm
Etiket dış çapı	127 mm (En fazla)

Ribon

Tip	Wax , Wax/Resin, Resin
Sarım yönü	İç Sarım veya Dış sarım
Uzunluk	92 metre (En fazla)
Genişlik	25,4 mm ~ 102 mm
Kuka iç çapı	12,7 mm
Ribon dış çapı	37 mm

Yazılımsal

Windows sürücüleri	Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10
Linux sürücüleri	Destekleniyor

DOÇ.DR.YAŞAR ERKİLMAY
ERZURUM DEVLET HASTANESİ
Fikret ERKİLMAY
Ambar Birimi

Enjin Park
Bey

Micahit Övöz
H.Ö.

Etiket dizayn programı	Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA, PPLB ve PPLZ
Yazı Tipleri	Standard Dahili Karekter Seti 5 alfa sayısal yazı tipi (1,25 mm ~ 6,0 mm) Dahili yazı tipleri 24 x 24 4 yönde (0° ~ 270°) Döndürülebilir Yazılımsal Yazı Tipleri Yüklenebilir
Desteklenen grafik biçimleri	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked
2D	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode

Engin Pöde
Cunç

Miscallat Güneş
[Signature]

DOÇ. DR. YASAR ERDİLMAZ
DOĞUŞAHİLER HASTANESİ
SAĞLIK BİLİMİ
Ambar Bilimi

BİLGİSAYAR KASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İşlemci markası Intel olmalı
- 2- İşlemci modeli I5 olmalı
- 3- İşlemci modeli serisi 10400 olmalı
- 4- İşlemci nesli 10 olmalı
- 5- İşlemci hızı en az 2.9 Ghz olmalı
- 6- Harddisk tipi SSD olmalı
- 7- SSD harddisk kapasitesi en az 240 GB olmalı
- 8- Optik sürücüsü DVD RW olmalı
- 9- Ekran kartı markası Intel olmalı
- 10- Ekran kartı modeli UHD 630 olmalı
- 11- Bellek kapasitesi 8 GB olmalı
- 12- Bellek tipi DDR4 olmalı
- 13- Bellek hızı 2666 Mhz olmalı
- 14- Mouse ve klavyeli olmalı
- 15- Klavye tipi F klavye olmalı
- 16- İşletim sistemi Windows 10 Professional olmalı
- 17- Güç kaynağı en az 250 Watt olmalı
- 18- Masaüstü bilgisayar olmalı

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Ahmet Emrah YILMAZ
TKY
Ari

Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin BURKAN
Baskenkim
Dip. Ves. No: 135899

YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Baskı teknolojisi Lazer olmalı
- 2- Baskı teknolojisi 600x600 Dpi olmalı
- 3- Siyah-Beyaz baskı hızı 34 PPM olmalı
- 4- Dupleks baskı özelliği olmalı
- 5- Dupleks baskı hızı 16 PPM olmalı
- 6- Baskı kapasitesi aylık en az 15000 olmalı
- 7- İşlemci hızı en az 600 Mhz olmalı
- 8- Standart bellek kapasitesi en az 128 MB olmalı
- 9- Wifi, Usb, Ethernet bağlantıları olmalı
- 10- En az 2 yıl garantisi olmalı
- 11- Türkçe kullanım kılavuzu olmalı
- 12- Güç kablosu içinde olmalı

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü




Ahmet Emin YILMAZ

TKY



Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin GÜRKAN
Başhekim
Dip. Tes. No: 136899

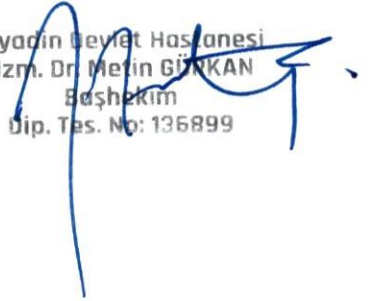


TARAYICI TEKNİKŞARTNAMESİ

- 1- Tarayıcı hızı (a4 sayfa/dakika) 60 olmalıdır
- 2- Tarayıcı çözünürlüğü 600x600 Dpi olmalıdır
- 3- Arkalı önlü tarama özelliği olmalıdır
- 4- Dupleks tarayıcı hızı 120 olmalıdır
- 5- Tarayıcının desteklediği max boyut a4 olmalıdır
- 6- ADF kapasitesi 60 olmalıdır
- 7- Ürün yazılımı yüklü bir şekilde gelmelidir
- 8- En az 2 yıl garantisi olmalıdır
- 9- Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır
- 10- Ürünün USB bağlantı özelliği olmalıdır


Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Ahmet Emin YILMAZ
TKY
Ari

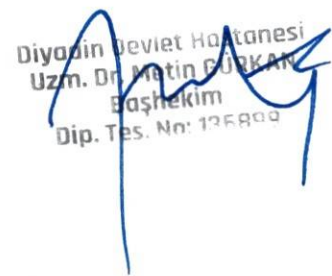
Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Martin ÇUKAK
Başhekim
Dip. Tes. No: 125800

BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Toplam brüt hacmi 140 lt olmalı
- 2- Soğutucu net hacmi 104 lt olmalı
- 3- Dondurucu net hacmi 17 lt olmalı
- 4- Dondurma kapasitesi 2 kg/24 saat olmalı
- 5- Soğutma tipi kompresörlü olmalı
- 6- Göve yapısı galvanizli sac olmalı
- 7- De-frost özelliği olmalı
- 8- Elektrik kesintilerinde saklama süresi en az 9.5 saat olmalı
- 9- 2 adet rafı olmalı
- 10- Boyu 633 cm olmalı
- 11- Eni 54 cm olmalı
- 12- Yüksekliği 83.8 cm olmalı
- 13- En yüksek soğutma sıcaklığı 8 derece olmalı
- 14- En düşük soğutma sıcaklığı 2 derece olmalı
- 15- En yüksek dondurma sıcaklığı -16 derece olmalı
- 16- En düşük dondurma sıcaklığı -22 derece olmalı

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü



Ahmet Emin YILMAZ
TKY
Dr

Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mehmet BİRDAN
Başhekim
Dip. Tes. No: 136899



TELEVİZYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ekran boyutu en az 59 cm olmalı
- 2- Düz ekran olmalı
- 3- Ekran formatı 16:9 olmalı
- 4- Çözünürlüğü 1366x768 olmalı
- 5- Dahili uydu alıcısı olmalı
- 6- Ekran yenileme hızı en az 500 hz olmalı
- 7- HDMI ve VGA girişleri bulunmalı
- 8- Kanal düzenleme favori sıralama, otomatik kanal arama, kapanma zamanlayıcısı olmalı
- 9- DhlTAI yayında dil ve altyazı desteği, çocuk kilidi, A enerji sınıfı olmalı
- 10- Televizyona uyumlu uzaktan kumanda olmalı
- 11- En az 2 yıl garantisi olmalı
- 12- Türkçe kullanım kılavuzu olmalı

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü



Ahmet Emin YILMAZ
TKY



Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin GÜRKAN
Başhekim
Diy. Tes. No: 136899



DOSYA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Yüksekliği 1200 mm olmalı
- 2- Genişliği 800 mm olmalı
- 3- Derinliği 380 mm olmalı
- 4- İki kapaklı olmalı
- 5- 2 tane rafı olmalı
- 6- Melamin kaplama olmalı
- 7- Kilit özelliği olmalı
- 8- 4 adet ayağı olmalı
- 9- Ayaklar 5-10 cm olmalı
- 10- En az 2 yıl garantisi olmalı

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Ahmet Emrah YILMAZ
TKY
dir

Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin Güneş
Başhekim
Dij. Tes. No: 136899

ELBİSE DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

7

- 1- Yüksekliği 1930 olmalı
- 2- Geniřlięi 800 mm olmalı
- 3- Derinlięi 477 mm olmalı
- 4- Melamin kaplama olmalı
- 5- 2 kapaklı olmalı, iki bölmeli olmalı
- 6- Her kapakta bir kilit olmalı
- 7- Dolabın içinde elbise askı aparatı olmalı
- 8- Dolap ayaklı olmalı en az 5-10 cm yüksek olmalı
- 9- Her bir bölmede iki adet raf olmalı

Mehmet İLBOęA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Ahmet Emin YILMAZ
TKY
hi

Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin GÜRKAN
Başhekim
Dip. Tes. No: 136899

8

KOMPAKT ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürün tekli modül olmalıdır
- 2- Çift yüzlü olmalıdır
- 3- Valon özelliği olmalıdır
- 4- Manuel hareket ettirilebilir olmalıdır
- 5- Açılır standart kapağı olmalıdır
- 6- Kapağın kilit özelliği olmalıdır
- 7- Geniřliđi 1000 mm olmalıdır
- 8- Derinliđi 1000 mm olmalıdır
- 9- Yüksekliđi 2170 mm olmalıdır
- 10- Üst tabla malzemesi metal sac olmalıdır
- 11- Üst tabla yüzeyi elektrostatik boya olmalıdır
- 12- 4 adet rafı olmalıdır
- 13- Raf malzemesi metal sac olmalıdır
- 14- Raf yüzeyi elektrostatik boya olmalıdır

Mehmet İLBOĐA
İdari ve Mali İşler Müdürü



Ahmet Emin YILMAZ

TKY

Dr.

Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin GÜRKAN
Bachakintı
Dip. Ves. No: 136899



SANDALYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Yüksekliği 810 mm olmalı
- 2- Geniřlięi 530 mm olmalı
- 3- Derinlięi 560 olmalı
- 4- Oturak döőeme malzemesi suni deri/kumaő olmalı
- 5- Ayak malzemesi metal profil olmalı

Mehmet İLBOęA
İdari ve Mali İőler Müdürü

Ahmet Emin YILMAZ
TKY
Avi

Yıldırım Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin GÜRKAN
Baőhekim
Dip. Tes. No: 136899

ÇALIŞMA KOLTUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ayak yapısı yıldız ayak olmalı
- 2- Geniřliđi 555 mm olmalı
- 3- Yüksekliđi 1080 mm olmalı
- 4- Derinliđi 460 olmalı
- 5- Arkalık döřeme malzemesi duni deri/kumař olmalı
- 6- Ayak malzemesi siyah polipropilen olmalı

Mehmet İLBOĐA
İdari ve Mali İřler Müdürü

Ahmet Emin YILMAZ
TKY
Ari

Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin ÜRKAN
Bařhekim
Dip. Tes. No: 136899

ÇALIŞMA MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürün 2'li modül olmalıdır
- 2- Bir modülü etajer tip, bir modülü çalışma masası olmalıdır
- 3- Etajer tip; genişliği 1700 mm, Derinliği 400 mm, Yüksekliği 670 mm olmalıdır
- 4- Çalışma masası; genişliği 1600 mm, derinliği 800 mm, yüksekliği 750 mm olmalıdır
- 5- Ürünün en az bir modülünde çekmece özelliği ve çekmecelerde kilit sistemi olmalıdır
- 6- Ürünün en az bir modülünde kilitlebilir kapak özelliği olmalıdır
- 7- Üst tabla yüzeyleri melamin kaplama olmalıdır
- 8- Ayak malzemeleri melamin kaplı yonga levha olmalıdır

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü




Ahmet Emin YILMAZ

TKY

di

Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin GÜRKAN
Başhekim
Dig. Tes. No: 136899



KESON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 3 adet çekmecesini olmalı
- 2- Geniřlięi 400 mm olmalı
- 3- Yükseklięi 580 mm olmalı
- 4- Derinlięi 460 mm olmalı
- 5- Üst tabla yüzeyi melamin kaplama olmalı
- 6- Çekmece klapa yüzeyi melamin kaplama olmalı
- 7- Çekmeceler kilitlenebilir olmalı
- 8- 5-10 cm yüksekliğinde tekerlekleri olmalı

Mehmet İLBOęA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Ahmet Emin YILMAZ

TKY

Amir

Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin
Bařbek
Dip. Tes. No: 130624

SEHPA TEKNİKŞARTNAMESİ

- 1- Geniřlięi 900 mm olmalıdır
- 2- Derinlięi 600 mm olmalıdır
- 3- Ykseklięi 450 mm olmalıdır
- 4- st tabla yzeyi melamin kaplama olmalıdır
- 5- Ayak malzemesi metal sac olmalıdır

Mehmet İLBOęA
İdari ve Mali İřler Mdr

Ahmet Emin YILMAZ
TK 7
Ari

Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin YRKAN
Bordokim
Dip. Tes. No: 136899

BEKLEME KOLTUĐU TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1- Geniřliđi 950 mm olmalıdır
- 2- Ykseklđi 820 mm olmalıdır
- 3- Derinliđi 620 mm olmalıdır
- 4- Oturum sayısı ikili olmalıdır
- 5- Oturak dřeme malzemesi suni deri/kumař olmalıdır
- 6- Ayak malzemesi metal profil olmalıdır
- 7- rn i mekan kullanımına uygun olmalıdır

Mehmet İLBOĐA
İdari ve Mali İřler Mdr

Ahmet Emin YILMAZ
TKY
Ari

Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin S. BAKAN
Bařhekim
Dip. Tes. No: 136899

BEKLEME KOLTUĐU TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1- Oturum sayısı üçlü olmalıdır
- 2- Geniřliđi 1500 mm olmalıdır
- 3- Derinliđi 630 mm olmalıdır
- 4- Yüksekliđi 840 mm olmalıdır
- 5- Oturak döőeme malzemesi duni deri/kumaő olmalıdır
- 6- Ayak malzemesi metal profil olmalıdır
- 7- Ürün iç mekan kullanımına uygun olmalıdır

Mehmet İLBOĐA
İdari ve Mali İőler Müdürü



Ahmet Emin YILMAZ
TKY
Sri

Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin GÜRKAN
Baőhekim
Dip. Tes. No: 136899



KANEPE TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1- Yatak olma özelliği olmalı
- 2- Oturum sayısı üçlü olmalı
- 3- Genişliği 2080 mm olmalı
- 4- Derinliği 800 mm olmalı
- 5- Yüksekliği 800 mm olmalı
- 6- Oturak döşeme malzemesi suni deri/kumaş olmalı
- 7- Ayak malzemesi metal profil olmalı

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü



Ahmet Emin YILMAZ
TKY
Ari

Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin KURKAN
Anşekir
Dip. Tes. No: 136899

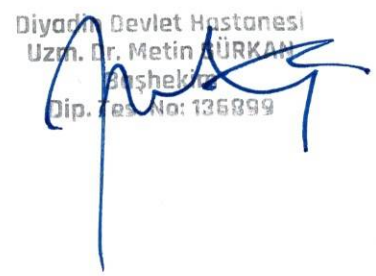

MONİTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ekran boyutu 21.5 inch olmalı
- 2- Ekran çözünürlüğü en az 1920 x 1080 olmalı
- 3- Ekran tipi led olmalı
- 4- Ekran özelliği TN olmalı
- 5- VGA + HDMI giriş çıkış portları olmalı

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Ahmet Emin YILMAZ
TKY
Ari

Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin SÜRKAL
Başhekim
Dip. Tes. No: 105894

TABURE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürün yıldız ayak yapısında olmalıdır
- 2- Gövde yapısı arkalıksız olmalıdır
- 3- Geniřliđi 400 mm olmalıdır
- 4- Derinliđi 400 mm olmalıdır
- 5- Yüksekliđi 860 mm olmalıdır
- 6- Oturak döőeme malzemesi suni deri/kumaő olmalıdır
- 7- Ayak malzemesi metal profil olmalıdır

Mehmet İLBOĐA
İdari ve Mali İőler Müdürü

Ahmet Emin YILMAZ
TKY
Ani

Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin GÜRKAN
Baőhekim
Dip. Tes. No: 136499

KOMPAKT ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürün tekli modül olmalıdır
- 2- Çift yüzlü olmalıdır
- 3- Valon özelliği olmalıdır
- 4- Manuel hareket ettirilebilir olmalıdır
- 5- Genişliği 1000 mm olmalıdır
- 6- Derinliği 1000 mm olmalıdır
- 7- Yüksekliği 2170 mm olmalıdır
- 8- Üst tabla malzemesi metal sac olmalıdır
- 9- Üst tabla yüzeyi elektrostatik boya olmalıdır
- 10- 4 adet rafı olmalıdır
- 11- Raf malzemesi metal sac olmalıdır
- 12- Raf yüzeyi elektrostatik boya olmalıdır

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü



Ahmet Emin YILMAZ

TKY


Anı

Diyadin Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Mehmet ÇİĞDEMİR

Psikiyatrist

Dip. Tes. No: 130899

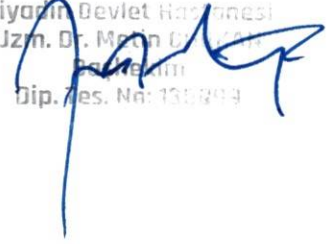

Serum Askısı Teknik Şartnamesi

- 1- Serum askısı max yükseklik 195 cm olmalı
- 2- Serum askısı min yükseklik 114 cm olmalı
- 3- Ayakları polipropilen madde olup 5 ayaklı olmalı
- 4- Kanca sayısı 4 adet ve metal olmalı
- 5- profil kalınlığı 1.2 mm er kalınlığında olmalı
- 6- Yükseklik ayarı mekanik olmalı
- 7- elektrostatik toz boya ile boyalı olmalı
- 8- 5 adet tekerleği olmalı
- 9- tekerlekler 50 mm çapında olmalı

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Ahmet Emin YILMAZ
TKY
Ki

Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin SÜRKAN
Başhekim
Dip. Tes. No: 136899

İlaç Arabası Teknik Şartnamesi

- 1- Derinliği 590 mm Genişliği 980 mm olmalı
- 2- Yüksekliği 1425 mm olmalı
- 3- Üst tabla malzemesi 22 MM ABS olmalı
- 4- Gövde malzemesi iki yan duvar, arka duvar 8 MM MDF üzeri 0,8 mm paslanmaz olmalı
- 5- Şase malzemesi özel kanallı alüminyum eloksallı profil olmalı
- 6- Kilit mekanizması bütün gözler yan kısımdan anahtar ile kilitlenebilir olmalı
- 7- Çekmece sayısı 5 olmalı
- 8- Çekmecelerin içi 3-4-5-6-7-8-9-12 ayrı bölüme ayrılabilir olmalı
- 9- İki teker üzerinde mandal şeklinde ayak ile kilitlenebilir fren sistemi olmalı
- 10- Çöp kovası olmalı
- 11- Tekerlek çapı 125mm olmalı
- 12- 4 adet tekerleği olmalı
- 13- Çöp kovası 9lt'lik polipropilen malzemededen olmalı

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Ahmet Emin YILMAZ
TRK

Arı

Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin ÇELİK
Anestezi Uzmanı
Dip. Tes. No: 13597-1

ANESTEZİ İLAÇ ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Derinliği 510 mm Genişliği 850 mm olmalı
- 2- Yüksekliği 940 mm olmalı
- 3- Üst tabla malzemesi ABS Plastik olmalı
- 4- Gövde malzemesi 304 kalite paslanmaz çelik (0.8 mm) olmalı
- 5- Şase malzemesi alüminyum olmalı
- 6- Kilit mekanizması olmalı
- 7- 5 Çekmeceli olmalı
- 8- 1.Çekmece Bölme Sayısı 6, 2.3.4. Çekmece Sayısı 4, 5.Çekmece Bölme Sayısı 1 olmalı
- 9- 2 adet frenli tekerlek olmalı
- 10- Tekerlek çapı 125mm olmalı
- 11- 4 tekerlekli olmalı
- 12- İlaç saklama gözü özelliği olmalı

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü




Ahmet Emin YILMAZ

TKY



Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin BÜRKAN
Baskenkim
Dip. Tes. No: 136899

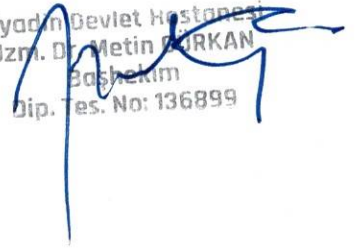

Hasta Yemek Masası Teknik Şartnamesi

- 1- kullanılan malzeme tipi ABS olması
- 2- Tabla genişliği 815 mm olmalı
- 3- Tabla derinliği 415 mm olmalı,
- 4- Tabla malzeme kalınlığı 2 mm olmalı
- 5- Masanın min yüksekliği 790 mm olmalı
- 6- Masanın max yüksekliği 1030 mm olmalı
- 7- Masanın yükseklik ayarı amortisör ile sağlanmalı
- 8- Masanın boyalı kısımları elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalı
- 9- Masa 4 tekerlekli olmalı
- 10- Çapraz fren sistemi olmalı

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Ahmet Emin YILMAZ
TKY
Ani

Diyadin Bölge
Uzm. Dr. Mehmet
Böğemir
Dip. Tes. No. 1114

HASTA KOMİDİNİ

- 1- Yüksekliği 710mm Genişliği 450 mm olmalı
- 2- 1 Çekmeceli olmalı
- 3- Derinliği 450 mm olmalı
- 4- Üst tabla yüzey kaplama malzemesi standart lamine levha olmalı

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü




Ahmet Emin YILMAZ

TKY

ki

Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin ÇİNKAN
Başhekim
Dip. Tes. No: 136699

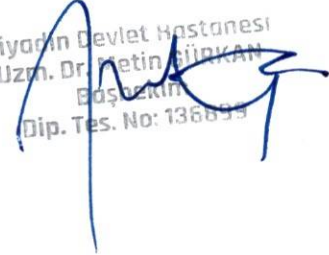

REFAKATÇI KOLTUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Yatma özelliği olmalı
- 2- Bir kişilik olmalı
- 3- Genişliği 770 mm, Derinliği 1000mm, Yüksekliği 900mm olmalı
- 4- Arkalık döşeme, oturak döşeme, kolçal döşeme ve ekstra yatak döşeme malzemeleri suni deri / kumaş olmalı
- 5- Oturak iskelet, Arkalık İskelet ve Baza iskelet malzemeleri metal profil olmalı
- 6- Kolçak iskelet ve Ekstra yatak iskelet malzemeleri yonga levha olmalı
- 7- Ayak malzemesi metal profil olmalı

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü



Ahmet Emin YILMAZ

TKY



Diyadin Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin ÇİĞDEMİR
Büro No: 136899

