



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
22/09/2022 15:05 - E-68917221 - 949 - 1118



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **30 ADET CERRAHİ BIÇAKLI TROKER ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **29.09.2022 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Vedat ZENGİL

İdari Mali İşler Müdür V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	CERRAHİ BIÇAKLI TROKER	ADET	30		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm.Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 4) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 5) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 6) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 7) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 1ca2c44-7075-4af7-82da-f108f511f605 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Telefon: Faks No: 04723125747

e-Posta: senay.sahin5@saglik.gov.tr İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Şenay SAPMAZ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



TROKAR, BIÇAKLI

SMT Temel İşlevi:	1. Endoskopik ameliyatlarda, vücuda cerrahi aletleri yerleştirmek için kullanılabilecek bir açıklık oluşturmak amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. 3. Trokarın uzunluğu; <ul style="list-style-type: none">• Kısa için 70(± 10 mm),• Standart için 100 mm (± 10 mm) ve• Uzun için 150 mm (± 10 mm) olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Trokar sisteminde; <ul style="list-style-type: none">• 5/5,5 mm liktrokar, 5mmlik el aletlerinin kullanımı için,• 10/11mm liktrokar, 5-10 mm veya 5-11 mm lik el aletlerinin kullanımı için,• 12/12,5mm liktrokar, 5-12 mm lik el aletlerinin kullanımı için,• 15mm liktrokar, 5-15 mm lik el aletlerinin kullanımı için bir konvertöre ihtiyaç duymaksızın kullanılabilmesi veya konvertör yanında ücretsiz verilmelidir. 5. Kanülün dışı, batin duvarından dışarı çıkmasını engelleyen bir sisteme sahip olmalıdır. 6. Trokarda bulunan vana sistemi sayesinde batin içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır. 7. Trokar avuç içerisinde sıkılarak veya bir buton ile emniyet mekanizması aktive edilebilmelidir. 8. Trokarkanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek valf veya 4 yapraklı yonca sistemiveya çift conta sistemi olmalıdır. 9. Trokarın ucunda doku yaralanmasını engellemek için hızlı hareket eden emniyet kılıfı ve emniyet mekanizması olmalıdır. 10. Trokarın karın duvarında düzgün bir kesi alanı yaratmak için bıçağın iki tarafı da keskin ve bıçağı "V" şeklinde veya yuvarlatılmış olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.

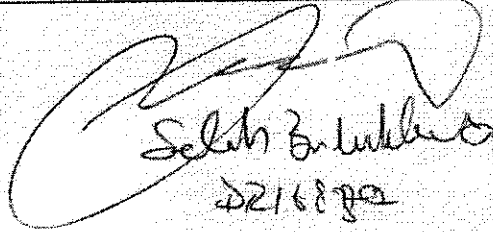
Yazlı OĞYAN

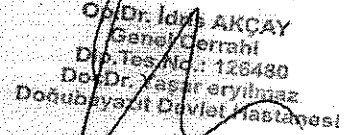
[Handwritten Signature]
D210370

Op.Dr. İdris AKÇAY
Genel Cerrahi
Dip.No: 126480
Doç.Dr. Yaşar Arslan
Doğuş Hastanesi

TROKAR, BIÇAKLI

Teknik Özellikleri:	<p>11. 5/5,5, 10-11 ve 12/12,5 mm liktrokarkanülünün, çap düşürücü ve/veya kantilde hava kaçağını engelleyici iki ayrı contası veya valf sistemi olmalı bu özellik sayesinde hava kaçağını azaltmalıdır.</p> <p>12. 5/5,5, 10-11, ve 12/12,5 mm liktrokarlardaspesimen çıkartmak için çap düşürücü çıkartıldığında conta veya valf sistemi kantilün batın içi havayı korumasını sağlamalıdır.</p> <p>13. Trokar ve parçaları üzerinde vida punto vb. düşebilecek ve hasta güvenliğini tehlikeye atacabilecek parça bulunmamalıdır.</p> <p>14. İstendiği takdirde firma obtüratöre uyumlu kantil satış hizmeti verebilmelidir.</p> <p>15. Ürün batın duvarından ilerletilirken kolayca kırılmamalı ve dayanıklı olmalıdır.</p>
Genel Hükümler:	<p>16. Ürün, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.</p> <p>17. Ürün orijinal ambalajında son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi bulunmalıdır.</p>


Selahattin Bulut
02168892


Op.Dr. İdris AKÇAY
Genel Cerrah
Dip.Tes.No: 126480
Doç.Dr. Yasir Eryılmaz
Doğubeyazıt Devlet Hastanesi