



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **30 ADET CERRAHİ BİÇAKLI TROKAR ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **15.11.2022 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdür V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	CERRAHİ BİÇAKLI TROKAR	ADET	30		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
Uzm.Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

**NOTLAR**

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 4) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 5) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 6) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 7) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI**  
**Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 5fac2fa2-909d-4f27-b3e3-2bc3ceb31468 — Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Satın Alma Birimi  
Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

Bilgi için: Dursun DİNLER

Veri Hazırlama ve Kontrol İşit.

Telefon No: (0 472) 312 60 47

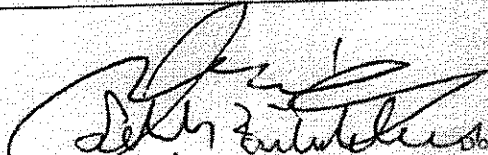
İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com



## TROKAR, BIÇAKLI

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Endoskopik ameliyatlarda, vücuda cerrahi aletleri yerleştirmek için kullanılacak bir açıklık oluşturmak amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. 3. Trokarın uzunluğu; <ul style="list-style-type: none"><li>• Kısa için 70(± 10 mm),</li><li>• Standart için 100 mm (± 10 mm) ve</li><li>• Uzun için 150 mm (± 10 mm) olmalıdır.</li></ul>
<b>Teknik Özellikleri:</b>	4. Trokar sisteminde; <ul style="list-style-type: none"><li>• 5/5,5 mm liktrokar, 5mmlik el aletlerinin kullanımı için,</li><li>• 10/11mm liktrokar, 5-10 mm veya 5-11 mm lik el aletlerinin kullanımı için,</li><li>• 12/12,5mm liktrokar, 5-12 mm lik el aletlerinin kullanımı için,</li><li>• 15mm liktrokar, 5-15 mm lik el aletlerinin kullanımı için bir konvertöre ihtiyaç duymaksızın kullanılabilmeli veya konvertör yanında ücretsiz verilmelidir.</li></ul> 5. Kanülün dışı, batin duvarından dışarı çıkmasını engelleyen bir sisteme sahip olmalıdır. 6. Trokarda bulunan vana sistemi sayesinde batin içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır. 7. Trokar avuç içerisinde sıkılarak veya bir buton ile emniyet mekanizması aktive edilebilmelidir. 8. Trokarkanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek valf veya 4 yapraklı yonca sistemiveya çift conta sistemi olmalıdır. 9. Trokarın ucunda doku yaralanmasını engellemek için hızlı hareket eden emniyet kılıfı ve emniyet mekanizması olmalıdır. 10. Trokarın karın duvarında düzgün bir kesi alanı yaratmak için bıçağın iki tarafı da keskin ve bıçağı "V" şeklinde veya yuvarlatılmış olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.

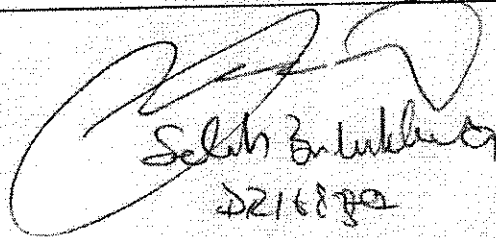
Yazılı OKYAN

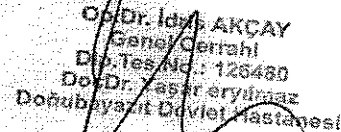
  
D 2167370

Op.Dr. Idris AKÇAY  
Genel Cerrahi  
Dip.No: 126480  
Doç.Dr. Yasar Arslan  
Doküman Devlet

## TROKAR, BIÇAKLI

<b>Teknik Özellikleri:</b>	<p>11. 5/5,5, 10-11 ve 12/12,5 mm liktrokarkanulünün, çap düşürücü ve/veya kanülde hava kaçağını engelleyici iki ayrı conta veya valf sistemi olmalı bu özellik sayesinde hava kaçağını azaltmalıdır.</p> <p>12. 5/5,5, 10-11, ve 12/12,5 mm liktrokarlardaspesimen çıkartmak için çap düşürücü çıkartıldığında conta veya valf sistemi kanülün batın içi havayı korumasını sağlamalıdır.</p> <p>13. Trokar ve parçaları üzerinde vida punto vb. düşebilecek ve hasta güvenliğini tehlikeye atacabilecek parça bulunmamalıdır.</p> <p>14. İstendiği takdirde firma obtüratöre uyumlu kanül satış hizmeti verebilmelidir.</p> <p>15. Ürün batın duvarından ilerletilirken kolayca kırılmamalı ve dayanıklı olmalıdır.</p>
<b>Genel Hükümler:</b>	<p>16. Ürün, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.</p> <p>17. Ürün orijinal ambalajında son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi bulunmalıdır.</p>

  
Selah Zülkeleci  
2216879

  
Op.Dr. İdris AKÇAY  
Genel Cerrahi  
Diy. Tes. No: 125480  
Doç.Dr. Asım Eryılmaz  
Dönüşüştürme Devlet Hastanesi