



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **600 ADET UZATMA HATTI 800 PSİ BASINCA DAYANIKLI M/F 075 CM ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **16.11.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN  
İdari Mali İşler Müdür V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	UZATMA HATTI 800 PSİ BASINCA DAYANIKLI M/F 075 CM	ADET	600		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
Uzm.Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

#### NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 4) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 5) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 6) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 7) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: fc736913-652f-4ed8-95ac-9c8f9a3dbac7 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Bilgi için: Şenay SAPMAZ

Telefon: Faks No: 04723125747

TIBBİ SEKRETER

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

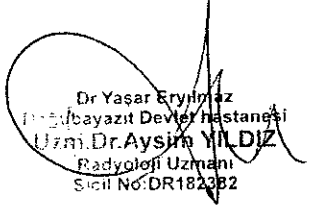


## UZATMA HATTI

### 800 PSI BASINCA DAYANIKLI IŞIKTAN KORUMALI (PRESSURE LINE)

#### TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hortum sert medical Grade Polivinilklorür (PVC)'den imal edilmiş olmalıdır.
2. Pressure Line'nın iç çapı 2.3 mm, dış çapı 4.1 mm olmalıdır.
3. Pressure Line'lar tek kullanımlık steril, tekli paketler de olmalıdır.
4. Pressure Line'lar nontoksit ve Apirojen yapıda olmalıdır.
5. Pressure Line'lar değişik uzunluklarda ve her iki yanda male ve/veya female Luerlock konektörlere sahip olmalıdır.
6. Basıncı değiştirmeden iletecek sertlikte olmalıdır.
7. Uzunluk 145 cm olmalıdır.
8. Işıktan koruma özelliği olmalıdır.
9. Pressure Line'lar 800 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
10. Teklif veren firmalar en az iki numune vermelidir.

  
Dr. Yasar Eryılmaz  
F.5/Bayazıt Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Aysın YILDIZ  
Radyoloji Uzmanı  
Sicil No: DR182382