



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-206965588
Konu : 5 KALEM MALZEME ALIM İŞİ

13.01.2023

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE GEBE OKULUNUN AÇILMASI İÇİN GEREKLİ OLAN 5 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında Doğrudan Temin Usulü ile alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **18.01.2023** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	OKUL SIRASI	ADET	20		
2	SINIF SANDALYESİ	ADET	20		
3	MEDİTASYON SANDALYESİ	ADET	20		
4	PLASENTA MAKETİ	ADET	1		
5	UTERUS MAKETİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın Alma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
4. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
5. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
6. Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
9. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
10. Teknik Şartname ektedir.
11. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 - 215 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: C21EC220-8F66-4B3A-A717-05EBCD52DD73

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi:

Bilgi için: Dursun DİNLER
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşlt.

Telefon No: 04723126047 - 215



255-08-01-01-01 (Sıra)
255-01-05-14-06 (Sınıf Sandalyesi)

OKUL SIRASI VE SANDALYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme içeriği Werzalit olmalıdır.
2. Yaklaşık olarak masa eni 44cm, uzunluk 62cm, yerden yükseklik 71cm olmalıdır.
3. Sandalye oturma yeri 35x38 olmalıdır.
4. Yerden yüksekliği yaklaşık 40 cm, sırt kısmı 40 cm olmalıdır.
5. Masa çekmecesini uzunluk 48 cm, yükseklik 14 cm olmalıdır.
6. Uzun süre kullanıma dayanıklı olmalıdır.
7. Ergonomik olmalıdır.
8. Sıra alt kısmı dosya kullanımına elverişli olmalıdır.
9. 20 adet alınacaktır.
10. Tek kişilik sıralar olmalıdır.




Rabia ELTOK
Hemşire

MEDİTASYON SANDALYESİ ŞARTNAMESİ

1. Meditasyon sandalyesi gebe eğitimine elverişli olmalıdır.
2. Su geçirmez kumaştan imal edilmelidir.
3. Alüminyum sırt destek içermelidir.
4. Yıkabilir özellikte olmalıdır.
5. Minder kauçuk yüksekliği 5 cm olmalıdır.
6. Renk olarak açık renklere tercih edilmektedir.
7. 20 adet istem yapılacaktır.
8. Ürün yaklaşık olarak; Sırt yüksekliği 60 cm, En 40 cm, Oturma derinliği 53 cm, arka derinlik 33 cm, Minderi 40x35 cm olabilir.

255-03-01-04-99-02

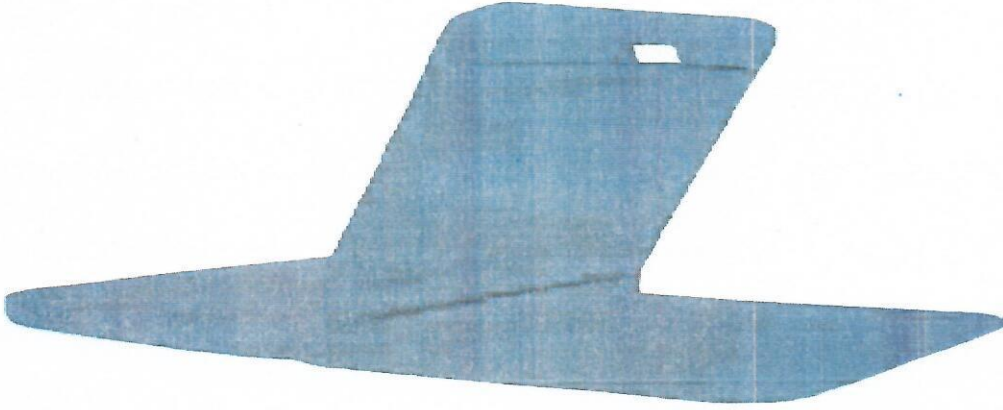

Rabia ELİTOK
Hemşire

PLASENTA MAKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bir stant üzerinde sergilenmelidir.

Plesanda göbek ve göbek kordonu arasında bağıntıyı sergileyen model olarak üretilmiş olmalıdır.

En az iki kat büyütülmüş yapıda olmalıdır.

PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

Anatomik yapıya ait en az 5 özellik simüle edilmiş olmalıdır.

Yaklaşık olarak 20x22x5 cm boyutlarında olmalıdır. Ebatlar değişiklik gösterebilir.

255-01-05-11-99

Rabia ELİTOK
Hemşire

UTERUS MAKETİ TEKNİK ŞARTNEME

- * PVC malzemesinden yapılmış, temizlenmesi kolay ve yıllarca kullanıma uygun olmalıdır.
- * Boyut: Yaklaşık. 18x12x10cm/7.09x4.72x3.94inch olmalıdır.
- * Rahim boynu supra vajinal bir kısma ve vajinal kısma ayrılıp gösteriliyor olmalıdır.
- * Uterus ligamentlerin sayısı sekiz noktadan gösterilmiş olmalıdır.
- * Fallop tüpleri gösterilmiş olmalıdır.
- * Yumurtalıklar gösterilmiş olmalıdır.
- * Kadın uterus yapısını anatomi olarak simüle etmelidir

255-01-05-01-99

Rabia ELİTOK
Hemşire