



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-244925538
Konu : Teklife Davet

28.05.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ HASTASININ AMELİYATI (ABDURRAHMAN SALMAN) İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/F maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 30/05/2024 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	LİSTHESİZ VİDA	ADET	8		
2	ROD	ADET	2		
3	TRANSVER CONNECTOR	ADET	2		
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 9D6CFA56-8B24-49A8-A457-A206D8F63E95

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Keş Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:

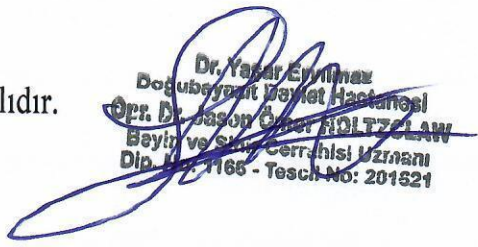


TORAKALOMBER POSTERİOR STABİLİZASYON SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODLARI

VIDALAR 102.135
LİSTHESİZ VİDA:102.150
ROD:102.230
TRANSVER CONNECTOR:102.300-102.310
TRANSVER HOOK:102.170
PEDİKÜL HOOK:102.165
LAMİNAR HOOK:102.160

- 1-Teklif edilecek ürün aşağıdaki maddeleri eksiksiz olarak karşılamak zorundadır. Bu sistem, beyin cerrahisi posterior spinal uygulamalarına kapsamlı olarak cevap vermek zorundadır.
- 2-Sistem uygun alışımda titanyumdan (TiA6V4) imal edilmiş olmalı ve MR Uyumlu olmalıdır.
- 3-Vidalar kendinden yiv açan olmalıdır.
- 4-Tanımlanan vidalar poliaksiyal veya monoaksiyal olarak isimlendirilebilir. Poliaksiyel vidaların tüm yönlere 45+ /-15 derece açılanabilme özelliği olmalıdır.
- 5-Vidalar konik ve kemik tutumunu arttırmak için uç kısmı spongios, baş kısmına yakın bölgesi kortikal yivli özellik göstermelidir , faydalı model belgesi olmalıdır.
- 6-Vidalar monoaksiyal,poliaksiyal,sakroiliyak ve kantüllü olmalıdır.
- 7-Vida rod tespitini güvenli bir şekilde sağlayacak kapatma vidası mekanizmasına sahip olmalıdır. Kapatma vidası derin dişli olmalıdır. Kapatma vidası tamamen sıkıldığında vida başı durumunu korumalıdır. Böylece vida rod bağlantısında zaman içerisinde oluşabilecek gevşemelerin önüne geçebilmelidir. Rod bağlantısında gevşemeye sebep olacak açılma olmaması için içten ve dıştan sıkmalı ayrıca kilitleme kapağında rod kanalı olmalıdır,faydalı model belgesi olmalıdır ayrıca setskur olmalıdır.
- 8-Vidalar low profil olmalı deri irritasyonu azaltmak için vidaların kemik üzerinde kalan yüksekliği 15mm' den fazla olmamalıdır.
- 9-Vida başlarında vidayı çektirmeye yarayacak rakır kanalı olmalıdır.
- 10-Sistem trokal, lomber vertebra basit kırığı, trokal veya lomber kifoz, trokal gibbus, torakal torakolomber, lomber skolyoz, lomber rotasyonel deformite, spinal stenoz, dejeneratif spondiloz, osteoporotik spinal cerrahi girişimlere cevap verebilecek nitelikleri taşınmalıdır.
- 11-Sette ofset hook pedicle hook ,laminar hooklar olmalıdır.
- 12-Sette 20-60 mm arası vida boyları olmalıdır.
- 13-Vida kalınlıkları 4,5-8,5 mm arasında olmalıdır.
- 14-Uzun başlıklı, tepesi kırılabilen spondilo vidalar sette bulunmalıdır.


Dr. Yasar Eryılmaz
Doğubeyazıt Devlet Hastanesi
Op. Dr. Jason Öner ROLTZLAW
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. No: 1166 - Tesch. No: 201521

- 15-Transvers bağlantı kolaylıkla takılabilir, boyu kolaylıkla ayarlanabilir rıgıd ve açıldırılabilir olmalıdır.
- 16-Rodlar rıgıt ve dınamık olmalıdır.
- 17-Rodlar 45-450mm arasında deęiřen uzunluklarda 6mm apında olmalıdır. Rod uları ameliyat esnasında rotasyonu saęlamak amacıyla hegzagonal olmalıdır ve uygun manplasyonu saęlayacak aletler olmalıdır. Rod yzeyi kaymayı nleyecek řekilde dizayn edilmiř ve izgili olmalıdır.
- 18-Korteks delicinin vida aplarına uygun 2mm ve 3mm aplarında 2,5cm de stoplu (pediklerkorteksi geecek řekilde) olmalıdır.
- 19-Uygulama kolaylıęı saęlaması iin rockerlar olmalıdır.
- 20-akma ıkarma seti eskizsiz ve implantlarla aynı marka olmalıdır.
- 21-Rod bastırıcı olmalıdır.
- 22-Hasta takibi ve rn gvenilirlięini saęlamak amacı ile malzemeler zerinde lot numarası, retici firma ismi veya logosu, rne ait boyutsal zellikler yer alacaktır.
- 23-Firmamız 10(on) yıl sre ile revizyon amalı olarak akma setlerini getirebileceęini belirten bir taahhnameyi ihale komisyonuna sunmalıdır.
- 24-Her malzemeye ait katalog ve biyomekanik testleri istenecektir.
- 25-Acil durumlarda en ge 1saat iinde getirilebilir.
- 26-Set kullanılırken firma vida akma seti ile vida ve rodların tm ebatlarını getirecektir.
- 27-rnn SGK ve TTUBB kaydı tamamlanmıř olmalıdır.
- 28-Firma il saęlık mdrlę tarafından tıbbi cihaz satıř merkezi olarak yetkilendirilmiř (Ruhsat) ve klinik destek veya satıř tanıtım belgesi bulunmalıdır.

Dr. Yener Eryılmaz
Doęubayazit Devlet Hastanesi
Op. Dr. Jean-Marie HOLTECLAW
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. No: 1766 - Tescil No: 201521