



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

100
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YÜZÜNCÜ YILI

Sayı : E-68917221-949-250950703
Konu : Teklife Davet

12.08.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan HASTANEM İHTİYACINA BİNAEN 1 KALEM MEDİKAL MALZEME (4 ADET BİPOLAR ELEKTROKOTER PENSE' ALIM İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim toplam fiyatının 19/08/2024 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	BİPOLAR ELEKTROKOTER PENSET	ADET	4		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- 2) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 3) Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB barkod numarası olması gerekmektedir.
- 4) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 5) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 6) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: F800798D-4717-4BCD-8B9C-750CC116788B

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebv>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Bilgi için: Şenay SAPMAZ

Tıbbi Sekreter



BİPOLAR PENSET TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1- Bipolar penset ITC cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Bipolar penset bayonet olmalı ve boyu en az 20cm uç kalınlığı 2,00 - 0,3 mm arasında olmalıdır.
- 3- Bipolar penset maksimum 138°C'deki buhar otoklavında steril edilebilmelidir.
- 4- Bipolar penset Reusable gri veya mavi renk olmalıdır.
- 5- Bipolar pensetin kabloya giriş socketinin uzunluğu en az 2 cm olmalıdır.
- 6- Bipolar pensetin tutma yeri eli kaydırmaması için tırtıklı olmalıdır.
- 7- Bipolar pensetler reusable en az 3m uzunluğunda kabloları ile birlikte teslim edilmelidir. Kablolar hastanedeki cihazlara uyumlu olmalıdır.

8- 2 adet kalın vcu 2 adet orta boy

9- Numüne gönderilecek.

Volkcan Turan

Ecz. İhan DEMİR
Dip. No: 2017/37840

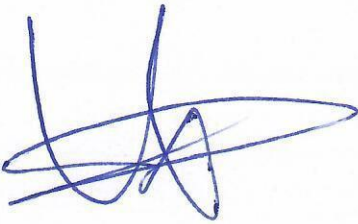

Op. Dr. Nermin Zengin Kabay