

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

21.11.2024

Sayı: 53

Konu: 1 Kalem Endomotor Cihazı Mal Alımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.11.2024 saat: 11:00 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARILĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOMOTOR CİHAZLARI, ENDODONTİK MOTOR (APEKS LOCATERLI) LED IŞIKSIZ (KABLOSUZ)			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:


- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

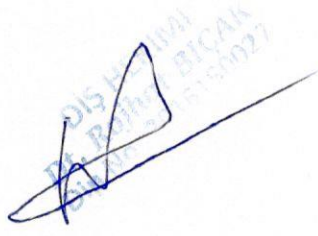
1.ENDOMOTOR

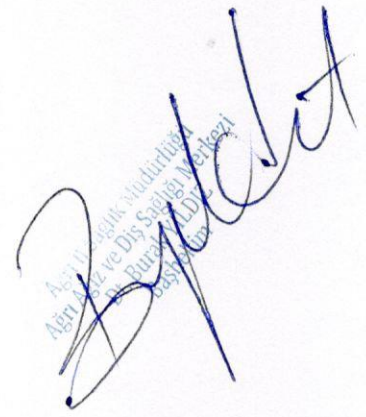
1. Tork hız ve program ayarlarının yapıldığı ve kanala girildiğinde mesafeyi gösteren masaüstü ekran kısmı ile endodontik tedavide kullanılacak anguldruva ve mikromotordan oluşmalıdır.
2. Preperasyonda ve kanal derinlik tespitinde kullanılabilir. Her iki fonksiyon hem eş zamanlı hem de ayrı ayrı kullanılabilir.
3. İyi düşünülmüş çıkış fonksiyonları ve kolay kullanım menü rehberi olmalıdır.
4. Tüm ayarlar değiştirilebilmeli ve kaydedilebilir.
5. Hafızada kayıtlı en az 15 hız ve tork ayarı programı olmalıdır.
6. Cihazda en az iki dil desteği bulunmalıdır.
7. Hafızada kayıtlı 15 farklı NiTi eğe sistemi haricinde, 15 farklı kayıt edilebilir program seçeneği olmalıdır.
8. Apex ulaşınca otomatik durma özelliği olmalıdır. Bu özellik istenildiğinde kapatılabilir.
9. X ışını kullanmadan güvenilir kanal boyu tespiti yapılabilir.
10. Autoreverse özelliği olmalıdır.
11. Cihazın emniyet özellikleri, tork kontrolü, akustik sinyalleri ve otomatik duruş / dönüş fonksiyonu ile sağlanmalıdır.
12. Cihaz ayrıca istenildiğinde reciproc eğe ile de çalışmalıdır.
13. Kalsifiye ve dar kanallar için ek programı olmalıdır.
14. Anatomisi zor olan kanallar için ek programlar bulunmalıdır.
15. Cihaz 6:1 başlık ve ayak kontrolüne sahip olmalıdır.
16. Cihaz şarj esnasında çalışabilir.
17. Cihazın mikro motoru kablolu olmalıdır.
18. 3 saatte şarj edilebilir.
19. Pedallı ve pedalsız çalışabilir.
20. Cihaz ile birlikte pedal verilmelidir.
21. Cihazda tek bir tuşla otomatik olarak kalibrasyon yapılabilir.
22. Auto reverse özelliği kapalı durumda iken cihaz istenildiğinde saat yönünün tersine de çalışabilir.
23. Cihazın tahrik mili devir alanı 1.200 - 19.200 rpm olmalıdır.
24. Cihazın kullanılabilir devir alanı 200 ile maksimum 3.200 rpm arasında olmalıdır.
25. Cihazın kullanılabilir tork aralığı 20- 500gcm olmalıdır.
26. Cihazın toplam ağırlığı 1100 gr olmalıdır.
27. Kanal içerisinde çalışırken eğenin sıkışması, apekse gelmesi durumunda sesli uyarı vermelidir.
28. Anguldruvası ve gerekli aparatları birlikte verilmelidir.
29. Kanal, kanlı olduğunda da ölçüm yapabilir.
30. Cihaz kullanımına ara verildiğinde pil kapasitesini korumak için 10 dakika sonra uyku moduna geçmelidir. Uyku modu bekledikten 30 dakika sonra kendiliğinden kapanmalıdır.
31. Cihaz rotary ve reciproc dönüş yapabilir.
32. Cihaz ile beraber TM wire ışıl işlem görmüş 2 blister reciproc kanal eğesi verilmelidir.
33. Eğeler steril olmalıdır ve istenildiğinde belgelendirilmelidir.

34. Cihaz ile verilecek olan ürünlerin kodları 13/04 için tg, 25/06 için m25, 40/04 için m40 ve 50/04 için m50 olmalıdır.

35. Eğelerin kesici etkinliği yüksek olmalı ve "S" kesite sahip olmalıdır.


Ağrı İlçe Dis. Muh. Müd. Ofisi
Ağrı İlçe Dis. Muh. Müd. Ofisi
Dip. Tes. No: 47725


Ağrı İlçe Dis. Muh. Müd. Ofisi
Ağrı İlçe Dis. Muh. Müd. Ofisi
Dip. Tes. No: 47725


Ağrı İlçe Dis. Muh. Müd. Ofisi
Ağrı İlçe Dis. Muh. Müd. Ofisi
Dip. Tes. No: 47725