



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-263972944
Konu : Teklife Davet

30.12.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE BULUNAN BLT MARKA HASTA BAŞI MONİTÖRÜ İÇİN 2 ADET EKG ÖLÇÜM KABLOSU 5 LEAD ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **06.01.2025** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BLT MARKA HASTA BAŞI MONİTÖRÜ İÇİN EKG ÖLÇÜM KABLOSU 5 LEAD	ADET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 12CAA519-9A63-40BB-AE85-38DD7F69C7BC

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>


Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



BLT Marka Model Hastabaşı Monitör için EKG Kablosu Teknik Şartname

1. BLT Marka Model Hastabaşı Monitör Cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Ürün kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Kablonun UBB kaydı bulunmalıdır ve Sistemde belirtilen marka ile aynı marka ürün teslim edilmelidir. Kabloların üzerinde markayı belirten etiket bulunmalıdır.
4. Kablonun leadlerinin renk kodları IEC standartlarında olmalıdır.
5. EKG uç kabloları kısaç tipli olmalıdır. Kablo tek parça halinde enjeksiyon olmalı, kablo bağlantı bölümlerinde vida bulunmamalıdır.
6. EKG Kablosu 5 leadli ,kısaç uçlu olmalıdır.
7. Kablonun dağılmasını önlemek ve kullanım kolaylığı açısından kablounun üzerinde cırt bandı bulunmalıdır.
8. Kablo gövdesinde hasta bağlantı şemasını gösteren etiket bulunmalıdır.
9. Kablonun leadleri en az 90 cm olmalı, toplam kablo boyu en az 3 mt. olmalıdır.

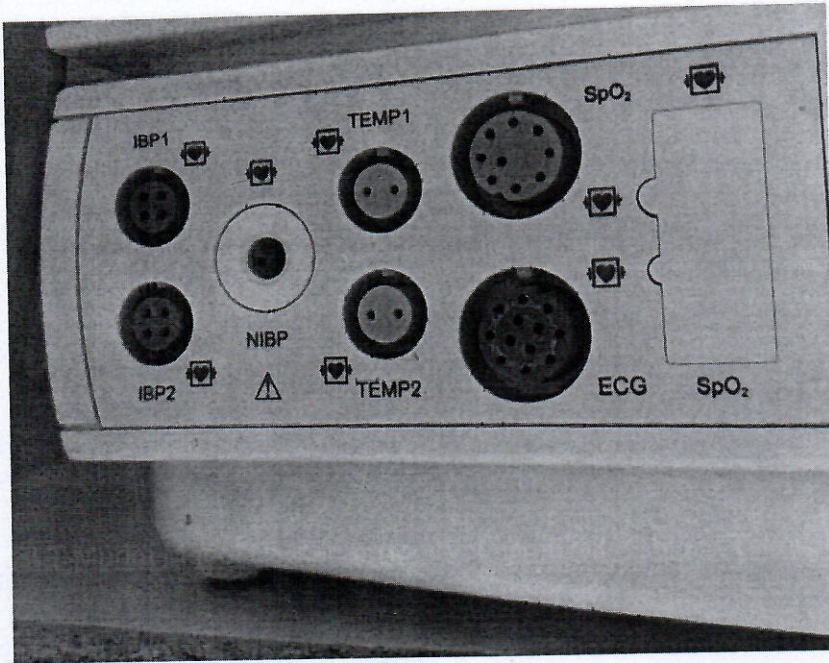

Güçlü Servisi:
MSU AYDIN
da

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Nese ÖZKURUŞ
Biyomedikal Teknikeri

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekerya BASARGAN
Biyomedikal Teknikeri