



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-266551043
Konu : Teklife Davet

24.01.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1.000 ADET TOPRAKLI PRİZ ÇOCUK KORUMA APARATI** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **31/01/2025** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TOPRAKLI PRİZ ÇOCUK KORUMA APARATI	ADET	1.000		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 90965627-2079-4C1F-8699-C103121D7EAD

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>


Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



ELEKTRİK PRİZİ ÇOCUK KORUMAN KİLİDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün kolay kullanıma sahip olmalıdır.
2. 1. kalite plastik malzemeden üretilmiş olması gerekmektedir.
3. Hiçbir şekilde iletken olmamalıdır.
4. Ürün priz içerisine yapışacak şekilde olmalıdır.
5. Ürün 2 tabanlı olup alt taban priz içerisine yapışacak üst taban ise hareketli olacaktır.
6. Üst taban saat yönünde hareket edecek olup prizden kablo çıktıktan sonra otomatik kapanır sistem olmalıdır.
7. Tercihen renk beyaz olacaktır.
8. Ürün TSE ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
9. Ürün görseli temsildir.

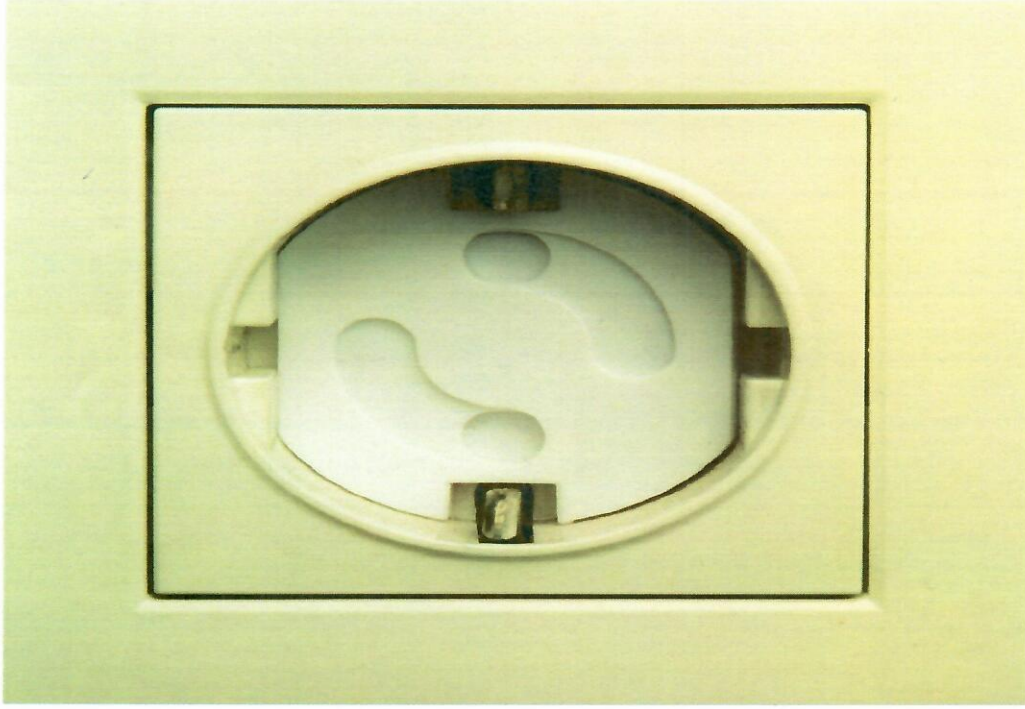

Taha Yasin KOÇ
Kalite Birim Sorumlusu

Asst. Dr. Taha Yasin KOÇ
İçişleri Bakanlığı
Doç. Dr. Taha Yasin KOÇ
Doç. Dr. Taha Yasin KOÇ
Tas. İnceleme Kurulu
Tas. İnceleme Kurulu Yetkilisi

DOÇ. DR. YASAR ERYILMAZ
DOÇ. DR. YAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN

Ambar Birimi