

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

31.01.2025

Sayı: 112

Konu: FLEXIBLE GASTROSKOPİ TELESKOBU PEDİATRİK ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.02.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, FLEKSİBLE GASTROSKOPİ TELESKOBU PEDİATRİK			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:


- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

FLEXIBLE GASTROSKOPİ TELESKOBU PEDIATRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Videogastroskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalı ve teklif edilen pediatrik gastroskopi cihazı ünitelerde kullanılan Fuji-Film marka cihazlara uyumlu olmalıdır.

- 1.Videogastroskop cihazı digital olarak görüntü büyütme özelliğine sahip olmalıdır
- 2.Videogastroskopun saha görüş açısı en az 140 derece olmalıdır .
- 3.Videogastroskop saha görüş derinliği 2-100mm veya 3-100mm veya 4-100mm arasında olmalıdır.
- 4.Videogastroskop saha görüşü yönü önden görüşlü olmalıdır.
- 5.Videogastroskopun insertion tüp dış çapı en az 5,9-9.0mm olmalıdır.
- 6.Videogastroskop çalışma kanalı iç çapı en az 2.4-2.8mm olmalıdır.
- 7.Videogastroskop faydalı çalışma uzunluğu en az 1000mm olmalıdır.
- 8.Videogastroskop ucunun bükülebilme kapasiteleri en az; yukarı 210 derece , aşağı 90 derece , sağa 100 derece , sola 100 derece olmalıdır.
- 9.Cihazın su geçirmez konnektör yapısına sahip olup komple dezenfeksiyon sıvısına bastırılabilir özellikte olmalıdır
- 10.Videogastroskopn hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte olmalıdır.
- 11.Cihazın TİTUBB/ÜTS kaydı olacaktır.
12. HBYS ile uyumlu olmalıdır.

Elif Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Mühendisi

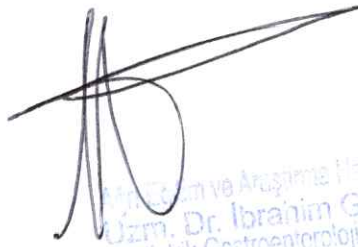

Uzm. Dr. İbrahim GULLÜK
Pediyatrik Gastroenteroloji Hastalıkları
Dip No: 2006/0601-19
Uzm. Tes. No: 160033