



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-269268651
Konu : Teklife Davet

21.02.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **30 ADET HASTA YIKAMA ÇARŞAFI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **03/03/2025** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HASTA YIKAMA ÇARŞAFI	ADET	30		
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr.DEMET ÖKKE
Başhekim .

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 53B09758-04A6-40C4-B8C3-B8F03D390BF8

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: Internet.Adresi:https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN


Tıbbi Sekreter

Telefon No:

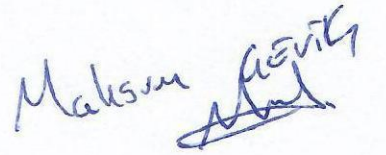


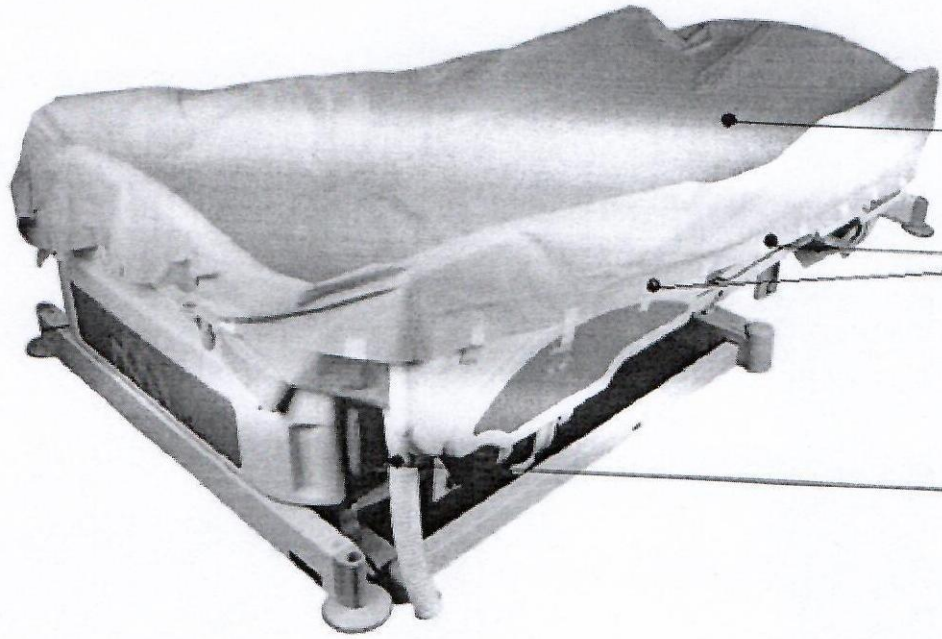
YOĞUN BAKIMLAR HASTALARIN YIKANMASI İÇİN YIKAMA ÇARŞAFI TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Kumaş sıvı geçirmemeli ve sağlam olmalıdır.
 - 2- Yıkama suyunun tahliyesi için su gideri olmalıdır. Hasta yatağına uyumlu olmalıdır.
 - 3- Ürünün üzerinde patent numarası belirtilmelidir.
 - 4- Bütün hasta yataklarında kullanılabilmesine olanak sağlayan kenar bantları olmalıdır. Kenar bantları yapışkanlık özelliği açısından sağlam olmalıdır.
 - 5- Ürün tek kullanımlık sms mavi triplex kumaş olmalıdır. En az 60 gr / m2 olmalıdır.
 - 6- Ürün 160 x 260 cm ebatında olmalıdır.
 - 7- Ürün tekli paketlenmiş olmalıdır.
 - 8- Kolay yırtılmayan dayanıklı , sağlam kumaş olmalıdır.
 - 9 - Ürün barkod numarası paketinde belirlenmelidir.
 - 10 - Örnek numuneler ambalajında gelmelidir ve değerlendirme aşamasında muhakkak gönderilmelidir.
- Hastanemiz ilgili yerlerinde denenerek karar verilecektir.
- 11 - Malzeme teslim edildiğinde en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.

 İlhan DEMİR

 Karim DEMİR

 Maksim



kolay ve pratik kullanım

sıvı geçirmez kumaş

hasta karyolasına uyum
kenar bantlar

su gideri