

**T.C**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü**  
**Taşlıçay Devlet Hastanesi**

SAYI : 2025-56  
KONU : Mal Alımı Hk.

25.03.2025

**Teklif Davet**

Sağlık Tesisimizde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan ve Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal veya Hizmet alımı işini 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 28.03.2025 tarih saat 10:00'a kadar, **tdhsatinalma@gmail.com** mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	PLESENTA MAKETİ	ADET	1		
2	UTERUS MAKETİ	ADET	1		

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

#### UTERUS MAKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- \*PVC malzemesinden yapılmış , temizlenmesi kolay ve yıllarca kullanıma uygun olmalıdır.
- \*Boyut:Yaklaşık 18×12×10 cm /7.09×4.72×3.94inch olmalıdır.
- \*Rahim boynu supra vajinal bir kısma ve vajinal kısma ayrılıp gösteriliyor olmalıdır.
- \*Uterus ligamentlerin sayısı sekiz noktadan gösterilmiş olmalıdır.
- \*Follop tüpleri gösterilmiş olmalıdır.
- \*Yumurtalıklar gösterilmiş olmalıdır.

#### PLASENTA MAKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ :


- \*Model üzerinde bütün anatomik detaylar en hassas şekilde belirlenmiş 4 kat büyütülmüş kesitsel plasenta modeli olmalıdır.
- \*Model , özel geliştirilmiş bir plastikten yapılmış olmalı , böylece darbelere mukavim olduğu gibi uzun süre kullanımlarda renk ve detay kaybı olmamalıdır.
- \*Model tek parça olmalıdır.
- \*Model yeşil standı sahip olmalıdır.
- \*Modelin boyutları: 26,5 × 15 ×11,5 cm . Ağırlık:0,5 kg olmalıdır.




Nursefa TAŞDEMİR  
Kalite Direktörü



x

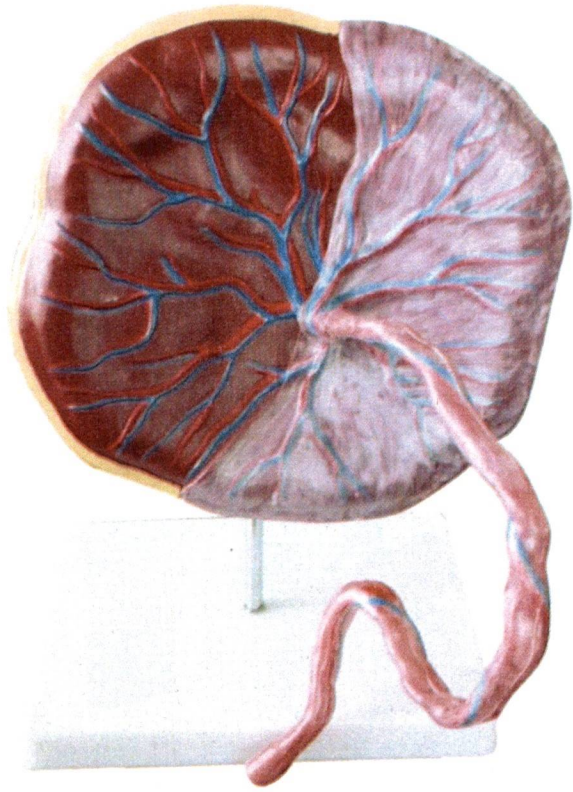

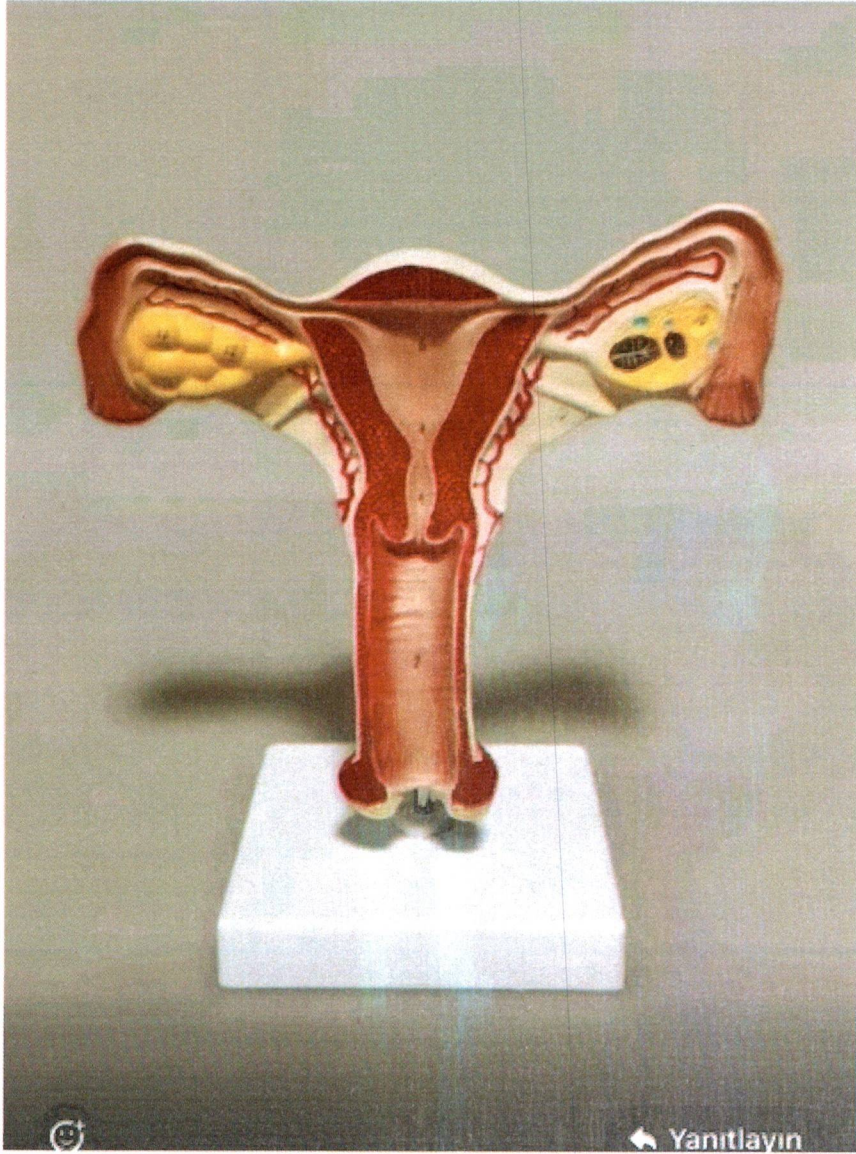

Yanıtlayın