

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

18.06.2025

Sayı:158

Konu: VENTİLATÖR YEDEK PARÇA ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.06.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Mühür ve Mühür Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	VENTİLATÖR TEST CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA(BATARYA MODÜLÜ)			4	Adet		
2	VENTİLATÖR CİHAZI AC / DC ÇEVİRİCİ - CONVERTER			1	Adet		
3	VENTİLATÖR / RESPIRATÖR CİHAZI TUŞ TAKIMI - MEMBRAN (VENTİLATÖR CİHAZINA UYUMLU MEMBRAN)			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Adilcevaz yol üstü 5 km Tlf: 04726161556 Fax: e_mail:
Hız.RABİA CENGİZ YAŞAR Dahili:

Sayfa 1

BATARYA MODÜLÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Maquet marka Servo-i / Servo-S model ventilatör cihazının tüm versiyonlarına uyumlu ve orijinal olmalıdır.
2. Batarya, seri numarası ve kapasite bilgilerini hafızasında tutabilmeli ve cihazla bu bilgileri paylaşabilecek yapıda olmalıdır.
3. Modül şeklinde olup cihaza takılıp çıkartılabilmelidir.
4. CE belgesi olmalıdır.
5. Teklif veren firma TSE yeterlilik belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.
6. Bir batarya modülü, cihazı tüm fonksiyonları ile yarım saat çalıştırabilmelidir.
7. Cihaz elektriğe takılı iken batarya otomatik olarak kendini şarj etmelidir.
8. Bataryalar cihaza 12v dc güç sağlamalıdır

Müf. Kurul
M. H. H. H.

Salih TAŞ
S. E.

Nurcan CANAR
A. Y.

Agri Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Harun HAMAY
Müdür Yardımcısı

SERVO-S VENTİLATÖR AC/DC CONVERTOR KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AC/DC Convertor yeni ve orijinal ambalajında teslim edilecektir.
2. AC/DC Convertor şebeke geriliminden gelen AC voltajı, 12V DC voltaja çevirmelidir.
3. AC/DC Convertor üzerinde koruyu metal levha ve flexiglass materyalden saydam koruyucu bulunmalıdır.
4. AC/DC Convertor üzerinde giriş ve çıkış soketleri kilitli sistem olmalıdır, titreşim ve sarsıntı nedeniyle yerinden çıkmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
5. AC/DC Convertor Elektrostatik Deşarj'dan etkilenmemesi için anti statik koruyucu ambalaj içerisinde teslim edilecektir.
6. AC/DC Convertor Maquet/Getinge model Servo-s ventilatör cihazına uyumlu olmalıdır..
7. AC/DC Convertor kartı değişimi yapıldıktan sonra yüklenici firma tarafından cihaza en güncel versiyon olan v08.00.04 kodlu yazılım yüklenecektir.
8. AC/DC Convertor değişimi sonrasında PC1862 üzerinden bulunan sigortaların değişimi yapılacaktır.
9. Teklif veren firma bölge baylığı olduğuna dair yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

Muaf Kuru

M. H. H. H.

Salih TAŞ

S. H.

Murcan ÇAKIR

Ö. H.

Agri İl Sağlık Müdürlüğü
Pamukçu Devlet Hastanesi
Tıbbi Hizmetler Şefi
T. H. H. H.

Servo-i/s model Ventilatör Cihazlarına uyumlu
Membran Teknik Özellikleri

1. Servo-i ve Servo-s model ventilatör cihazların için uyumlu olmalıdır.
2. Malzeme ithal ve orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Malzeme beyaz renkli olmalıdır
4. Cihazın orijinal parçası olmalıdır.
5. Teklif veren firma TSE yeterlilik belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

Mehmet KURBAN
[Signature]

Sakir TAŞ
[Signature]

Alperen ÇAKIR
[Signature]

[Signature]
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Harun KAMAY
Kudur Yardımcısı

Servis Raporu:

Sipariş numarası: 45236940

Operasyon: 0030

Nesne adresi		Materyal bilgisi	
Müşteri adı:	Patnos Devlet Hastanesi	Model:	Servo-s Base Unit
Cadde:	Atatürk Mah.	Malzeme numarası:	6640440
Posta Kodu:	04000	Seri no:	31056
Müşteri numarası:	2004659	Üretim Tarihi:	07/2014
Şehir:	Ağrı PATNOS	Varlık Numarası:	100158763
İşlevsel konum:	2004659 Patnos Devlet Hastanesi Ağrı	Sözleşme numarası:	3183403280


Sipariş bilgisi		İrtibat bilgisi	
Servis siparişi no.:	45236940	Müşteri irtibat:	Patnos Devlet Hastanesi
Servis sipariş açıklama:	PATNOS DEVLET HASTANESİ BAKIM		
Sipariş Türü:	ZSM Service Maintenance		
PO numarası:			

Genel bilgi
45240360 numaralı orderda belirtilen arızanın giderilmesi sonrasında cihazın bakımı yapıldı. İnspasyon pipe membranı, eksprasyon kaset membranı ve toz filtresi temizlendi. Servis arabirimine bağlanılarak dokunmatik ekran kalibrasyonu, membrane buton testi, rotary encoder testi ve ölü pixel incelemesi yapıldı. Cihazın versiyonu v8.04.00'a güncellendi. 2 adet bataryanın kullanım ömrünü doldurduğu tespit edilmiştir. Cihazın açılış testi yapılarak cihaz çalışır durumda teslim edildi.
Çalışma Saati:34035 E.Y.K.B.:5000 O2 Cell S/N:155822 İlk Kull. Tarihi: 15.01.2025 T.Kapasite 99% Eksprasyon Kaset S/N:229845 Membran Ömrü %0 (Membran değişimi gerekmektedir) Batarya 1:60811 Batarya 2:46610 Referans Doküman: 50437-6628825_-_07_-_SERVO-s_Service_Manual Künye No:1008492681 Not: Bir önceki 45082464 order numaralı bakımda cihazda kullanılan O2 Cell ve 5000h bakım kitinin orijinal olmadığı tespit edilmiştir. İlgili yedek parçaların orijinali ile değişimi önerilir.

Kullanılan malzeme / Personel					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Miktar	Seri No.	Batch	Servis personeli
Gereken Malzeme					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Miktar	Seri No.	Batch	Mühendis
6670360	Membrane, 10 each	1 EA			V001
6487180	Battery Module	2 EA			V001
6532621	Maintenance Kit 5000h	1 EA			V001
6640044	O2 Cell for Servo-i *CSA*	1 EA			V001
Kullanılan malzeme / M					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Miktar	Seri No.	Batch	Mühendis

Çalışma Detayları			
Başlama günü ve saati	Bitiş	Çalışma süresi	Mühendis
12.06.2025 16:30:00	12.06.2025 17:30:00	1 H	Mr ONUR OKUMUS
Toplam:		1 H	

Getinge Medikal Sistemler San. And Tic. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Kayisdagi Cad.
Allianz Plaza Sitesi No:1 Interior Door No:96
34752 Atasehir - Istanbul, Turkey

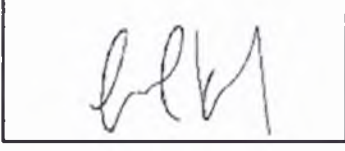


Onur Okumus

Teknisyenin imzası

Tarih: 12.06.2025

Email:
onur.okumus@getinge.com

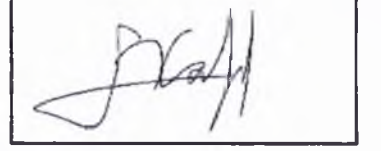

Ömer Çabuk

Müşterinin imzası

Tarih: 12.06.2025

Email:
patnosdhbiyomedikal@gmail.com

Servis Raporu:

Sipariş numarası: 45236940

Operasyon: 0020

Nesne adresi		Materyal bilgisi	
Müşteri adı:	Patnos Devlet Hastanesi	Model:	Servo-s Base Unit
Cadde:	Atatürk Mah.	Malzeme numarası:	6640440
Posta Kodu:	04000	Seri no:	31048
Müşteri numarası:	2004659	Üretim Tarihi:	07/2014
Şehir:	Ağrı PATNOS	Varlık Numarası:	100158763
İşlevsel konum:	2004659 Patnos Devlet Hastanesi Ağrı	Sözleşme numarası:	3183403280


Sipariş bilgisi		İrtibat bilgisi	
Servis siparişi no.:	45236940	Müşteri irtibat:	Patnos Devlet Hastanesi
Servis sipariş açıklama:	PATNOS DEVLET HASTANESİ BAKIM		
Sipariş Türü:	ZSM Service Maintenance		
PO numarası:			

Genel bilgi
Cihazın bakımı yapıldı. İnspasyon pipe membranı, eksprasyon kaset membranı ve toz ftresi temizlendi. Servis arabirimine bağlanılarak dokunmatik ekran kalibrasyonu, membrane buton testi, rotary encoder testi ve ölü pixel incelemesi yapıldı. Cihazın versiyonu v8.04.00'a güncellendi. 2 adet bataryanın kullanım ömrünü doldurduğu tespit edildi. Cihazın açılış testi yapılarak cihaz çalışır durumda teslim edildi.
Çalışma Saati:35891 E.Y.K.B.:4215 O2 Cell S/N:155822 İlk Kull. Tarihi: 15.01.2025 T.Kapasite 79% Eksprasyon Kaset S/N:229845 Membran Ömrü %0 (Membran değişimi gerekmektedir) Batarya 1: 9427 Batarya 2: 38736 Referans Doküman: 66 28 825 • Rev 07 • Servo-s • Service Manual • 2019-09 Künye No:1016667791 Not: Bir önceki 45082464 order numaralı bakımda cihazda kullanılan O2 Cell ve 5000h bakım kitinin orijinal olmadığı tespit edilmiştir. İlgili yedek parçaların orijinali ile değişimi önerilir.

Kullanılan malzeme / Personel					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Miktar	Seri No.	Batch	Servis personeli
Gereken Malzeme					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Miktar	Seri No.	Batch	Mühendis
6487180	Battery Module	2 EA			V001
6670360	Membrane, 10 each	1 EA			V001
6532621	Maintenance Kit 5000h	1 EA			V001
6640044	O2 Cell for Servo-i *CSA*	1 EA			V001
Kullanılan malzeme / M					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Miktar	Seri No.	Batch	Mühendis

Çalışma Detayları			
Başlama günü ve saati	Bitiş	Çalışma süresi	Mühendis
12.06.2025 17:30:00	12.06.2025 18:30:00	1 H	Mr ONUR OKUMUS
Toplam:		1 H	

Getinge Medikal Sistemler San. And Tic. A.S.
Küçükbakkalköy Mah. Kayisdagi Cad.
Allianz Plaza Sitesi No:1 Interior Door No:96
34752 Atasehir - Istanbul, Turkey




Onur Okumus

Teknisyenin imzası

Tarih: 12.06.2025

Email:
onur.okumus@getinge.com



Ömer Çabuk

Müşterinin imzası

Tarih: 12.06.2025

Email:
patnosdhbiyomedikal@gmail.com

TEKNİSYENİN İMZASI Müşterinin imzası

Servis Raporu:

Sipariş numarası: 45240360

Operasyon: 0020

Nesne adresi		Materyal bilgisi	
Müşteri adı:	Patnos Devlet Hastanesi	Model:	Servo-s Base Unit
Cadde:	Atatürk Mah.	Malzeme numarası:	6640440
Posta Kodu:	04000	Seri no:	31056
Müşteri numarası:	2004659	Üretim Tarihi:	07/2014
Şehir:	Ağrı PATNOS	Varlık Numarası:	100158763
İşlevsel konum:	2004659 Patnos Devlet Hastanesi Ağrı	Sözleşme numarası:	3183403280


Sipariş bilgisi		İrtibat bilgisi	
Servis siparişi no.:	45240360	Müşteri irtibat:	Patnos Devlet Hastanesi
Servis siparişi açıklama:	CİHAZ PRİZDEN ŞARJ OLMUYOR		
Sipariş Türü:	ZSR Service Repair - On-Site		
PO numarası:			

Problem tanımı ve müdahale bilgisi	
Arıza	Problem tanımı
Cihaz Arıza	AC/DC Convertor

Genel bilgi
Cihazda yapılan incelemede şebeke gerilimine bağlı olduğu halde, bataryaların şarj olmadığı ve şebeke gerilimi indikatörünün çalışmadığı görüldü. PC1862 kartı üzerinde bulunan 2 adet 2,5 Ah değerindeki sigortaların yanmış olduğu tespit edildi. Sigortalar değiştirildiğinde yeni takılan sigortalarında yandığı tespit edildi. Sigortalar tekrar değiştirilip, test amacıyla getirilmiş olan AC/DC convertor cihazda denendiğinde, Şebeke gerilim indikatörünün çalıştığı ve bataryaların şarj olduğu tespit edildi. Cihazın açılış testi yapıldığında tüm testlerden geçtiği görüldü. Hastane yönetiminin talebi üzerine test için getirilen yeni AC/DC Convertor faturalanmak üzere cihaz üzerinde bırakıldı. Cihazın açılış testi yapıldı. Cihaz çalışır durumda teslim edildi. Arızalı parça hastane yetkililerine teslim edildi.
Arızalı AC/DC Convertor Sn:166592 Yeni AC/DC Convertor Sn:N2153624
Referans Doküman: 66 28 825 • Rev 07 • Servo-s • Service Manual • 2019-09

Kullanılan malzeme / Personel					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Miktar	Seri No.	Batch	Servis personeli
6651413	AC/DC Conv. incl. 6640648 use kit	1 EA	N2153624		V001
Gereken Malzeme					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Miktar	Seri No.	Batch	Mühendis
Kullanılan malzeme / M					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Miktar	Seri No.	Batch	Mühendis

Çalışma Detayları			
Başlama günü ve saati	Bitiş	Çalışma süresi	Mühendis
12.06.2025 14:30:00	12.06.2025 16:30:00	2 H	Mr ONUR OKUMUS
Toplam:		2 H	

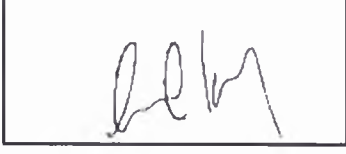


Onur Okumus

Teknisyenin imzası

Tarih: 12.06.2025

Email:
onur.okumus@getinge.com

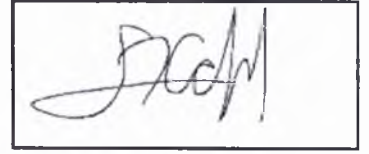

Ömer Çabuk

Müşterinin imzası

Tarih: 12.06.2025

Email:
patnosdhbiyomedikal@gmail.com