

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

30.06.2025

Sayı: 137

Konu: EKG VE DEFİBRİLATÖR KAĞIDI ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.07.2025 saat: 11:00 'a kadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

MEHMET NECİP KAYA
İDARİ VE MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EKG KAĞIDI Z KATLI 112 MM X 140 MM			750	Adet		
2	DEFİBRİLLATÖR KAĞIDI RULO 80 MM X 20 M			100	Rulo		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Fk : Teknik Şartname

Malzemenin Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.
- Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

İSTEK FORMU

Kurumumuz ihtiyacına binaen aşağıdaki listede belirtilen malzemelerin temin edilmesini arz ederim.

İmza

Mert M. Duman

İmza

Süleyman Kaya

İmza

Fatma Karay

TALEP EDİLEN ÜRÜNÜN GEREKÇESİ

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde EKG ve Defibratör cihazların kullanılması için bu cihazlara ait kâğıt gerekmektedir. Elimizde bu cihazlara uyumlu kâğıt bulunmamaktadır. Hastaneye gelen hastaların tedavisinin eksiksiz ve kaliteli tedavi görmesi için cihazlarımıza uygun kâğıt gerekmektedir.

Hastanemiz ihtiyacı olan malzemelerin temini;
AMBARDA
Mevcudu
Vardır
Yoktur
Ambar Memuru
Kaşe İmza

Yunus KARAKAL []
Taşınmaz Kayıt Yetkilisi [X]

ECZANEDE
Mevcudu
Vardır
Yoktur
Baş Eczacı
Kaşe İmza

[]
[]

S.No	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Birim	Adet
1	150-03-03-240036851	EKG KAĞIDI	Adet	750
2	150-03-03-240048432	DEFİBRİLATÖR KAĞIDI	Adet	100

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİN	
Yukarıdaki malzemelerin 2025 Döner Sermaye bütçesinden alınması uygun görülmektedir.	
Arz ederim.	
	4734 sayılı kanunun 19.maddesine göre açık ihale
	4734 sayılı kanunun 22/F maddesine göre
	4734 sayılı kanunun 22/D maddesine göre
	Döner sermayesinin alma memuruna

Mehmet Necip KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

OLUR
Dr.Ahmet SAĞLAM
Başhekim

Most Mohamed Rami
 Sultan Kaya
 Fatma Karabulut

DEFİBRİLATÖR KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-)Kağıt rulo şeklinde olmalıdır.
- 2-)Paketler hava ve nem almayacak şekilde ambalajlanmalıdır.
- 3-)Kağıt COMEN marka S5 model defibrilatör cihazına uyumlu olmalıdır.
- 4-)Firmaların numune getirmesi zorunludur.
- 5-)Numunelerin doğru ve uygun gönderilmesi adına tarafımızca birer kağıt örneği firmaya gönderilmiştir. Ekte mevcuttur.
- 6-)Getirdiği numuneye göre tercih edilen firma, baskıyı getirdiği numuneye göre yapmak zorundadır. Aksi halde getirilen ürün iade edilecektir.
- 6-)Ürünlerin nakliyat, taşıma ve istifleme işi ihaleyi alan firmaya aittir.

Mert Muhamed Ali

Selam Kaya
Sakir.

Kotme Korbey
A




EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-)Termal kağıttan üretilmiş olmalıdır.
- 2-)112mm*100mm ebatlarında olmalıdır.
- 3-)Paketler hava ve nem almayacak şekilde ambalajlanmalıdır.
- 4-)Kağıt Z katlamalı olmalıdır.
- 5-)Kağıt milimetrik kareli olmalıdır.
- 6-)Kağıt ZONCARE marka İMAC 12 model ekg cihazına uyumlu olmalıdır.
- 7-)Firmaların numune getirmesi zorunludur.
- 8-)Numunelerin doğru ve uygun gönderilmesi adına tarafımızca birer kağıt örneği firmaya gönderilmiştir. Ekte mevcuttur.
- 9-)Getirdiği numuneye göre tercih edilen firma, baskıyı getirdiği numuneye göre yapmak zorundadır. Aksi halde getirilen ürün iade edilecektir.
- 10-)Ürünlerin nakliyat, taşıma ve istifleme işi ihaleyi alan firmaya aittir.

Mehmet Mehmet Rous

Selami Kaya

Fatma Karay

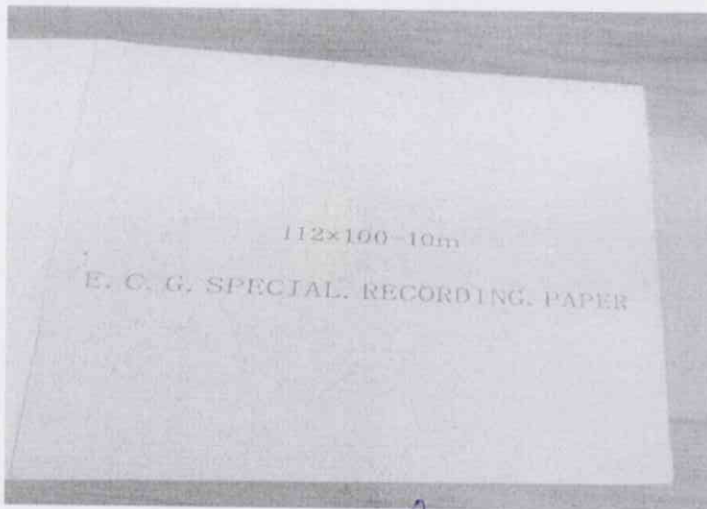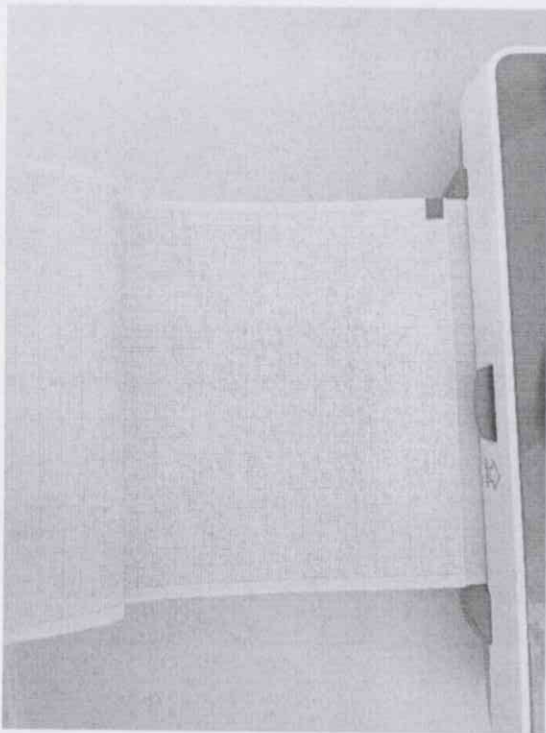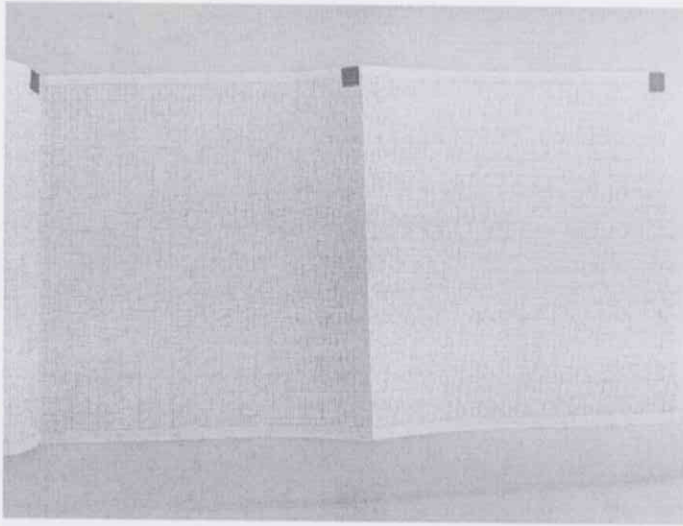

[Handwritten signature]

User Check Report Test Result Result Test: Test passed

Test Time: 2024-05-28 20:43:12	Battery/Pass
	Main Board/Pass
	Power Board/Pass
	DVI Pacer Function/Pass
	Monitor Function/Pass
Record Time: 2024-05-28 20:43:23	



A stylized blue ink signature is written on a white background. The signature consists of a large, loopy initial followed by a horizontal line.