

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2025-89
KONU : Mal Alımı Hk.

16.07.2025

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan ve Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal veya Hizmet alımı işini 4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 18.07.2025 tarih saat 10:00'a kadar, **tdhsatinalma@gmail.com** mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	PVC Kaplama Makinesi	Adet	1		
2	Kaplama Filmi (A3)	Adet	50		
3	Kaplama Filmi (A4)	Adet	50		
4	Kaplama Filmi (A5)	Adet	50		
5	Kaplama Filmi (A6)	Adet	50		

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

PVC Kaplama Makinesi Şartnamesi

Bu şartname, kurumumuzun A3 boyutunda belgeleri PVC ile kaplamak için ihtiyaç duyduğu makinenin teknik özelliklerini ve beklentilerini detaylandırmaktadır. Tedarik edilecek makine, yoğun kullanıma uygun, dayanıklı ve yüksek kaliteli sonuçlar veren bir model olmalıdır.

1. Genel Özellikler

- **Model Tipi:** Ofis tipi veya yarı profesyonel kullanım için uygun PVC kaplama makinesi.
- **Kapasite:** Yoğun belge kaplama ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede olmalıdır.
- **Boyut Uygunluğu:** A3 (297 x 420 mm) ve daha küçük boyutlardaki (A4, A5, A6 vb.) belgeleri sorunsuz bir şekilde kaplayabilmelidir.
- **Kaplama Kalınlığı:** Minimum 80 mikron ile maksimum 250 mikron arasında değişen PVC filmleri kullanabilmelidir.
- **Isınma Süresi:** Hızlı ısınma süresine sahip olmalı (tercihen 5 dakikadan az).
- **Hız:** Yüksek kaplama hızına sahip olmalı (tercihen A4 boyutunda dakikada en az 300 mm).
- **Rulo Sayısı:** En az 2 adet, tercihen 4 veya daha fazla silindire sahip olmalıdır (daha düzgün ve kabarcıksız sonuçlar için).

2. Teknik Özellikler

- **Isıtma Sistemi:** Kaliteli ve homojen ısıtma sağlayan bir sistem (örneğin, sıcak rulo teknolojisi).
- **Sıkışma Önleyici Özellik:** Belge sıkışmalarını önleyen veya sıkışan belgelerin kolayca çıkarılmasını sağlayan bir geri sarma/çıkarma özelliği bulunmalıdır.
- **Ayarlanabilir Sıcaklık:** Farklı kalınlıktaki filmler ve belge türleri için sıcaklık ayarı yapılabilirdir.
- **Soğuk Laminasyon Özelliği:** İsteğe bağlı olarak soğuk laminasyon yapabilme özelliği bulunması tercih sebebidir.
- **Otomatik Kapanma:** Belirli bir süre kullanılmadığında enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanma özelliği olmalıdır.
- **Göstergeler:** Güç, hazır olma ve hata durumunu gösteren LED veya benzeri göstergeler bulunmalıdır.
- **Gürültü Seviyesi:** Çalışma sırasında düşük gürültü seviyesine sahip olmalıdır.


3. Malzeme ve Dayanıklılık

- **Dış Gövde:** Dayanıklı ve sağlam malzemeden üretilmiş olmalı, ofis ortamına uygun estetik bir görünüme sahip olmalıdır.
- **İç Mekanizma:** Uzun ömürlü ve sorunsuz çalışmayı sağlayacak yüksek kaliteli bileşenlerden oluşmalıdır.

4. Güvenlik Özellikleri

- **Aşırı Isınma Koruması:** Makinenin aşırı ısınmasını engelleyen bir koruma sistemi bulunmalıdır.
- **CE Sertifikası:** Avrupa Birliği güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösteren CE belgesine sahip olmalıdır.


Ahmet ARAS
Taşlıcaay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü


Tunc SEKER
T.C. Sağlık Bakanlığı

5. Garanti ve Destek

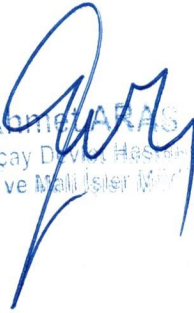
- **Garanti Süresi:** En az 2 yıl üretici garantisi verilmelidir.
- **Servis ve Yedek Parça:** Garanti süresi boyunca ve sonrasında yetkili servis ve orijinal yedek parça temini garantisi verilmelidir.
- **Kullanım Kılavuzu:** Türkçe kullanım kılavuzu ile birlikte teslim edilmelidir.

6. Teslimat ve Kurulum

- Makine, çalışır durumda ve tüm aksesuarlarıyla birlikte kurumumuza teslim edilmelidir.
- Gerekirse, ilk kurulum ve temel eğitim tedarikçi tarafından sağlanmalıdır.

7. Kabul Kriterleri

- Teklif edilen makine, yukarıda belirtilen tüm şartnamelere uygun olmalıdır.
- Makinenin teslimatı sonrası yapılacak testlerde belirtilen performans kriterlerini karşılaması beklenmektedir.


Ahmet ARAS
Taşlıcaay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü


Faruk ÇİÇEK
Tıbbi Sekreter