

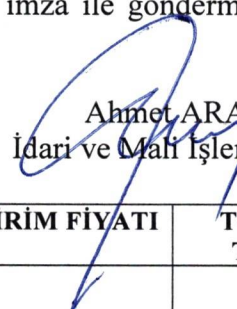
**T.C**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü**  
**Taşlıçay Devlet Hastanesi**

SAYI : 2025-93  
KONU : Mal Alımı Hk.

21.07.2025

**Teklif Davet**

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 25.07.2025 tarih saat 10:00'a kadar ,[tdhsatinalma@gmail.com](mailto:tdhsatinalma@gmail.com) mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi ve kaşe imza ile göndermenizi rica ederim.

  
Ahmet ARAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

| S.NO | ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR |
|------|---------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| 1    | Şeker Stribi              | Adet  | 3000   |              |              |

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

## TEKNİK ŞARTNAME

### Kan Şekeri Ölçüm Stribi (100'lü)

1. Stripler Glukometre ile uyumlu olmalı, kod okutmaya gerek duyulmamalıdır.
2. Şeker ölçüm stripleri açıldıktan sonra en az 60 gün kullanılabilmelidir.
3. Striplerin son kullanım tarihi her stripin içinde bulunduğu kutu üzerinde olmalıdır.
4. Striplerin teslim tarihinden itibaren en az iki yıl raf ömrü olmalıdır.
5. İhaleyi kazanan firma mevcut striplerin kullanılamaması durumunda son kullanım tarihine en az üç ay kala durumun firmaya yazılı olarak bildirilmesi üzerine daha uzun miyadlı aynı ürün ile değiştirme garantisini yazılı olarak taahhüt etmelidir.
6. Stripler 15-40 C sıcaklıkta güvenilir sonuçlar vermelidir.
7. Striplerin ölçüm aralığı en az 20-600 mg/dl arasında olmalıdır.
8. Stripler kapiller, arteriyel, venöz ve neonatal tam kan örneğinde güvenilir sonuçlar vermelidir.
9. Stripler %20-70 hematokrit aralığında güvenli sonuç vermelidir.
10. Stripler 2 mikro litre gibi çok az bir kanla çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
11. Striplere kan damlatıldıktan sonraki en geç 10 saniye gibi kısa sürede cihaz kan şekeri sonuçlarını ekranında verebilmelidir.
12. Stripler cilt temasından olumsuz etkilenmemelidir.
13. Kan stribe kolayca çekilebilmeli veya emdirilebilmelidir.
14. Strip cihaza kolayca yerleştirilebilmelidir. İnce olmamalı, kırılıp bükülmemelidir.
15. Striplerin havayla temasını engelleyecek şekilde stripler tek tek ambalajlanmışsa en fazla 100 adetlik, tek tek ambalajlanmamışsa en fazla 50 adetlik paketler halinde olmalıdır.
16. Malzeme ile birlikte 5 adet Glukometre cihazı verilecektir.

Hasan AYKAS

