

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

13.08.2025

Sayı:

Konu: 3 AYLIK BOWİE-DİCK TEST İNDİKATÖRÜ ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.08.2025 saat: 10:30 'a kadar satinalma.patnosadsm@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

İbrahim KAYA
İDARİ VE MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BOWİE & DİCK TEST PAKETİ			90	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

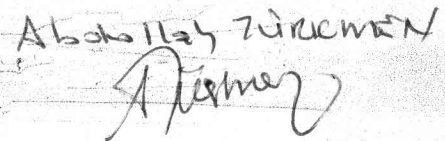
- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

BOWIE-DICK TEST PAKETİ **TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Buhar geçişini kontrol etmek için (100 adet altta 100 adet üstte) kağıt bariyerlere sahip olmalıdır.
3. Medikal kağıt ile sarılı olmalıdır.
4. Kağıt bariyerlerin tam ortasında otoklavlardaki buhar geçiş ve hava kaçaklarını, problemleri tespit etmek için film kaplı özel indikatör baskılı test kartı olmalıdır.
5. İndikatör (renk değiştiren) mürekkep su bazlı olmalıdır.
6. Rengi maviden koyu yeşile dönmelidir.
7. Ebatları eni 11 cm , boyu 11 cm derinlik 2,50 cm olmalıdır.
8. Otoklavlardaki seri kullanıma başlamadan önce Bowie-Dick programında kullanıma uygun olup problemleri tespit edebilmelidir.
9. İşlem indikatörü Medikal Wrap Kağıda sarılı olan otoklav bandının üzerinde olmalıdır.
10. Üzerinde son kullanma tarihi , üretim tarihi , lot numarası ve üreticinin ismi olmalıdır.
11. EN 867 – 1 – Class (2 + 4) standartlarına uygun olmalıdır.
12. ISO 9001:2000 belgesine haiz olmalıdır.
13. ISO 13 485 belgesine haiz olmalıdır.


İbrahim Adıgüzel
Patnos ADŞM
İdari ve Mali İşler Müdürü


A. Talip Işık


Abdullay Zürcümen