

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.08.2025

Sayı:240

Konu: EFOR VE ACİL SERVİS KABLO MANŞON TALEBİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.09.2025 saat: 11:00 'a kadar [patnosdhsatinalma04@gmail.com](mailto:patnosdhsatinalma04@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ TANSİYON MANŞONU TEK HORTUMLU			20	Adet		
2	RİTİM HOLTER KABLOSU			6	Adet		
3	EFOR CİHAZI TANSİYON MANŞONU			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## RİTİM HOLTER KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Ritim Holter Kablosu servisimizde bulunan Cardioline walk 400h markalı cihaz ile uyumlu olmalıdır.
- 2- Kablolar beş lead li ve lead ler farklı renklerde olmalıdır.
- 3- Kablo soketi cihazla tam uyumlu olmalıdır.
- 4- Kablolar Sorunsuz çalışmalıdır ve orijinal olmalıdır.
- 5- Kablonun UBB Kaydı olmalı ve firma teklifinde belirtmelidir.
- 6- Teslimat sırasında şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu bildirilmelidir.
- 7-. Numune getirilmesi zorunludur, numuneler cihaz üzerinde denendikten sonra karar verilecektir.


Fuat BORO  
A.67

Büşra Bilgiç  
Nemşire

Uzman Dr. Maksud KOÇ  
Kardiyoloji Uzmanı  
Tescil No: 173767  
Patnos Devlet Hastanesi

## Tansiyon Manşonu Teknik Şartnamesi

1. Tansiyon manşonu çok kullanımlık olmalıdır.
2. Manşon boyu 27.5 -36cm ölçülerinde olmalıdır.
3. Manşon üzerinde arter noktası işaret ile gösterilmelidir.
4. Manşon üzerinde hangi hasta grubu için olduğu belirtilmelidir.
5. Manşon üzerinde kullanım alanını gösterir range çizgileri olmalıdır.
6. Manşon dış yüzeyi yıkanabilir yapıda olmalıdır
7. Manşon üzerinde latex içermediği belirtilmelidir.
8. Manşon tek hortumlu olmalıdır.
9. Manşonun monitöre uyumu için gerekli adaptör firma tarafından temin edilmelidir.
10. Üzerinde CE işareti olmalıdır.
11. Teslimat sırasında şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretleri bulunmalıdır
12. Manşon rengi kirlenmelere karşı koyu lavacert olmalıdır.
13. Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
15. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. Numune üzerinden değerlendirilecektir.

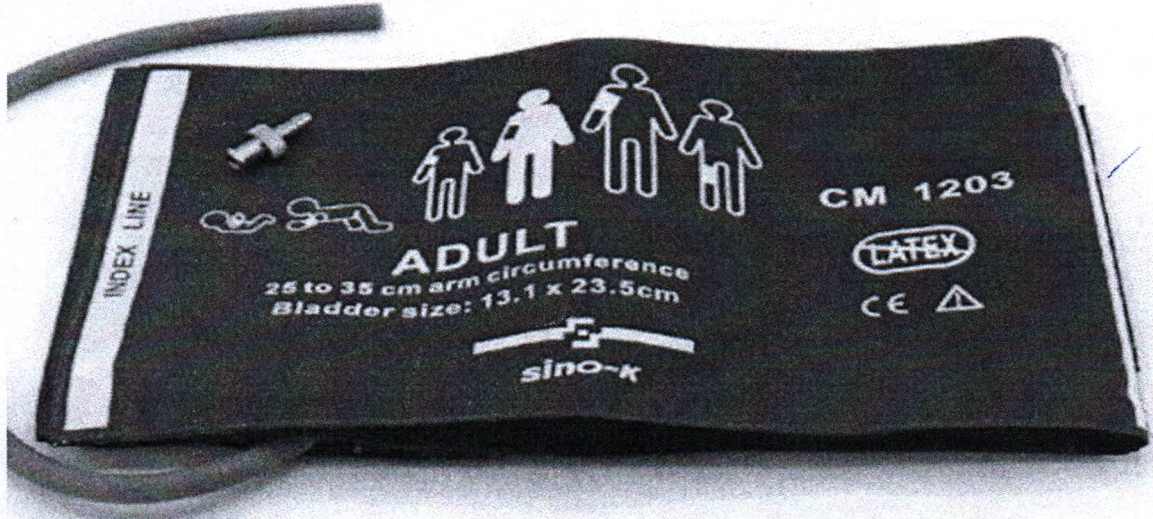

Uzm. Dr. Ayşe Zeki Sarverdi

Ayşe Zeki Sarverdi

Uzm. Dr. Veysel KIR  
Acil Tıp Uzmanı  
Diyadin Devlet Hastanesi  
Tes.No: 166908

## Tansiyon Manşonu Teknik Şartnamesi

1. Tansiyon manşonu çok kullanımlık olmalıdır.
2. Manşon boyu 22-36 cm ölçülerinde olmalıdır.
3. Manşon üzerinde arter noktası işaret ile gösterilmelidir.
4. Manşon üzerinde hangi hasta grubu için olduğu belirtilmelidir.
5. Manşon üzerinde kullanım alanını gösterir range çizgileri olmalıdır.
6. Manşon dış yüzeyi yıkanabilir yapıda ve antibakteriyel olmalıdır.
7. Manşon üzerinde latex içermediği belirtilmelidir.
8. Manşon tek hortumlu olmalıdır ve hortumun boyu en az 95- 100 cm olmalıdır.
9. Manşon hortumu toz kir tutan bir yapıda olmamalıdır.
10. manşon cardioline marka tansiyon holter cihazına uyumlu olmalıdır.
10. Üzerinde CE işareti olmalıdır.
11. Teslimat sırasında şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretleri bulunmalıdır.
12. Manşon rengi kirlenmelere karşı koyu lacivert yeşil veya gri olmalıdır.
13. Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
15. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. Numune getirilmesi zorunludur, numuneler cihaz üzerinde denendikten sonra karar verilecektir.

**Büşra Bilgiç**  
Hemşire

Uzman Dr. Maldun KOÇ  
Kardiyoloji Uzmanı  
Tescil No: 179767  
Patnos Devlet Hastanesi

**Cafer ALACA**  
Biyomedikal Teknikeri