

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

15.09.2025

Sayı: 763
Konu: TRANSPALET ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktar ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.09.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gergini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TRANSPALETLER			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025


Kışı / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşımza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TRANSPALET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen transpaletler, en az 2.500 kg ağırlığındaki yükleri kaldırabilecek ve kaldırma mekanizması elle kumanda edilebilir hidrolik yapıda olacaktır.
2. Transpaletlerin hareket (çekme itme) kolları, aşağı yukarı hareket edebilen, el frenli olacaktır. Çataldaki yükü kaldırma-indirme hareketi, elle kumanda edilecektir.
3. Transpaletin çatal yüksekliği (C) inikken 85 mm, kalkıkken (K) en az 200 mm olacaktır.
4. Çatal genişliği (F) en az 145 mm, en fazla 155 mm olacaktır.
5. Dıştan dışa iki çatal arası genişlik (G) en az 510 mm, en fazla 550 mm olacaktır.
6. Çatal boyu (B) en az 1150 mm, en fazla 1250 mm olacaktır.
7. Transpaletlerin yön tekerleğinin (2 adet) çapı (E) $200 \times 50 \pm 5$ mm, yük tekerleğinin (4 adet) çapı (H) en az 80×50 mm boyutlarında olacak ve tekerlekler dayanıklı malzeme olan poliüretan mamülden üretilmiş olacaktır.

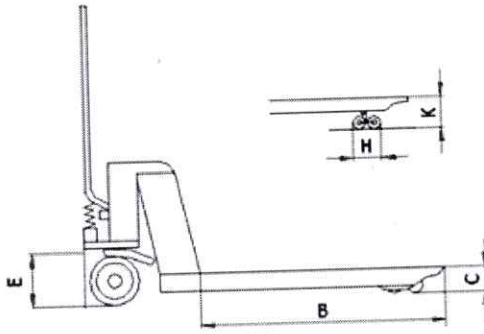

B= 1200 ± 50 mm

C= 85 mm

E= 200 ± 5 mm

F= 150 ± 5 mm

G= 530 ± 20 mm

H= 160 (80x2) mm

K= 200 mm

ölçülerinde olacaktır.

8. Transpalet Ağırlığı: Max : 80 Kg olacak

9. Transpalet çatalları çelik olacak

10. Transpaletin kasa ve çatalları üzerinde ağır yüke maruz kalan noktalar güçlendirilmiş çelik olacaktır.

11. Transpaletlerin konstrüksiyonu, çelikten olup zor çalışma şartlarına dayanıklı olacaktır.

12. Transpaletler taşınacak paletlerin hasar görmemesi için yuvarlatılmış çatal uçlarına sahip olacaktır.

13. Transpaletler, tamir, bakım ve yağlama için kolayca ulaşılabilen, her bir tekerlekte kapalı ikişer adet rulmana sahip olacaktır. Bu rulmanlar toz girişimini önleyecek ve uzun ömürlü olacaktır.

14. Kontrol kolu ve tutamak; kullanımı kolay, rahat ve mukavim olmalıdır.

Sedat ÇETİN
KAT

Eyüp KARATAŞ
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknolojileri

15. Transpaletler en dar alanlarda bile yüksek manevra kabiliyetine sahip olacaktır. Transpaletlerin yön tekerlekleri sağa ve sola en az 90° açıyla dönebilmeli, transpaletler üç pozisyonlu (sağa-sola, yukarı aşağı) hareket edebilecek ve her pozisyonunda (180°) hidrolik kontrol yeteneğine sahip olacaktır.
16. Hidrolik pompa gövdesi çelikten imal edilmiş ve az bakım gerektiren (yağ değişimi, vb.), uzun ömürlü bir sisteme sahip olacaktır.
17. Teklif edilen transpaletler ile ilgili fiziki (boyutları, vb.) ve teknik dokümanlar teklifle birlikte verilecektir.
18. Transpaletlerin dış aksamalarında çizik, çatlak, kırık gibi herhangi bir hasar bulunmayacaktır.
19. Min. 2 yıl servis garantisi olmalıdır.
20. Min. 10 yıl parça ve işçilik garantisi olmalıdır.

Sedat ÇETİN

Emir KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomekanik Uzmanı

Emir KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomekanik Uzmanı