

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

17.09.2025

Sayı: 256

Konu: İNFÜZYON POMPASI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.09.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Mühür
İdari ve Mali İşler

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	İNFÜZYON POMPASI CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname


Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.


ENMIND MARKA EN-V7 SMART MODEL İNFÜZYON CİHAZI BATARYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Batarya orijinal ENMIND V7 SMART MODEL İNFÜZYON/PERFÜZÖR cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Batarya bakım istemeyen Lityum –ion tipte olmalıdır.
3. Batarya 11.1V olmalıdır.
4. Batarya 2600 mAh olmalıdır.
5. Batarya en fazla 3 saatte şarj olmalıdır.
6. Bataryayı cihaza takınca batarya alarmı vermemelidir.
7. Batarya cihaza takılıp çalışıp şarj olduğu görüldükten sonra kabul edilecektir.
7. Teklif veren firma tek yetkili olduğuna dair belgeyi ihale komisyonuna sunmalıdır. Yetki belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

Müftü Kaya

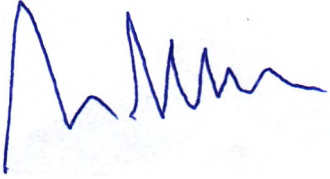

Salih Tap

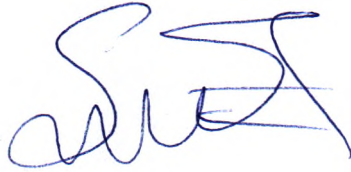

Alınan Çarraf

