



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-293228664
Konu : Teklife Davet

03.11.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ İHTİYACINA BİNAEN 4 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **10.11.2025** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	A4 SİYAH MATBU EVRAK (ACİL ORDER)	ADET	150.000		
2	YAZILI RENKLİ BARKOD ETİKETİ (1-200 E KADAR)	ADET	2		
3	ACİL ÇIKIŞ KAPISI FOSFORLU UYARI LEVHASI	ADET	20		
4	GENEL UYARI LEVHASI	ADET	30		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: C6CF956E-9DB4-4ED8-9DBE-1544F84227C1

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: [Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr](https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr)
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

MATBU EVRAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Yazılar net okunabilir koyulukta olmalıdır.
- b) Kâğıt kalitesi ilgili kalemin, kâğıt boyutu A4 olacak şekilde teknik şartnamesinde belirtilen kalite veya üstü olmalıdır. kâğıt boyutları 21x29,7 cm yatay veya dikey şekilde baskı yapılacaktır. Kâğıt rengi beyaz olacaktır.
- c) Basıma gidecek evraklar tek sayfa olanların arka yüzlerine diğer tek sayfa olan evrak baskısı yapılacaktır. Bu konudaki evrak ayarlaması kalite biriminin direktifi doğrultusundaki olacaktır. Kalite biriminin verdiği evrak direktifleri dışında yapılan baskılar kabul edilmeyecektir.
- d) Gönderilen dökümanlar siyah renk olarak baskı yapılacaktır.
- e) Evrakların sayfa sayısı değişmekte olup 1 sayfadan fazla olan evrakların arkalı önlü baskı yapılması gerekmekte ve tek sayfa olarak kabul edilecektir.
- f) **Yüklenici firmalar için evrakların PDF formatları Mail üzerinden gönderimi yapılacaktır. Ancak Mail üzerinden gönderilen evraklarda; numune ve baskılarda oluşacak hatalar yüklenici firmaya aittir.**
- g) Numune basımı yapılacak olan evrak öncelikle 1 (bir) nüshası kuruma getirilerek veya yollanarak komisyonun onayına sunulacak, komisyonca verilen onay sonrası basım işlemleri yapılacaktır.
- h) **Basımı gerçekleşen evraklar kurumumuza geldikten sonra, evraklarda basım sırasında oluşan hatalar yüklenici firma tarafından tekrar basılıp gönderilecektir.**
- i) Yazılarda imla hatası vb. hatalar oluştuğunda yenileri ile en geç 1 hafta içerisinde değiştirilmelidir.
- j) **Evraklar baskı şeklinde olacaktır, fotokopi kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- k) Basılı evraklarda kurumca verilen ölçülere azami dikkat edilecektir. Verilen ölçülere uymayan baskılar, en geç 1 hafta içerisinde yenileriyle değiştirilecektir.
- l) İhaleye katılacak firmalar Ambar memurluğundan numuneyi görüp uygunluk alıp aynı ürünleri getireceğini beyan edecek ve taahhütname düzenleyeceklerdir.
- m) Baskısı yapılan evraklar daha sonra Ambar birimine paketli bir şekilde teslim edilecektir.


Taha Yaşar KOÇ
Kalite Birim Sorumlusu

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birim

Şemihâ ÇELİK
Tıbbi Sekreter

RENKLİ ETİKETİ TEKNİK ŞARTNEMESİ

1. Etiket yüzeyi kolay silinebilir ve renkleri kolayca çıkmayacak şekilde olmalıdır.
2. Etiket yüzeyi pvc benzeri bir maddeden yapılmış olmalıdır.
3. Yüzeyi sarı içerisindeki yazılar kırmızı olmalıdır.
4. 1-200 kadar baskılı 2 top şekilde hazır olarak gelmelidir.
5. Ürün görseli resimdeki gibi olmalıdır.
6. Eni 80, boyu ise 60 ebatlarında olmalıdır.

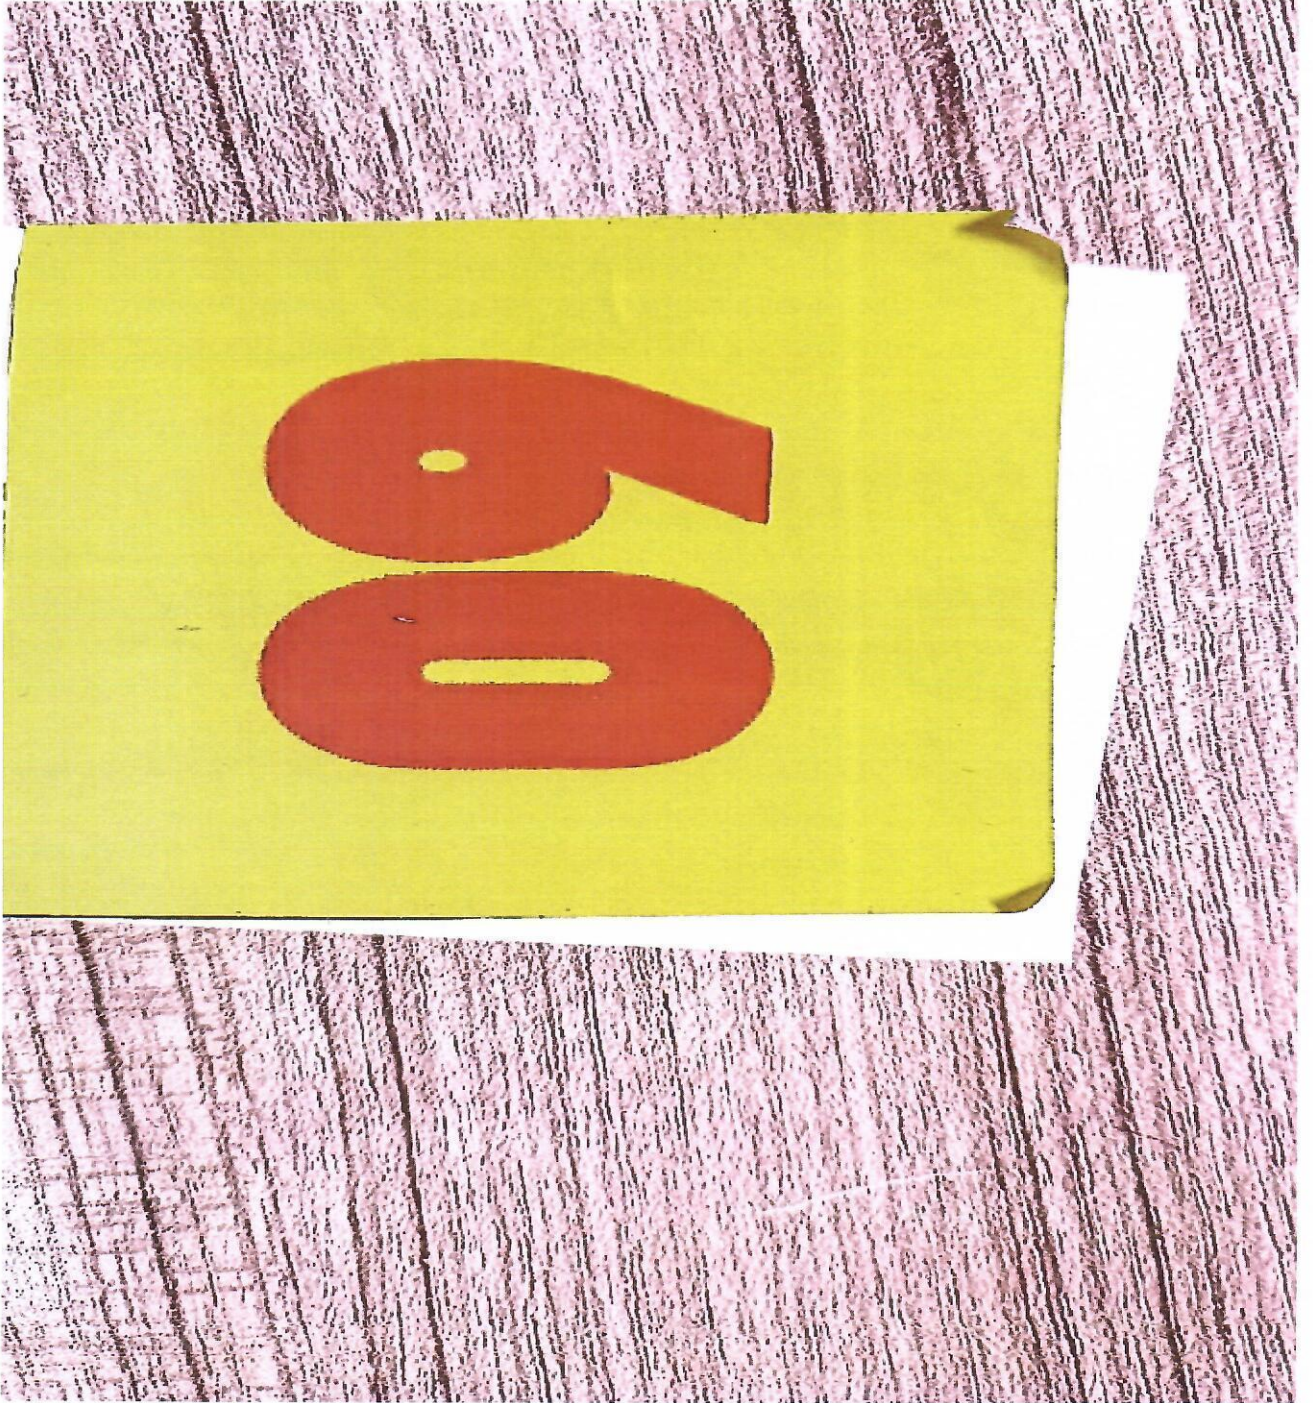

Taha Yasin KOÇ
Kalite Birim Sorumlusu

DOC.DR.YAŞAR ERVİLMİŞ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambas Birimi


Özlem CELİK
Tıbbi Sekreter

ACİL ÇIKIŞ KAPISI UYARICI LEVHA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yatay A4 boyutunda olmalıdır.
2. Kendinde veya yapıştırma bantları üzerinde olmalıdır.
3. Renkleri fosforlu olacak ışıık az ortamda rahat parlayacaktır.
4. Üzerinde kaplama olacak, silmeye elverişli olacaktır.
5. Ürün görseli aşağıda gösterildiği gibi olacaktır.
6. Yüklenici firmaya görsel gönderimi yapılacak o şekilde baskı yapılacaktır.



**ACİL ÇIKIŞ
KAPISI**

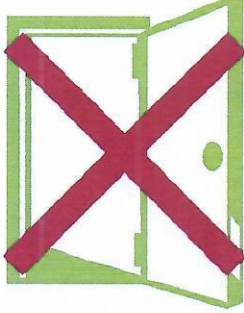

**ACİL DURUMLAR
DIŞINDA GİRİŞ ÇIKIŞ
İÇİN KULLANMA**

Taha Yaşin KOC
Kalite Birim Sorumlusu

DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Amir Birim

Semiha ÇELİK
Tıbbi Sekreter

UYARICI LEVHALAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kaliteli vinil folyo üzerine iç ortam kalitesinde dijital baskı yapılmakta ayrıca üzerine mat laminasyon uygulanarak satışa sunulmaktadır.

İşaretin arkasındaki tabaka sıyrılarak kendinden yapışkanlı düz ve temiz yüzeye sıvanarak yapıştırılır.

Dolap pano yüzeyi gibi ahşap ve metal yüzeyler tavsiye edilen uygulama yüzeyleridir.

Duvar yüzeyi gibi pütürlü yüzeylerde kullanılması tavsiye edilmez.

İç ve dış ortamlarda kullanılabilir.

Ürün boyutları A4 olarak ayarlanacaktır.

3 mm Dekota levha üzerine fotolümen sticker folyo uygulanarak üretilmiştir. 3mm kalınlığı ile görsel açıdan diğer malzeme seçeneklerinden ayrılır. Dış etkenlerden yağmur ve güneş ışığına dayanıklı bir malzemedir. Montaj uygulaması oldukça basittir. Dekota levhanın hafif oluşu çivi ve ya dübel cıvata gerektirmez. Silikon ile ya da düz ve temiz yüzeylerde kaliteli çift taraflı bant ile montaj uygulaması rahatlıkla yapılabilir.

Ürün görselleri yüklenici firmaya mail üzerinden gönderim yapılacaktır.

Taha Yasin KOÇ
Kalite Bizim Sorumlusu

DOĞUŞAYAZIT
DOĞUŞAYAZIT
Fikret DOĞUŞAYAZIT
Amir

Semiha ÇELİK
Tıbbi Sekreter