



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-305658372  
Konu : Teklife Davet

20.02.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE 15 KALEM TABELA ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **26.02.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	BRAİLLE ALFABELİ POLİKLİNİK KAPI TABELASI	ADET	40		
2	BRAİLLE ALFABELİ BİRİM KAPI TABELASI	ADET	275		
3	BRAİLLE ALFABELİ TUVALET KAPI TABELASI	ADET	40		
4	FENER MODEL ÇİFT TARAF WC TABELASI	ADET	12		
5	ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME TABELASI 4 BİRİMLİ	ADET	6		
6	ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME TABELASI 10 BİRİMLİ	ADET	3		
7	ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME TABELASI 8 BİRİMLİ	ADET	4		
8	ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME TABELASI 6 BİRİMLİ	ADET	6		
9	ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME TABELASI TEKLİ	ADET	20		
10	GENEL KAT YERLEŞİM TABELASI	ADET	1		
11	YERLEŞKE GİRİŞ TABELASI	ADET	1		
12	YATAY ALAN TABELALARI	ADET	6		
13	ACİL TABELASI	ADET	1		
14	BİNA DIŞI YÖNLENDİRME TABELASI 4 BİRİMLİ	ADET	2		
15	KAT TANIMLAMA TABELASI	ADET	15		
<b>GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):</b>					

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 47406D6E-2517-44F9-A08C-986F52CE9D58

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi: [dogubayazitdh@hs01.kcp.tr](mailto:dogubayazitdh@hs01.kcp.tr)

Bilgi için: Özlem DOĞAN  
Sağlık Teknikeri  
Telefon No:



Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**UYGUNDUR**  
**Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK**  
**Başhekim**

**NOTLAR**

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 47406D6E-2517-44F9-A08C-986F52CE9D58

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiyc.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>


Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi: [dogubayazitdh@hs01.kep.tr](mailto:dogubayazitdh@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Özlem DOĞAN  
Sağlık Teknikeri  
Telefon No:





AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ  
TABELA VE YÖNLENDİRME  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

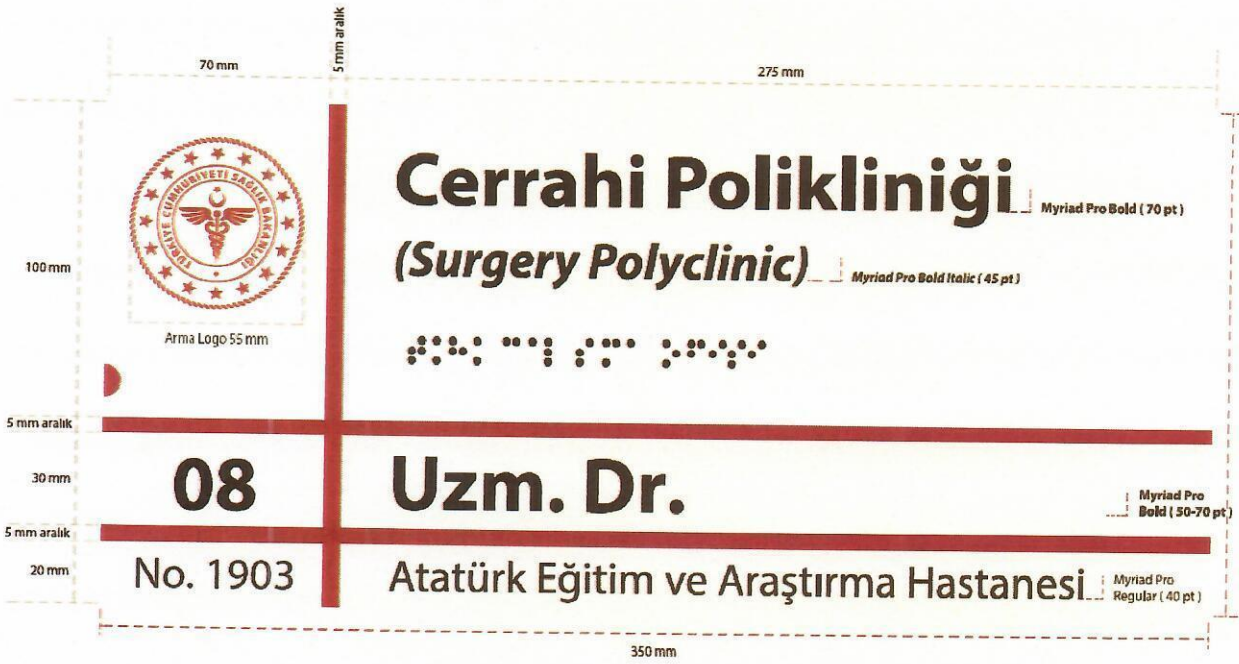

**Ürün** : Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Yönetim Birimi Levhası

**Ölçü** : 160 mm X 350 mm

**Renk** : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

**Montaj şekli:** Havşa başlı vidalama sistemi

**Adet** : 40 adet

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


**Açıklama:** Alt katman 3 mm, üst katman 5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge" esas alınacaktır. Birim isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir. Braille alfabesi çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır.

**Doktor isimliğinin olduğu alan mıknatıslı olmak zorundadır.**

*(Handwritten signatures in blue ink)*

SIRA NO: 2

Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Birim Kapı Tabelası

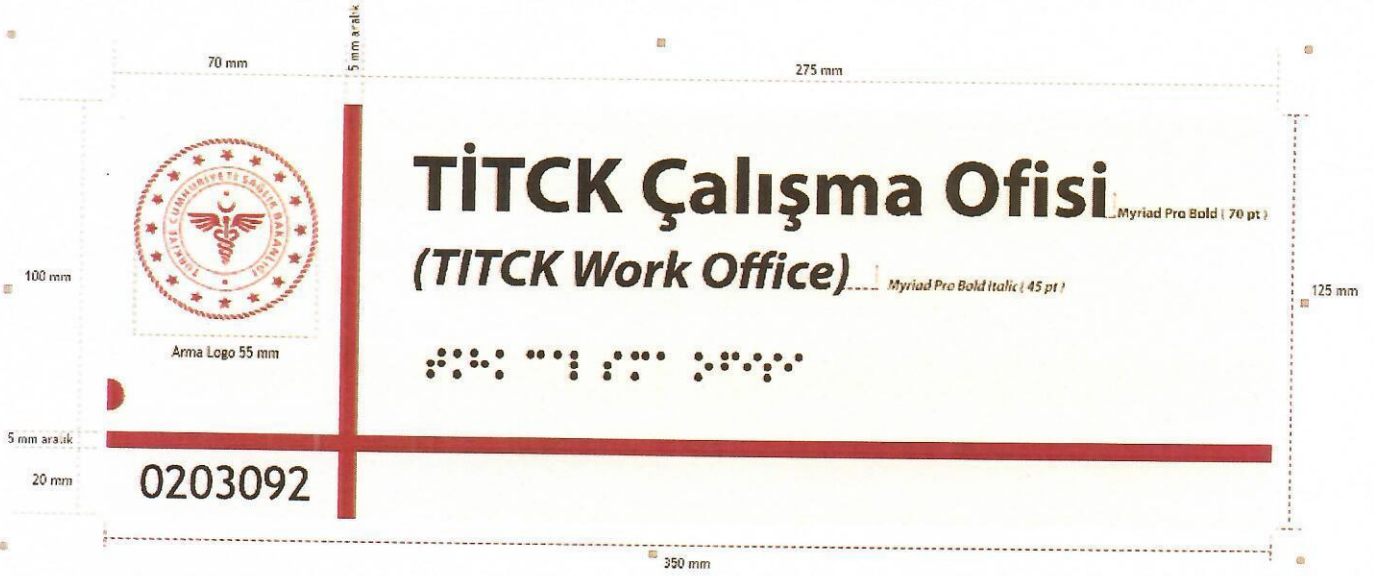

**Ürün** : Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Birim Levhası

**Ölçü** : 125 mm X 350 mm

**Renk** : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

**Montaj şekli:** Havşa başlı vidalama sistemi

**Adet:** 275 adet

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

**Açıklama:** Alt katman 3 mm, üst katman 5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge" esas alınacaktır. Birim isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir. Braille alfabesi çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır.

SIRA NO: 3

Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Miknatıslı Tuvalet Kapı Tabelası



**Ürün** : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı WC levhası

**Ölçü** : 15 x 15

**Renk** : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi** : İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli** : Duvara monte

**Adet** : 10 adet engelli wc / 15 adet kadın wc / 15 adet erkek wc

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kabartma UV baskılı WC levhaları 3+3 mm

Açıklama: Zemin 3 mm siyah pleksi üzerine ise 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. 18x30 cm ölçülü olanlar alt zemin 5 mm pleksi lazerde simetri yuvarlaklar açılıp üzerine 3 mm pleksi üzeri uv baskı yapılacak alt zemine monte edilecektir

SIRA NO: 4

FENER MODEL ÇİFT TARAF WC LEVHASI



**Ürün** : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı Çift taraflı fener model WC levhası

**Ölçü** : 30 x 15

**Renk** : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi** : İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli** : Duvara monte

**Adet:** 12

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:** Ortası 5 mm ön ve arka kısım 3mm pleksiden oluşacaktır.

Kabartma UV baskılı Magnet Birim Tanımlama wc levhası çift taraf 3+ 5+3 mm

**Açıklama:** Orta bölüm 5 mm siyah pleksi üzerine ise 3 mm satineli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Montaj aparatı özel enkrüksiyon kalıpla üretilmiş 1,5 mm alüminyum olacaktır. Montaj duvara vidalama ile yapılacaktır

*(Three blue ink signatures)*

SIRA NO: 5 ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI 4 BİRİMLİ

→	600 mm	10 mm	600 mm	100 mm	←	100 mm
←					→	10 mm
←	Dahiliye Kliniği		Dahiliye Kliniği		→	
→			Üroloji		←	
←	Başhekimlik		Başhekimlik		→	
←			Radyoloji		→	
→			Biyokimya Laboratuvarı		←	

Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme

Ölçü : Birim ölçü esas alınacaktır. ( 4 modüllü)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

Montaj şekli: Tavana monte

Adet : 6

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3 mm

Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme 4 birimli

**Açıklama:** Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

*(Handwritten signatures in blue ink)*

SIRA NO: 6 ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI 10 BİRİMLİ

→	600 mm	10 mm	600 mm	100 mm	←	100 mm
←					→	10 mm
←	Dahiliye Kliniği		Dahiliye Kliniği		→	
→			Üroloji		←	
←	Başhekimlik		Başhekimlik		→	
←			Radyoloji		→	
→			Biyokimya Laboratuvarı		←	

**Ürün :** Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme 10 BİRİMLİ

**Ölçü :** 100 x 50 ( 3 panelli )

**Renk :** Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi :** İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli :** Tavana monte

**Adet:** 3

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ** 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı Pleksi askılı çift taraf yönlendirme

**Açıklama:** Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

SIRA NO: 7 ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI 8 BİRİMLİ

→	600 mm	10 mm	600 mm	100 mm	←	100 mm
←					→	10 mm
←	Dahiliye Kliniği		Dahiliye Kliniği		→	
→			Üroloji		←	
←	Başhekimlik		Başhekimlik		→	
←			Radyoloji		→	
→			Biyokimya Laboratuvarı		←	

Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme 8 BİRİMLİ

Ölçü : 100 x 50 ( 3 panelli )

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

Montaj şekli : Tavana monte

Adet: 4


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı Pleksi askılı çift taraf yönlendirme

**Açıklama:** Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.



**SIRA NO:9 ASKILI ÇİFT TARAF PLEKSİ MİKNATISLI UV BASKILI TEKLİ  
YÖNLENDİRME LEVHASI**

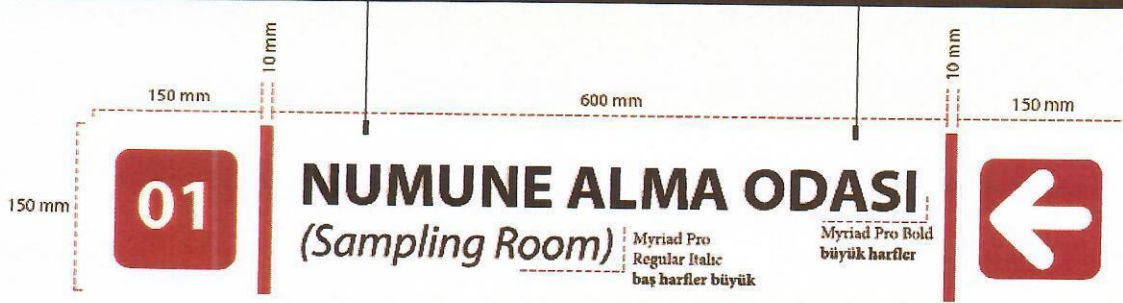

**Ürün** : Pleksi Kabartma UV baskılı ve askılı çift taraf danışma levhası

**Ölçü** : 60 x 15

**Renk**: Pantone 199C RAL Kodu:3028

**Yazı rengi** : İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli** : Tavana askı sistemi

**Adet**: 20

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ** 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme

**Açıklama**: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

SIRA NO:10 PLEKSİ MKNATISLI UV NASKILI GENEL KAT YERLEŞİM PLANI

DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ KAT YERLEŞİM PLANI				
2. KAT	CİLDİYE POLİKLİNİĞİ	KBB POLİKLİNİĞİ	2. KAT	
	ÇOCUK CERRAHİ POLİKLİNİĞİ	ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ		
1. KAT	GECEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ	GÖĞÜS CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ	1. KAT	
	BEYİN CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ	GÖZ POLİKLİNİĞİ		
ZEMİN KAT	KADIN HASTALIKLARI POL.	AMELİYATHANELER	ZEMİN KAT	
	GENEL YOĞUN BAKIM	... SERVİSİ		
	... SERVİSİ			
	FTR			
	... SERVİSİ			

Zemin kat 18 birimli  
Birinci kat 20 birimli  
İkinci kat 22 birimli

**Ürün:** Magnet mıknatıslı Kabartma UV baskılı kat planı

**Ölçü:** 1785 mm x 1300 mm


**Renk:** Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi:** İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli:** Duvara monte

**Adet** 1

**Açıklama :** Zemin 5 mm pleksi üzerine 3 mm beyaz pleksi en üst kısımda ise 3 mm satıneli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Yazının uygulanacağı 3 mm satıneli pleksi zemine 10\*3mm 4 adet endüstriyel mıknatıs ile bağlantı sağlanacaktır. Ürün 3 katman 3mm pleksiden oluşacaktır. Detaylı çizimi ek-1de belirtilmiştir

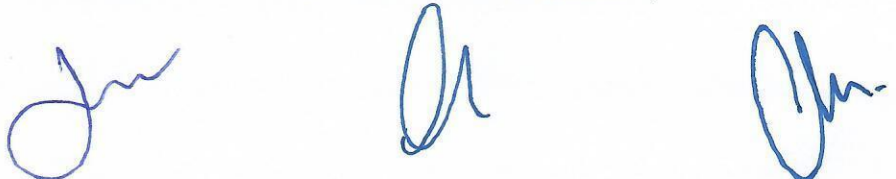

## SIRA NO:11 YERLEŐKE GİRİŐ TABELASI



**ŪrŪn** : YerleŐke GiriŐ Tabelası

**ŐlçŪ** : 1800\* 120

**Renk** : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

**Montaj Őekli:** Uygun Vidalama yŐntemi


**Adet** : 1 adet

### ŪRŪN ŐZELLİKLERİ

**Açıklama:** Zemin kompozit panel olmalıdır. Yazılar 3 mm pleksiglas, kabartma kutu harf olmalıdır. Logo 5 mm pleksiglas olmalıdır. Logo transluzet folyo uygulama Őeklinde yapılmıŐ olmalıdır. İkinci uygulama yŐntemi olarak harfler CNC kesim olarak hazırlanabilecektir. Aydınlatma için floresan veya modŪl led kullanılmalıdır. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan baŐlıklardaki linklerden illŪstratŐr (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Saėlık tesisi tabelalarında "Saėlık Bakanlıėına Baėlı Hastaneler, Aėız ve DiŐ Saėlıėı Merkezleri ile Bazı BŐlŪmlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında YŐnerge" esas alınacaktır.

*[Handwritten signatures in blue ink]*

**SIRA NO:12 YATAY ALAN TABELALARI**

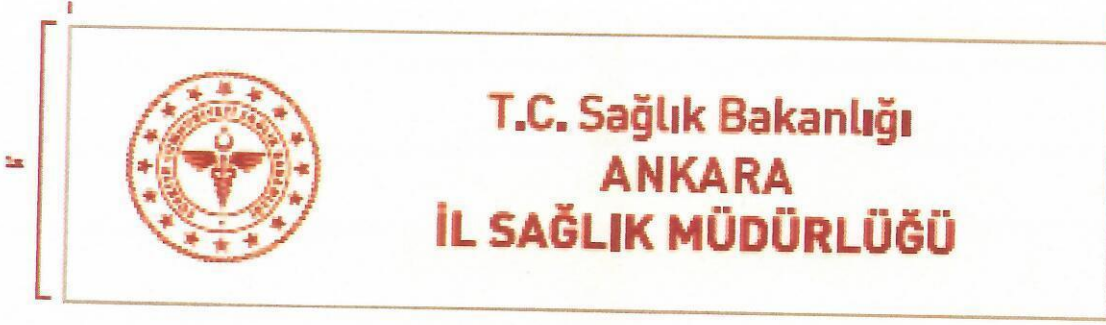

**Ürün** : Yatay Alan Tabelaları

**Ölçü** : Tabelalar farklı ebatlarda olduğundan dolayı yüklenici firma iletişime geçerek ebatlar hakkında bilgi almalıdır.

**Renk** : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

**Montaj şekli:** Uygun Vidalama yöntemi

**Adet** : 6 adet

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

**Açıklama:** Zemin kompozit panel olmalıdır. Yazılar 3 mm pleksiglas, kabartma kutu harf olmalıdır. Logo 5 mm pleksiglas olmalıdır. Logo transluzet folyo uygulama şeklinde yapılmış olmalıdır. İkinci uygulama yöntemi olarak harfler CNC kesim olarak hazırlanabilecektir. Aydınlatma için modül LED kullanılmalıdır. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında “Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge” esas alınacaktır.

## SIRA NO:13 ACİL TABELASI



**Ürün** : Acil Tabelası

**Ölçü** : 840\*70

**Renk** : Tabeladaki **ACİL** yazısı RAL Kodu:5002 / Hilal Sembolü RAL kodu: 3028

**Montaj şekli:** Uygun Vidalama yöntemi

**Adet:** 1 adet

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

**Açıklama:** Zemin kompozit panel olmalıdır. Yazılar 3 mm pleksiglas, kabartma kutu harf olmalıdır. Logo 5 mm pleksiglas olmalıdır. Logo transluzet folyo uygulama şeklinde yapılmış olmalıdır. Aydınlatma için modül LED kullanılmalıdır. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge" esas alınacaktır.

*[Handwritten signatures in blue ink]*

## SIRA NO:14 BİNA DIŐI YÖNLENDİRME TABELASI 4 BİRİMLİ



Ürün : Bina DıŐı Yönlendirme Tabelası 4 Birimli

Ölçü :

Renk : Tabeladaki ACİL yazısı RAL Kodu:5002 / Hilal Sembolü RAL kodu: 3028

Montaj şekli: Zemine Vidalama yöntemi

Adet: 2 adet

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

**Açıklama:** Zemin kompozit oyma panel olmalıdır. Aydınlatma için modül LED kullanılmalıdır. Tabeladaki tüm unsurların tabela ebadına göre deforme edilmeden oransal olarak yer almasına dikkat edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında “Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve DiŐ Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge” esas alınacaktır.

*(Handwritten signatures)*

SIRA NO: 15

KAT TANIMLAMA PANOSU



**Ürün** : Kabartma UV baskılı Blok -kat panosu

**Ölçü** : 25x25



**Renk** : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi** : İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli** : Duvara monte


**Adet** : 15

**Açıklama** : Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır zemin 3 mm satıneli pleksi kullanılacak ve duvara çift taraflı bant ve silikon ile yapıştırılacak. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.



- Ürün görselleri temsili paylaşılmıştır.
- Yüklenici firma tabelaların üzerinde yazılacakları İdaremizden aldıktan sonra yapacaktır.
- Yüklenici firma tüm montaj ve gerekli hatları kendisi çekecektir.

İdris KIBUK



Taha Yasin KOÇ  
Kalite Birim Sorumlusu



İdris 302806A  
Elektrok Teknikleri

