

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

30.04.2026

Sayı : 35
Konu : 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM.

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.05.2026 saat: 11:00 'a kadar ekap üzerinden e-teklif adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Terhan TARLIĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	STERİLİZASYON RULOSU, 7.5CM*200M			80	Adet		
2	KORUYUCU GECE PLAĞI			200	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

STERİLİZASYON RULOSU ŞARTNAMESİ


- 1- Rulolar etilenoksit ve buhar indikatörlü olmalı renk değişimi net olmalıdır.
- 2- 60 gr/m² medikal kraft kağıt diğer tarafı kopolimer filmden üretilmiş olmalıdır.
- 3- Beş kattan oluşan filmi (min.50 mikron) diğer iki katmanlı filmlerden daha dayanıklı ve esnek olmalıdır, uzun süreli sterilizasyonda yıpranmamalıdır.
- 4- Filmin dış polyester (PET) katman yüksek ısı dayanımı sağlarken alttaki polipropilen (PP) esaslı katman yüksek sağlamlık, esneklik ve kolay açılabilme özelliklerinin yanında yüksek yalıtım ve yırtılma direnci sağlamalıdır.
- 5- Paketlenmiş ürünler şeffaf filmde rahatlıkla görülebilmelidir.
- 6- ISO 11140-1 göre uygulanmış işlemci indikatörleri bulunmaktadır.
- 7- İndikatörlerin renk değişimleri net olmalıdır.
- 8- Vakum sistemli otoklavda bariyer dayanımı en üst seviyede olmalıdır. Bunun yanı sıra paket kolay açılabilmeli ve açarken partikül bırakmamalıdır. Steril edilen paketin açılması esnasında oluşan tozlanmadan ötürü doğan kontaminasyonu minimuma indirmelidir.
- 9- Gaz ve buhar indikatörleri, kağıt ile film arasında kenarda olmalı, yerleşimleri asıl sterilizasyon bölgesinin dışında kalmalıdır.
- 10- Rulolarda açılma yönü bulunmalıdır.
- 11- Ürün ISO 9001:2000 ve CE belgeli olmalıdır.
- 12- Ruloların eni 7,5 cm boyu 200mt uzunluğunda olmalıdır.

İbrahim DEMİR
Sterilizasyon Sorumlusu
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İbrahim YILDIRIM
Sterilizasyon Personeli



VAHİT DAĞ
Sterilizasyon Personeli

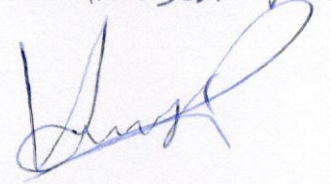



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN
ADI

KORUYUCU GECE PLAĞI

FİZİKSEL VE
KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

KULLANIM
YERİ VE
ÖZELLİKLERİ

1. Gece plağı polyester olmalıdır.
2. Rengi şeffaf olmalıdır.
3. 80-100 santigrat da erimelidir.
4. Orta yumuşak sertlikte olmalıdır.
5. Kalınlığı 1.00 mm (SERT) olmalıdır.
6. Kullanım amacına uygun olmalıdır.
7. Ulusal (TSE) veya uluslararası standartlara uygun olmalı,
8. Tüm istekli firmalar numune ile birlikte Türkçe kullanma kılavuzu vermek zorundadır.
9. Şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan malzemenin genel özelliklerini ve kullanım amacını değiştirmeyecek şekilde daha üstün özellikler taşıyan yeni ve değişik versiyonları da teklif edilebilir.
10. Muayene komisyonu tarafından muayene süresince tespit edilemeyen, yani zaman içerisinde klinik çalışmaları ile tespit edilebilecek problemlerden dolayı, şartnameye uygun olmadığı görülen sorunlu mal, sorunsuz olan yenisi ile gramaj ve adet farkı olmadan ve hiçbir ücret talep edilmeden firma tarafından değiştirilecektir.
11. Hasta ve ürün güvenliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket vs yapıştirilmamalıdır.
12. Numuneler ihale komisyonu, ilgili birimin Uzman hekimleri veya diş hekimleri tarafından denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan, hasta ve hekim memnuniyeti sağlamayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

ÜRETİM TARİHİ
VE MİADI

- 1-Ürün miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 2-Firma miadının dolmasına 3 ay kala kullanılmamış ürünleri değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

AMBALAJ ŞEKLİ
VE MİKTARI

Orijinal ambalajında olmalıdır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

- 1-Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na(TITUBB) veya Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TITUBB' DA Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
- 2-Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda numune getirecek, gelen Numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna Göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.
- 3-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, Hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

Birim Sorumlusu
Rabia UYGÜL

İMZA - KAŞE

M.Salih KARABACAK




İMZA - KAŞE

Ferda GÜLTEKİN

İMZA - KAŞE



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN ADI	KORUYUCU GECE PLAĞI
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ DEPOLAMA ŞARTLARI KULLANIM YERİ VE ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Gece plağı polyester olmalıdır.2. Rengi şeffaf olmalıdır.3. 80-100 santigrat da erimelidir.4. Orta yumuşak sertlikte olmalıdır.5. Kalınlığı 2.00 mm (YUMUŞAK) olmalıdır.6. Kullanım amacına uygun olmalıdır.7. Ulusal (TSE) veya uluslararası standartlara uygun olmalı,8. Tüm istekli firmalar numune ile birlikte Türkçe kullanma kılavuzu vermek zorundadır.9. Şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan malzemenin genel özelliklerini ve kullanım amacını değiştirmeyecek şekilde daha üstün özellikler taşıyan yeni ve değişik versiyonları da teklif edilebilir.10. Muayene komisyonu tarafından muayene süresince tespit edilemeyen, yani zaman içerisinde klinik çalışmaları ile tespit edilebilecek problemlerden dolayı, şartnameye uygun olmadığı görülen sorunlu mal, sorunsuz olan yenisi ile gramaj ve adet farkı olmadan ve hiçbir ücret talep edilmeden firma tarafından değiştirilecektir.11. Hasta ve ürün güvenliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket vs yapıştirilmamalıdır.12. Numuneler ihale komisyonu , ilgili birimin Uzman hekimleri veya diş hekimleri tarafından denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan, hasta ve hekim memnuniyeti sağlamayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1-Ürün miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. 2-Firma miadının dolmasına 3 ay kala kullanılmamış ürünleri değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Orijinal ambalajında olmalıdır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1-Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na(TITUBB) veya Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TITUBB' DA Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. 2-Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda numune getirecek, gelen Numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna Göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. 3-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, Hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
Birim Sorumlusu Rabia UYGÜL  İMZA - KAŞE	<p style="text-align: center;">M.Salih KARABACAK  İMZA - KAŞE</p> <p style="text-align: center;">Ferda GÜLTEKİN  İMZA - KAŞE</p>