

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.06.2026

Sayı: 590
Konu: 50 ADET NEBULİZÖRÜDÜZER MASKE ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.07.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	NEBULİZÖRÜDÜZER MASKE YETİŞKİN			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kışı / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın Almanın Yapılacağı Birim:

• Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.


• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEKNİK ŞARTNAME
NEBÜL HAZNELİ YETİŞKİN DİFÜZÖR MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske tasarımı hem nazal hem oral solunum yapan hastalarda etkin oksijen tedavisi sağlayacak yapıda olmalıdır.
2. Maske altında hem oksijen hem de nebül haznesinin takılabileceği konnektör olmalıdır. Bu konnektör sayesinde maske hem düz oksijen maskesi gibi hem de nebül maskesi gibi kullanılabilmelidir.
3. Maske, orta ve yüksek konsantrasyonlarda FiO_2 sağlayacak şekilde difüzör teknolojisine sahip olmalıdır. Difüzör sistemi, oksijenin burun ve ağız bölgesine yoğunlaştırılmış şekilde yönlendirilmesini sağlamalıdır.
4. Maske ile birlikte verilen oksijen bağlantı hortumu;
 - o 360° dönebilen konektöre sahip,
 - o 215 cm (± 30 cm) uzunluğunda,
 - o Tıbbi kullanıma uygun, şeffaf ve kink yapmayan özellikte olmalıdır.
5. Maske, oksijen konsantrasyonunu ve akış dinamiğini artırmaya yönelik özel konik/mantar yapıda difüzör yapıya sahip olmalıdır.
6. Maske içerisinde sıvı ilaçları vermek için ilaçların içine konulacağı ilaç haznesi olmalıdır.
7. Hasta pozisyonuna göre etkin nebül tedavisi sağlamak amacıyla haznenin bağlandığı port kendi etrafında 360° dönebilir olmalıdır.
8. Hazne 7 lpm de, 1,8(± 0.5) MMAD (Median mass aerodynamic diameter) çapında ilaç çıkışı sağlamalıdır.
- 9.
10. Maske üzerinde, nazogastrik sonda geçişine imkân tanıyan uygun açıklıklar bulunmalıdır.
11. Maske üzerinde, ağız bakımı, aspirasyon ve sekresyon temizliği işlemlerine olanak sağlayan açıklıklar bulunmalıdır.
12. Maske tasarımı, hastada intrinsek PEEP (auto-PEEP) oluşturmayacak açık sistem yapısında olmalıdır. Rezervuar torbalı klasik non-rebreather maske tasarımında olmamalıdır.
13. Maske üzerinde, CO_2 rebreathing (yeniden soluma) riskini minimize edecek, yeterli gaz çıkışına izin veren en az 3 adet açık boşluk bulunmalıdır.

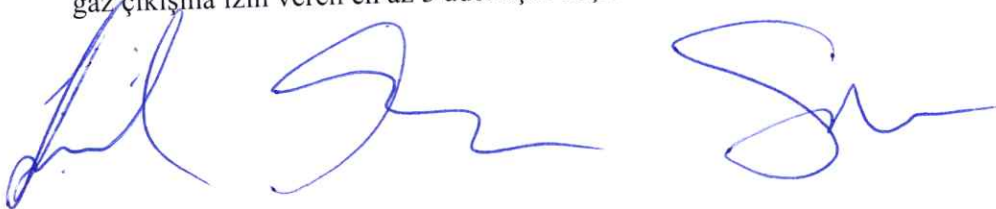

14. Açık tasarım sayesinde hastada klostrofobi hissi oluşturmamalıdır.
15. Konuşma ve oral alıma (gerektiğinde) izin veren yapıda olmalıdır.
16. Maske, minimum zorunlu akış gerektirmemeli, düşük akışlarda dahi güvenli kullanım sağlamalı; yüksek akışlarda stabil yapısını korumalı ve yerinden oynamamalıdır.
17. Maske ile aşağıdaki oksijen akış hızlarında belirtilen FiO₂ aralıkları sağlanabilmelidir:

Oksijen Akış Hızı	Sağlanabilir FiO ₂ Aralığı
1 LPM	23% – 26%
2 LPM	27%- 33%
3 LPM	32%- 48%
4 LPM	45%- 57%
6 LPM	56%- 68%
8 LPM	64%- 74%
10 LPM	70%-77%
12 LPM	70%-81%
≥15 LPM	72%-83%

